

SZ Series

INSTRUCTION MANUAL

Model	
SZ-A1	SZ-A6
SZX-B	SZX-T
SZX-BA	SZX-TA
SZO-B	SZO-T
SZ-ST1	SZ-ST2
SZ-ST3	SZ-ST7
SZ-ST8	SZ-OBL
ST-150	ST-152
SZ-STL1	SZ-STL2
SZ-STLX	SZ-STL5
SZ-STL5LED	

Ver. 2.3 2022



Table of contents

1.	Warning	4
2.	Safety Information	4
3.	Package content	5
3.1	SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA	5
3.2	SZO-B / SZO-T	6
3.3	SZ-A1	6
3.4	SZ-A6	7
3.5	ST-150	7
3.6	ST-152	8
3.7	SZ-ST1	8
3.8	SZ-ST2 / SZ-ST3	9
3.9	SZ-ST7 / SZ-ST8	9
3.10	SZ-OBL	10
3.11	SZ-STL1	10
3.12	SZ-STL2	11
3.13	SZ-STLX	11
3.14	SZ-STL5	12
3.15	SZ-STL5LED	13
4.	Unpacking	14
5.	Intended use	14
6.	Symbols and conventions	14
7.	Instrument description	15
7.1	System Diagram	15
7.2	SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA	16
7.3	SZO-B / SZO-T	16
7.4	SZ-A1	17
7.5	SZ-A6	17
7.6	ST-150	18
7.7	ST-152	18
7.8	SZ-ST1	19
7.9	SZ-ST2 / SZ-ST3	19
7.10	SZ-ST7 / SZ-ST8	20
7.11	SZ-OBL	20
7.12	SZ-STL1	21
7.13	SZ-STL2	21
7.15	SZ-STL5	22
7.14	SZ-STLX	22
7.16	SZ-STL5LED	23
8.	Assembling	24
8.1	SZ-A1 / SZ-A6	24
8.2	SZ-ST1 / ST-150	24
8.3	ST-152	24
8.4	SZ-ST2 / SZ-ST3	24
8.5	SZ-ST7 / SZ-ST8 / SZ-OBL	25
8.6	SZ-STL1	25
8.7	SZ-STL2	28
8.8	SZ-STLX	30
8.9	SZ-STL5 / SZ-STL5LED	33
8.10	Installing the head (all models)	34
8.11	Installing the eyepieces (all models)	34
8.12	Installing the photo port (SZX-T / TA)	34
9.	Use of the microscope	36
9.1	Adjusting interpupillary distance	36
9.2	Focusing	36
9.3	Adjusting the tension of the focus knob	36
9.3.1	SZ-A1	36
9.3.2	SZ-A6	36
9.4	Focus lock lever (SZ-A6)	37
9.5	Diopter compensation	37
9.6	Magnification	38
9.7	Use of additional lens	38
9.8	Use of additional lenses 0.3X-0.5X	39

9.9	Black/white stage plate (SZ-ST1 / 2 / 3 / 7 / 8)	39
9.10	Use of illumination (SZ-ST2 / 3 / 7 / 8)	40
9.11	Use of illumination (SZ-OBL)	40
9.12	Use of eye shields (SZO-B / T)	40
9.13	Use of overhanging stand	42
9.13.1	SZ-STL1	42
9.13.2	SZ-STL2	43
9.13.3	SZ-STLX	44
9.13.4	SZ-STL5 / SZ-STL5LED	46
10.	Microphotography	48
10.1	Installing the C-mount adapter	48
10.2	Use of reflex cameras	48
11.	Maintenance	49
12.	Troubleshooting	50
	Equipment disposal	51

1. Warning

This microscope is a scientific precision instrument designed to last for many years with a minimum of maintenance. It is built to high optical and mechanical standards and to withstand daily use. We remind you that this manual contains important information on safety and maintenance, and that it must therefore be made accessible to the instrument users. We decline any responsibility deriving from incorrect instrument use that does not comply with this manual.

2. Safety Information



Avoiding Electrical Shock

Before plugging in the power supply, make sure that the supplying voltage of your region matches with the operation voltage of the equipment and that the lamp switch is in off position. Users should observe all safety regulations of the region. The equipment has acquired the CE safety label. However, users have full responsibility to use this equipment safely. Please follow the guidelines below, and read this manual in its entirety to ensure safe operation of the unit.

3. Package content

3.1 SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA



① Microscope body

• SZX-B/BA Binocular / SZX-T/TA Trinocular

② Eyepieces

③ Allen wrenches (only for SZX-T/TA)

④ Dust cover

⑤ Ring for photo port (only for SZX-T/TA)


3.2 SZO-B / SZO-T



- ① Microscope body
 - SZO-B Binocular / SZO-T Trinocular
- ② Eyepieces


- ③ Allen wrenches (only for SZO-T)
- ④ Dust cover

3.3 SZ-A1

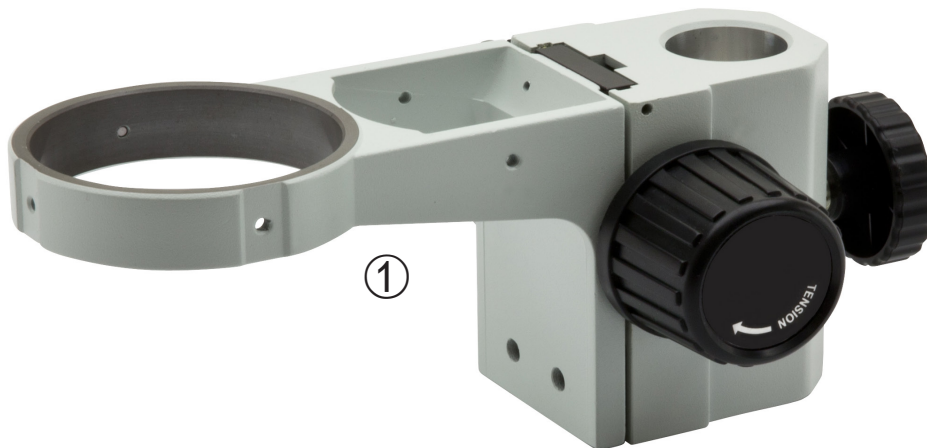


- ① Coarse focus system

3.4 SZ-A6

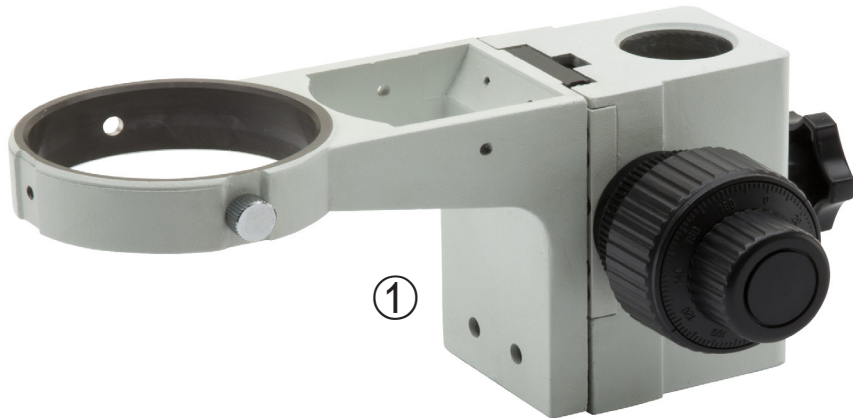

① Coarse/fine focus system


3.5 ST-150

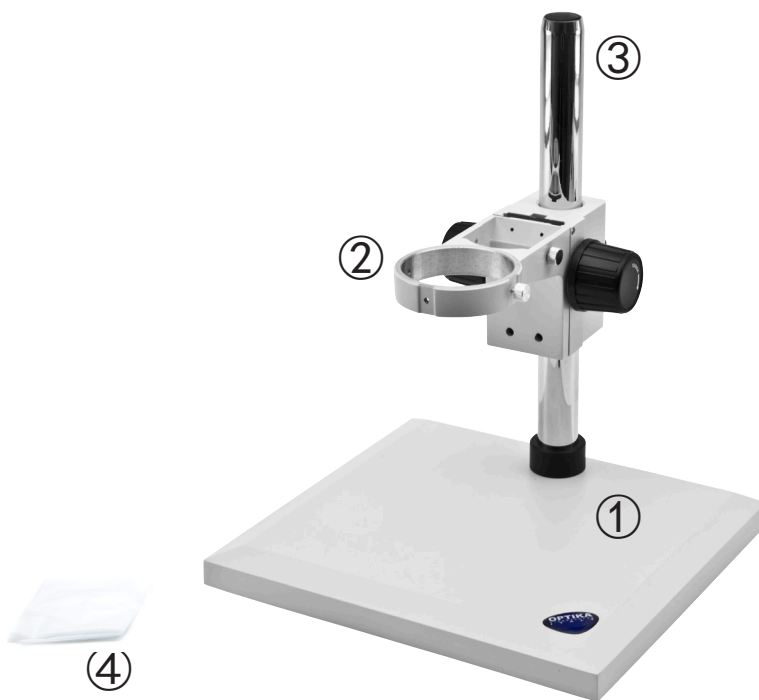

① Base
② Head holder / focus system

③ Pillar
④ Dust cover

3.6 ST-152

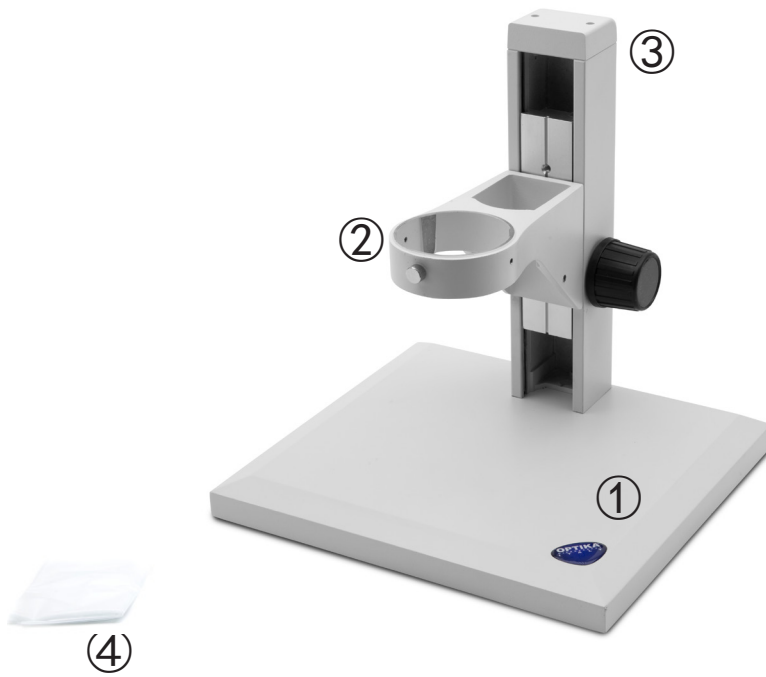

- ① Base
- ② Head holder / focus system

- ③ Pillar
- ④ Dust cover

3.7 SZ-ST1



- ① Base
- ② Stage clips (one pair)

- ③ Black/white plate

3.8 SZ-ST2 / SZ-ST3



- ① Base
- ② Transparent disc
- ③ Stage clips (one pair)
- ④ Incident light illuminator
- ⑤ Black/white plate
- ⑥ Power supply

3.9 SZ-ST7 / SZ-ST8



- ① Base
- ② Transparent disc
- ③ Stage clips (one pair)
- ④ Black/white plate
- ⑤ Self-supporting led light guides
- ⑥ Power supply


3.10 SZ-OBL



- ① Base
- ② Pillar
- ③ Glass plate

- ④ Power supply
- ⑤ Dust cover


3.11 SZ-STL1

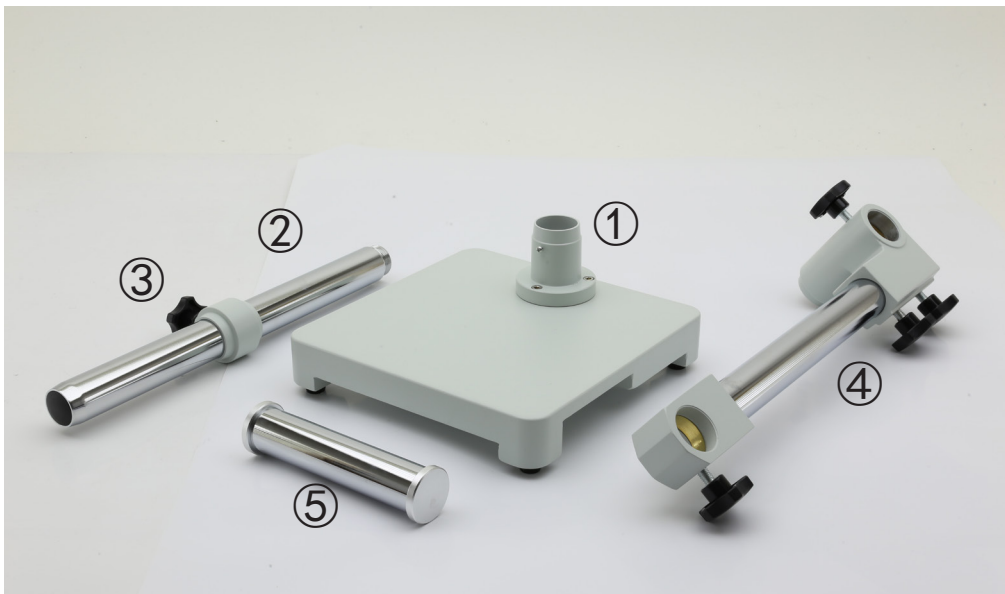

- ① Base
- ② Pillar
- ③ Drop prevention ring


- ④ Horizontal arm
- ⑤ Focus holder arm

3.12 SZ-STL2

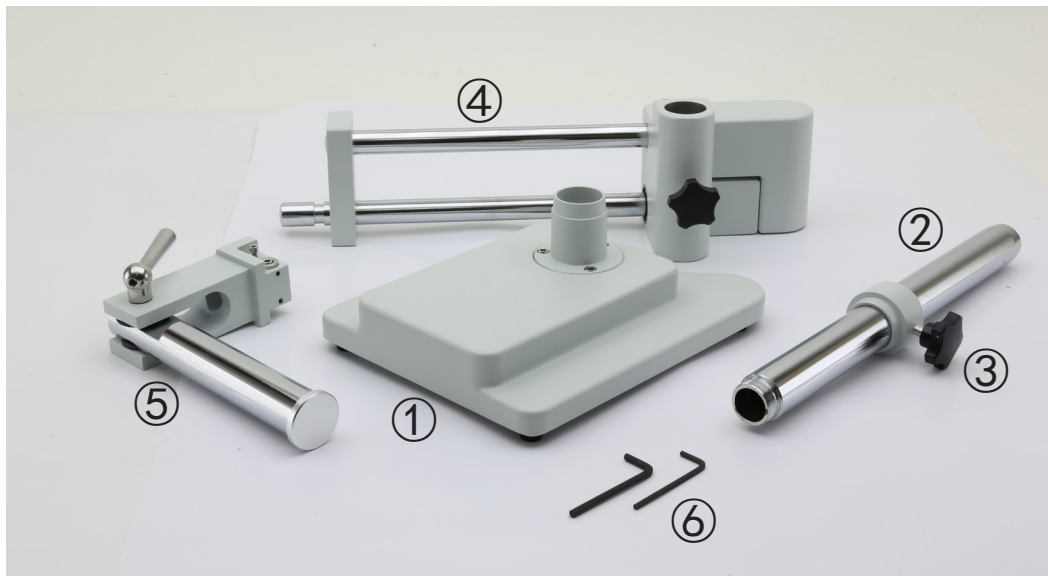


- ① Base
- ② Pillar
- ③ Drop prevention ring
- ④ Horizontal arm
- ⑤ Focus holder arm
- ⑥ Allen wrenches

3.13 SZ-STLX

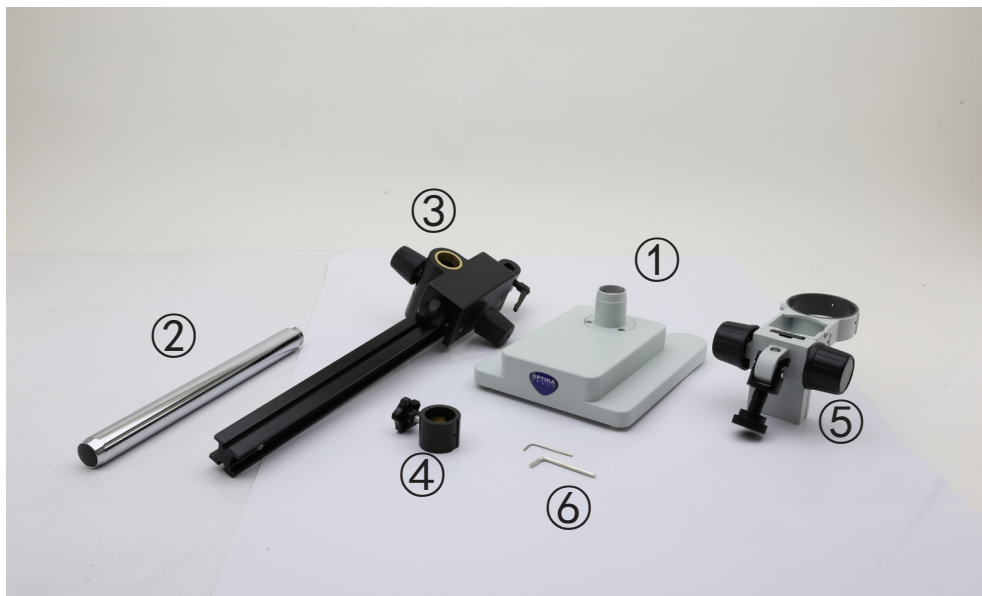

- ① Base
- ② Pillar
- ③ Horizontal arm
- ④ Drop prevention ring
- ⑤ Focus system
- ⑥ Allen wrenches



3.14 SZ-STL5

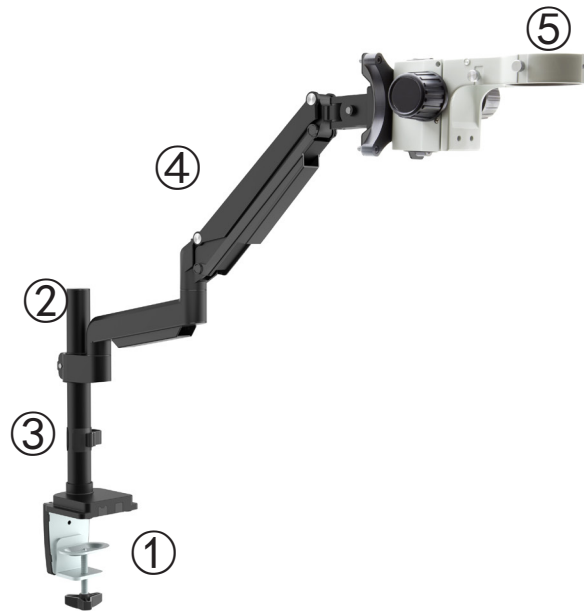

- ① Table clamp
- ② Pillar
- ③ Drop prevention ring
- ④ Horizontal arm
- ⑤ Head holder / focus system
- ⑥ Cable clamps
- ⑦ Round gasket

- ⑧ Short screws M4x12 mm (4 pcs)
- ⑨ Long screws M4x25 mm (4 pcs)
- ⑩ Allen Wrenches
- ⑪ Rubber feet (4 pcs)
- ⑫ Rectangular gasket
- ⑬ Table clamp for big thickness

3.15 SZ-STL5LED

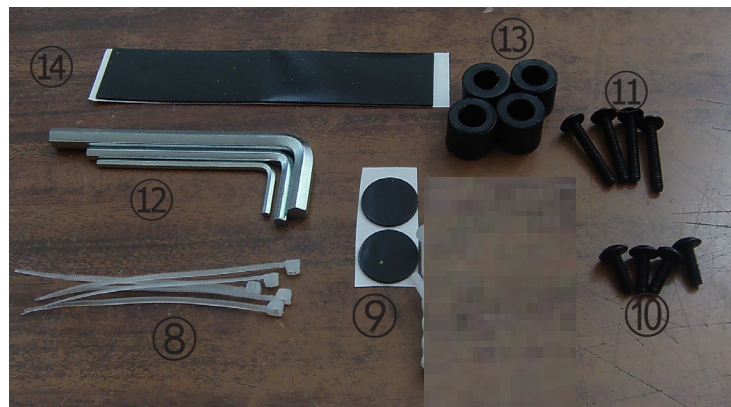

- | | |
|--|---------------------------------|
| ① Table clamp | ⑨ Round gasket |
| ② Pillar | ⑩ Short screws M4x12 mm (4 pcs) |
| ③ Drop prevention ring | ⑪ Long screws M4x25 mm (4 pcs) |
| ④ Horizontal arm | ⑫ Allen Wrenches |
| ⑤ Head holder / focus system | ⑬ Rubber feet (4 pcs) |
| ⑥ LED self supporting arms | ⑭ Rectangular gasket |
| ⑦ Illumination control box with power supply | ⑮ Table clamp for big thickness |
| ⑧ Cable clamps | |

4. Unpacking

The microscope is housed in a moulded Styrofoam container. Remove the tape from the edge of the container and lift the top half of the container. Take some care to avoid that the optical items (objectives and eyepieces) fall out and get damaged. Using both hands (one around the arm and one around the base), lift the microscope from the container and put it on a stable desk.



Do not touch with bare hands optical surfaces such as lenses, filters or glasses. Traces of grease or other residuals may deteriorate the final image quality and corrode the optics surface in a short time.

5. Intended use

Standard models

For research and teaching use only. Not intended for any animal or human therapeutic or diagnostic use.

IVD Models

Also for diagnostic use, aimed at obtaining information on the physiological or pathological situation of the subject.

6. Symbols and conventions

The following chart is an illustrated glossary of the symbols that are used in this manual.



CAUTION

This symbol indicates a potential risk and alerts you to proceed with caution.



ELECTRICAL SHOCK

This symbol indicates a risk of electrical shock.

7. Instrument description

7.1 System Diagram



7.2 SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA





7.3 SZO-B / SZO-T




7.4 SZ-A1




7.5 SZ-A6

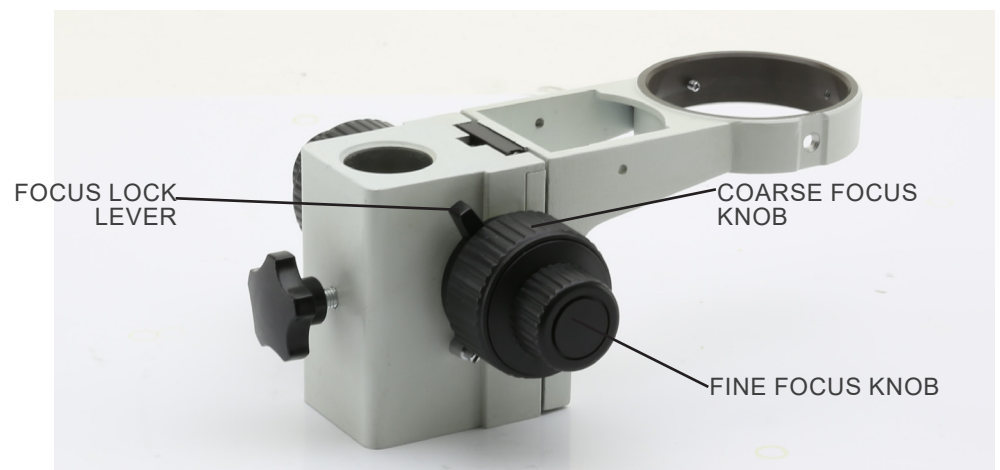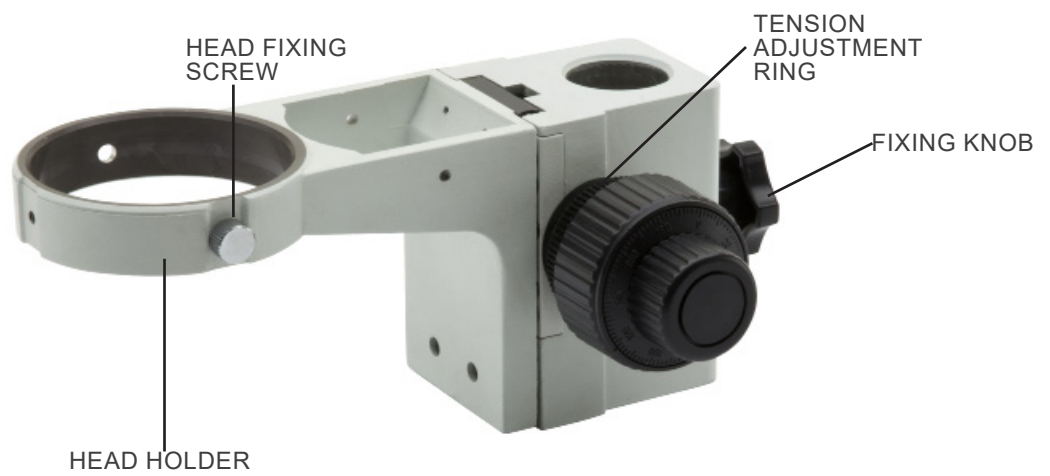


7.6 ST-150

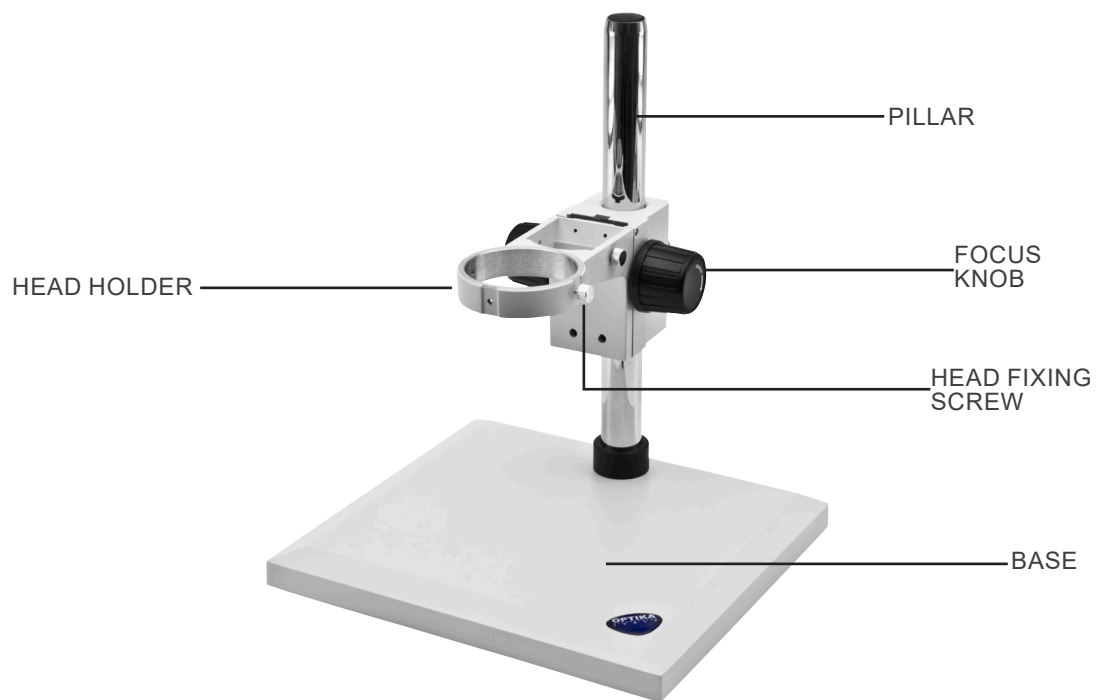


7.7 ST-152

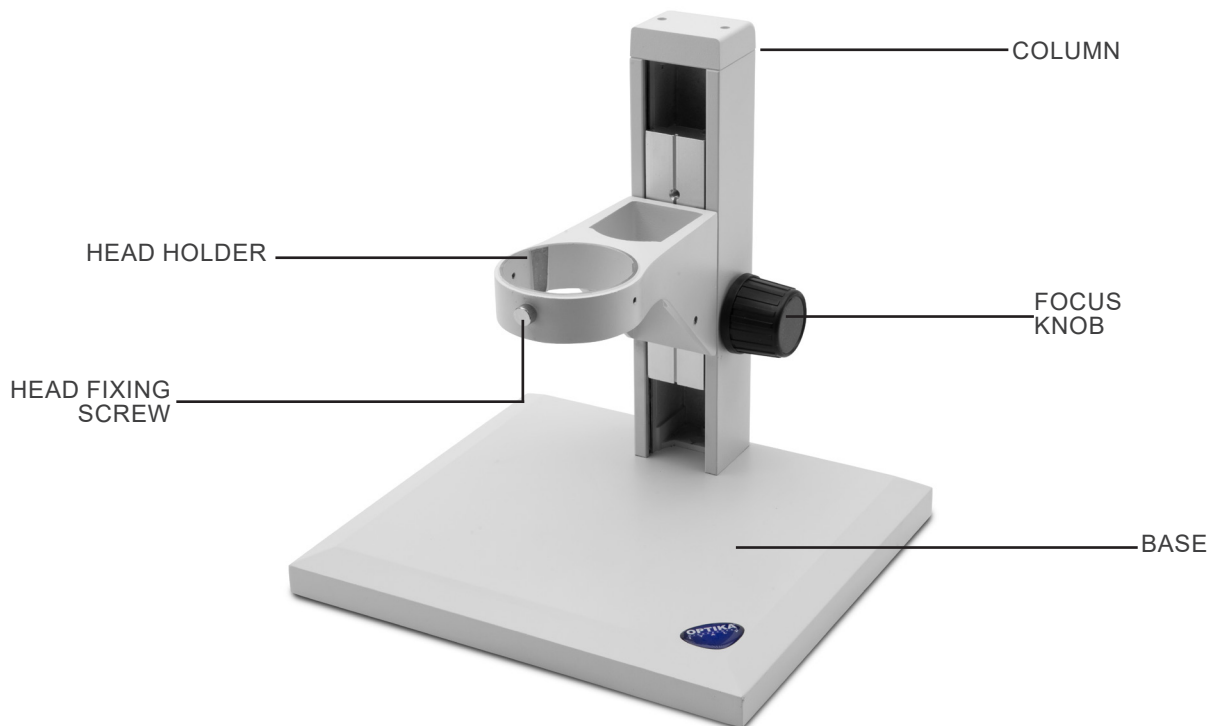


7.8 SZ-ST1

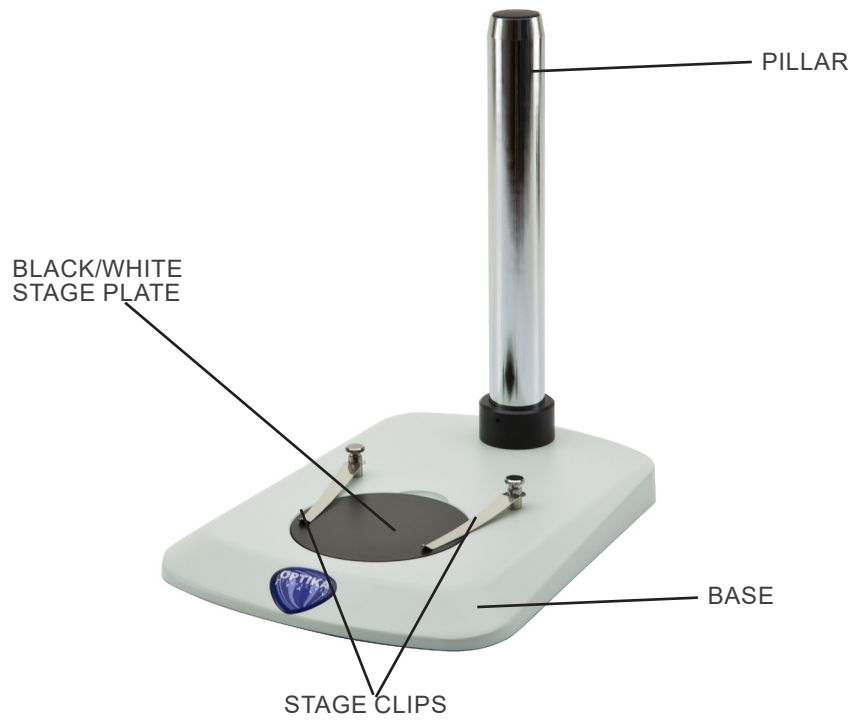


7.9 SZ-ST2 / SZ-ST3

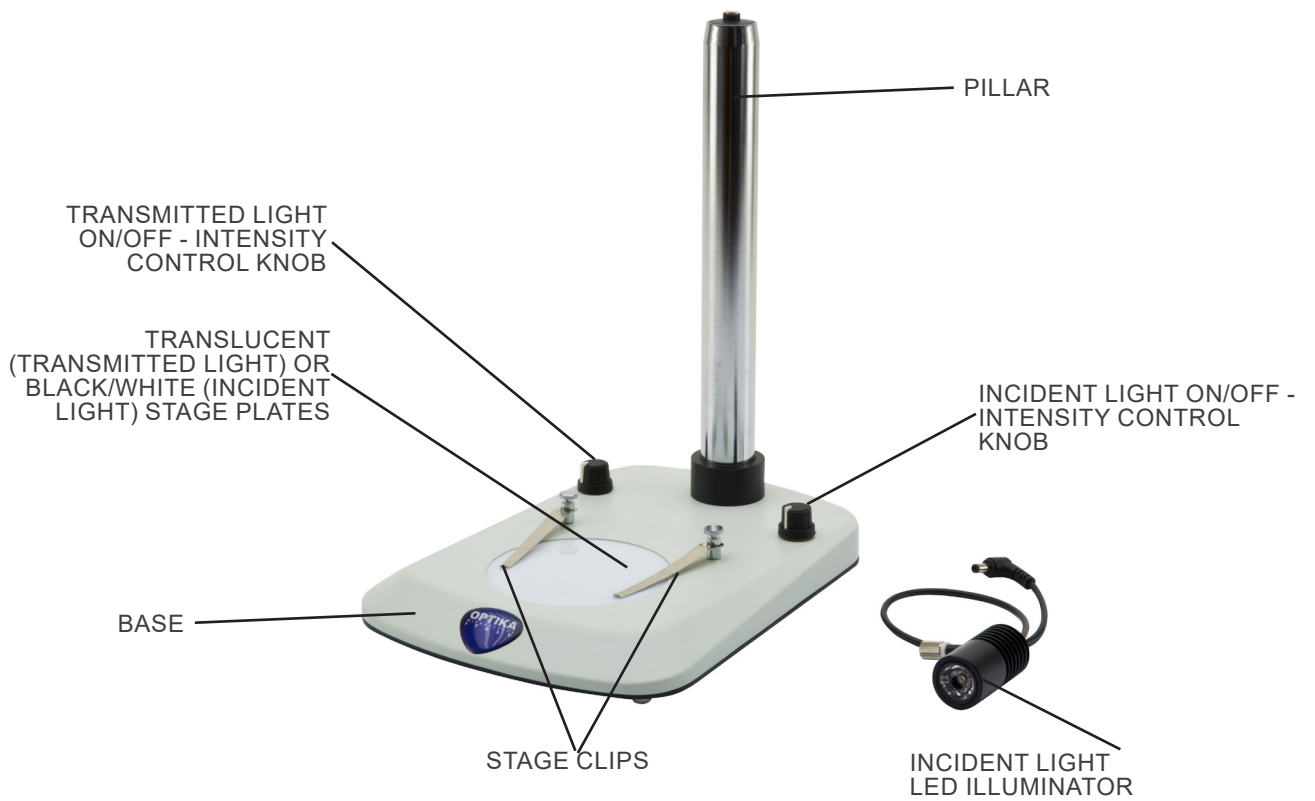


7.10 SZ-ST7 / SZ-ST8

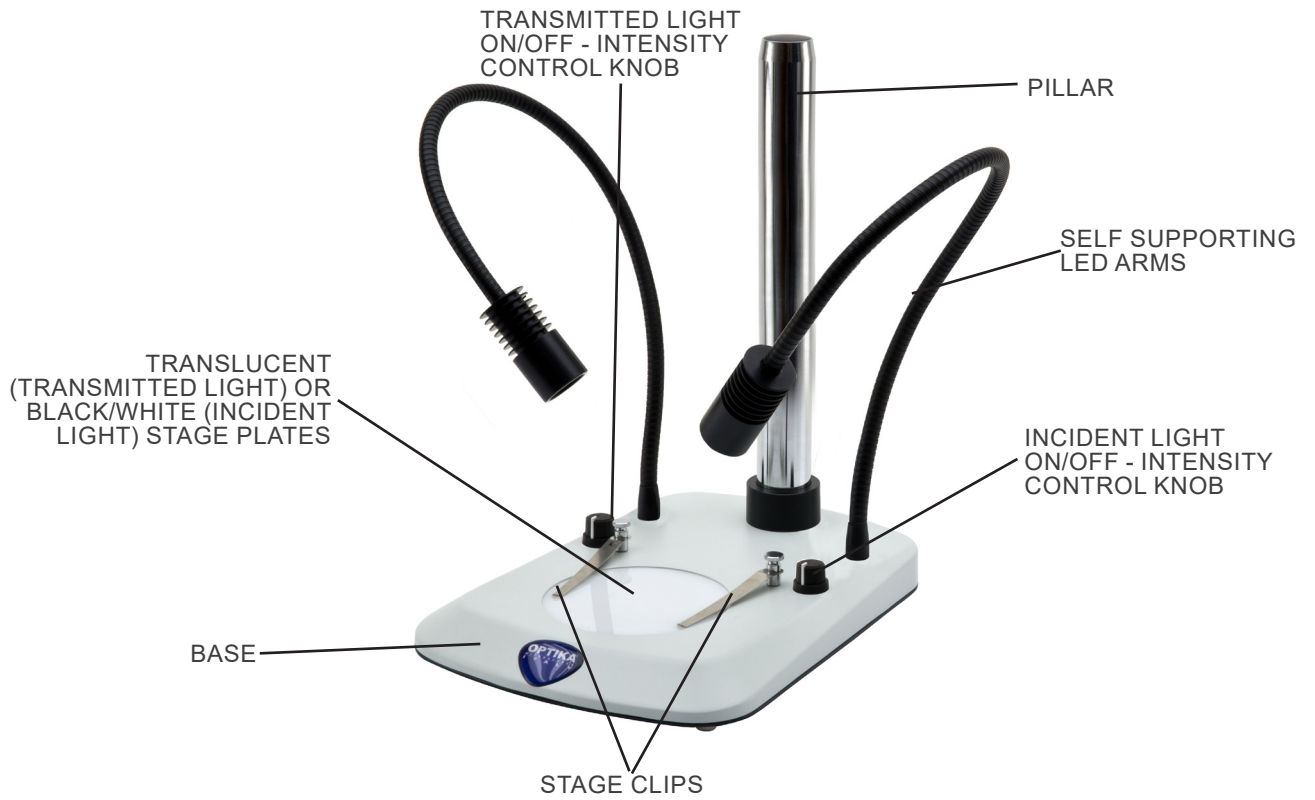


7.11 SZ-OBL

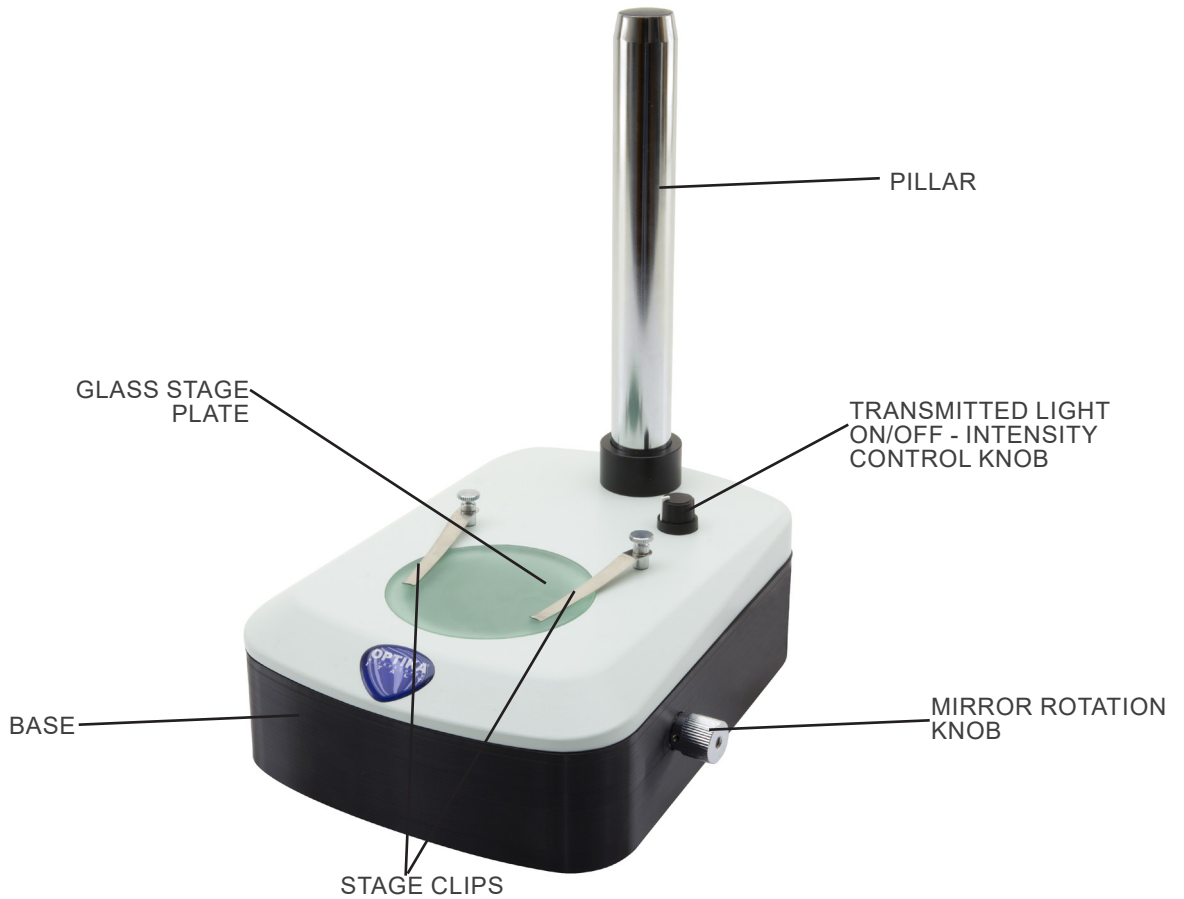


7.12 SZ-STL1

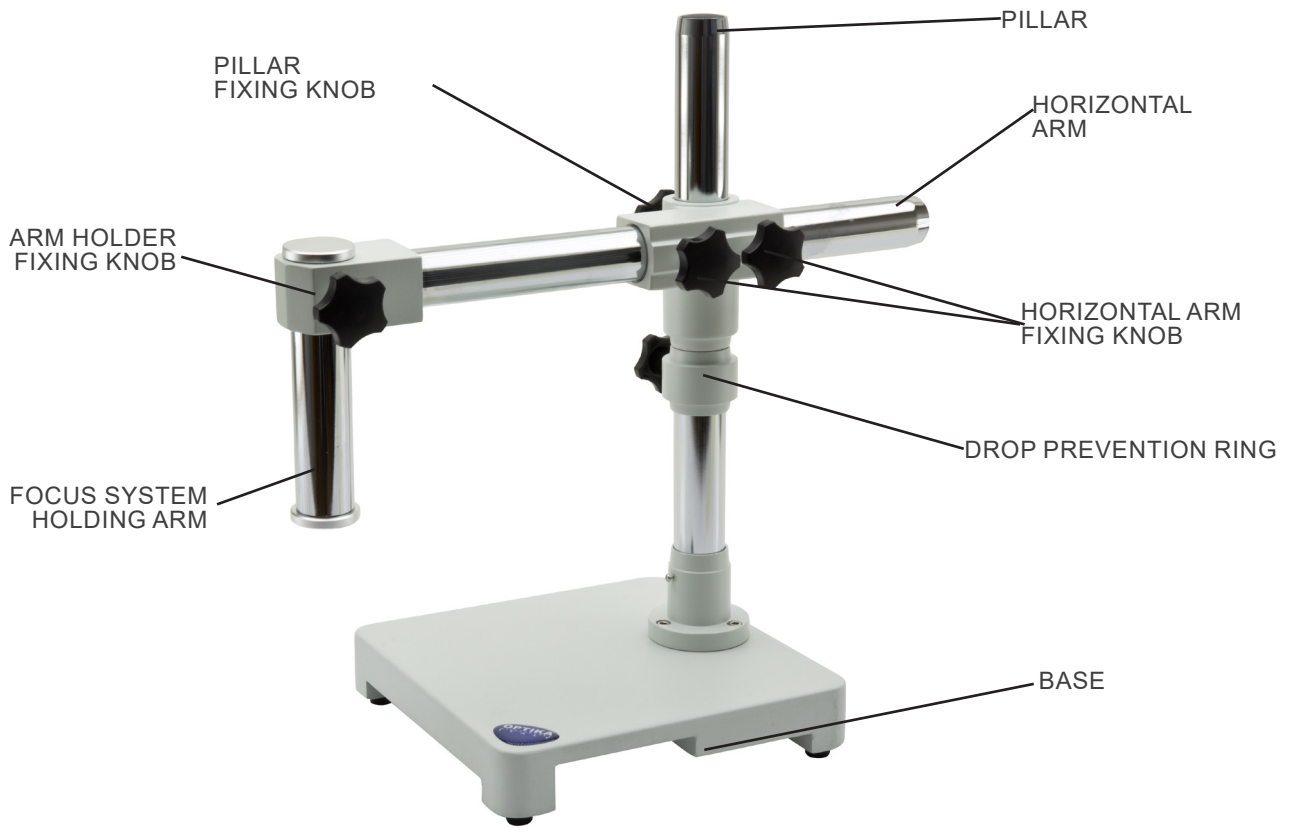


7.13 SZ-STL2

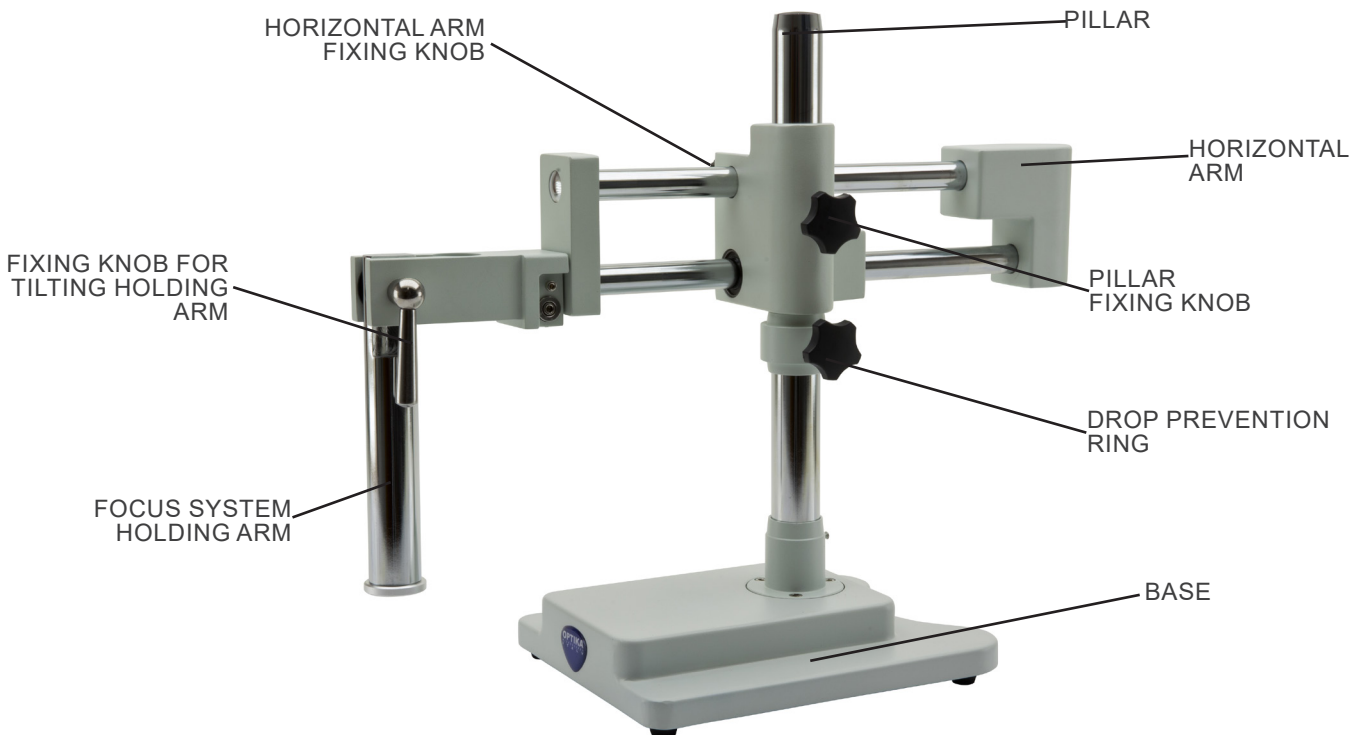


7.14 SZ-STLX

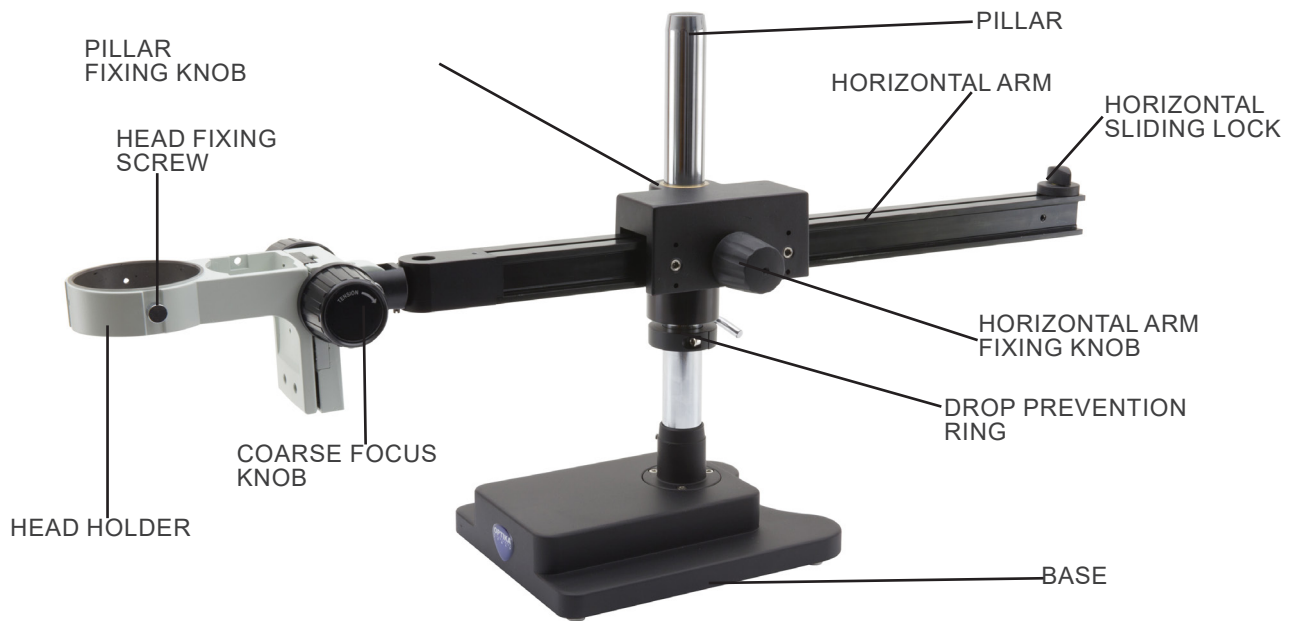

7.15 SZ-STL5

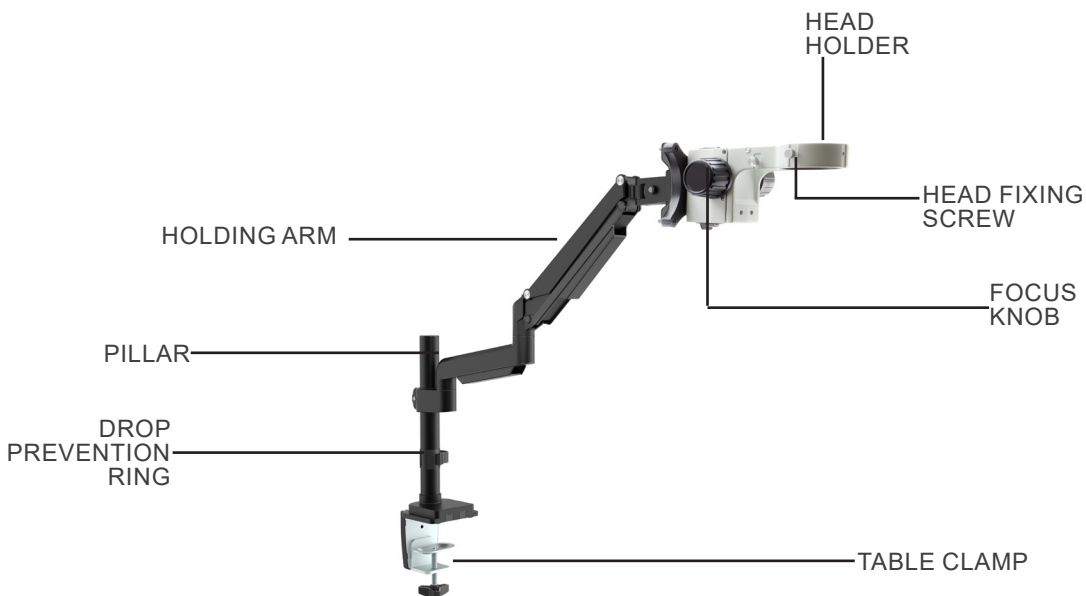


7.16 SZ-STL5LED

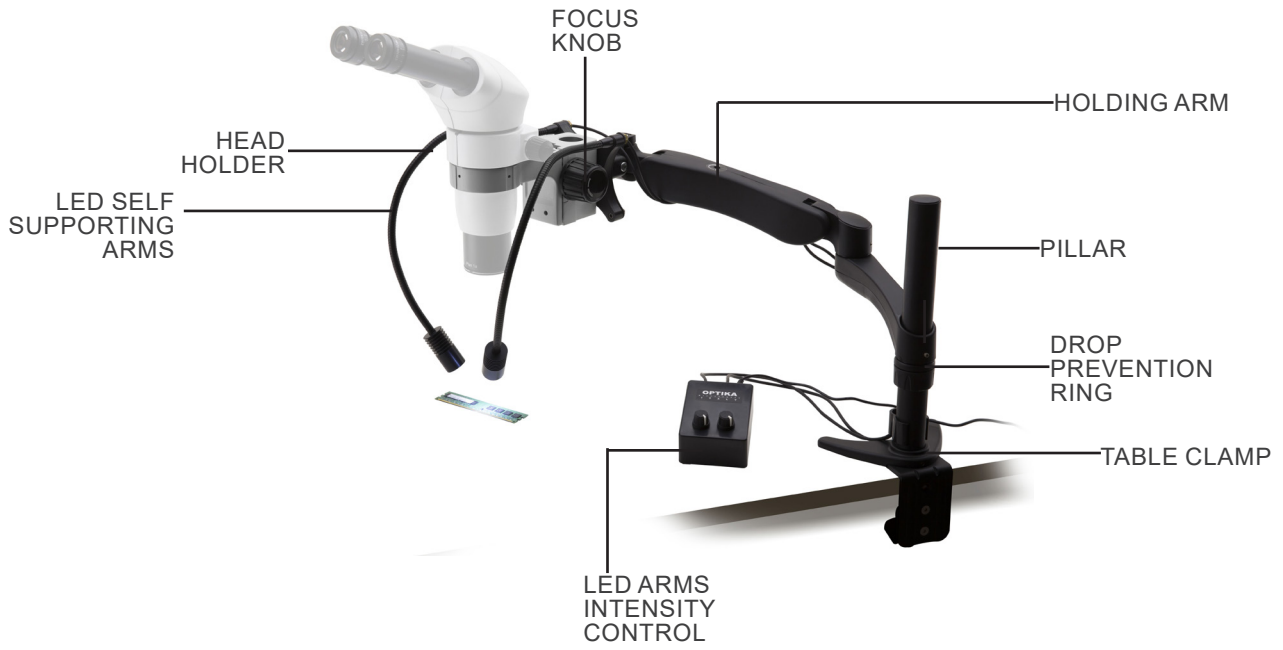

8. Assembling

8.1 SZ-A1 / SZ-A6

- The mounting of the SZ-A1 and SZ-A6 focusing systems applies to all bases except ST-152, SZ-STL1, SZ-STL2, SZ-STLX and SZ-STL5. For the assembling procedure on these bases, please refer to the specific section.
1. Place the focusing system on the column and, once the desired height is reached, tighten the locking knob ① located on the back of the focusing system. (Fig. 1)

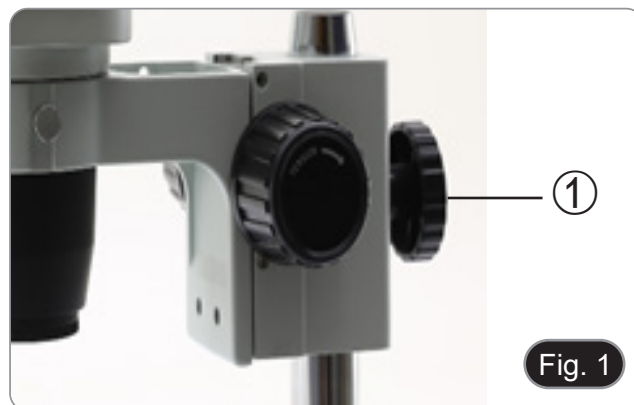

8.2 SZ-ST1 / ST-150

1. Remove the base from its packaging and place it on a flat surface. The base is already assembled from the factory and does not require any further assembly procedure other than that of mounting the focusing system.

8.3 ST-152


1. Remove the base from its packaging and place it on a flat surface. The base is already assembled from the factory and does not require any further assembly.

8.4 SZ-ST2 / SZ-ST3

1. Install the LED spotlight for incident light as shown in Fig. 2.
 - By loosening the fixing screw ② you can change the angle of inclination of the spotlight to optimize the illumination on the sample.



2. Insert the cable plug into the socket at the top of the pillar ③. (Fig. 3)

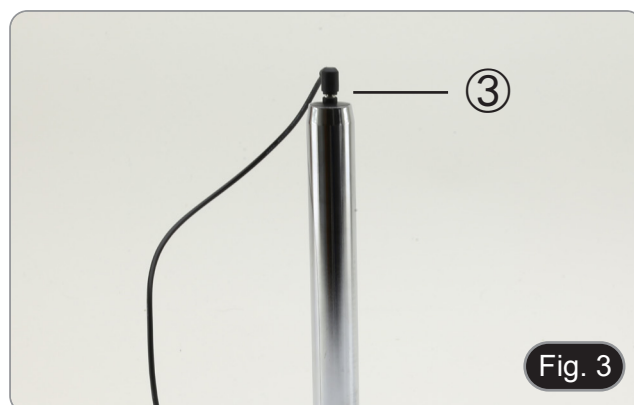

3. Connect the power supply plug to the socket on the back of the microscope base. (Fig. 4)



8.5 SZ-ST7 / SZ-ST8 / SZ-OBL

1. Remove the base from its packaging and place it on a flat surface. The base is already assembled from the factory and does not require any further assembly procedure other than that of mounting the focusing system.
2. Connect the power supply plug to the socket on the back of the microscope base. (Fig. 4)

8.6 SZ-STL1

1. Screw the pillar on the base. (Fig. 5)



2. Tighten the screw to lock the pillar. (Fig. 6)



3. Insert the drop preventing ring and fix it at the desired height by screwing the fixing knob. (Fig. 7)



4. Insert the horizontal arm and secure it with the fixing screw ①. (Fig. 8 - 9)



5. Install the head holder. Unscrew the locking knob ③ and insert the arm for the focus support from above ② into the hole of the horizontal arm. (Fig. 10-11)



6. Once fully inserted, tighten the fixing screw ④ (Fig. 11)



7. Insert from below the focusing system, tighten the fixing screw ⑤ and re-tighten the locking knob ③ from below. (Fig. 12-13)



8.7 SZ-STL2

1. Screw the pillar on the base. (Fig. 14)



2. Tighten the screw to lock the pillar. (Fig. 15)




3. Insert the drop preventing ring and fix it at the desired height by screwing the fixing knob. (Fig. 16)





4. Insert the horizontal arm and secure it with the fixing screw ① (Fig. 17).



5. For a bigger safety, lock the fixing screw ② with the provided Allen wrench. (Fig. 18)

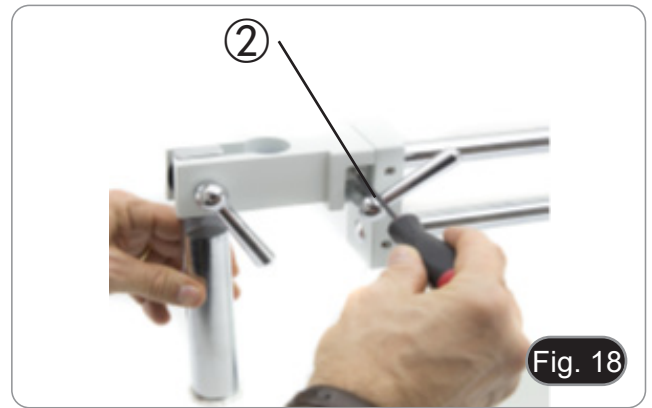

6. Install the head holder. Unscrew the prevention knob ③ and insert the head holder from below in the pillar. Lock the fixing knob ④. At the end screw again the prevention knob ③. (Fig. 19-20)

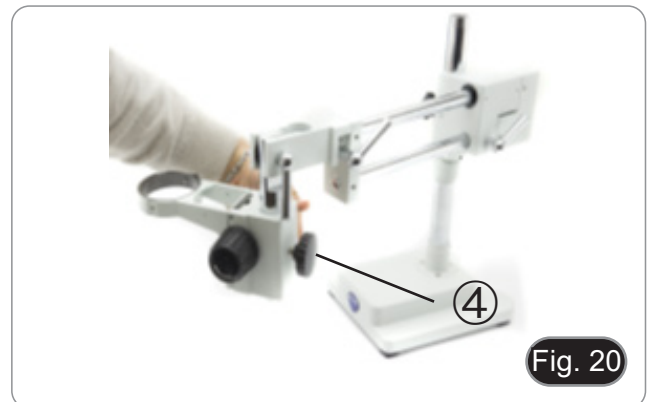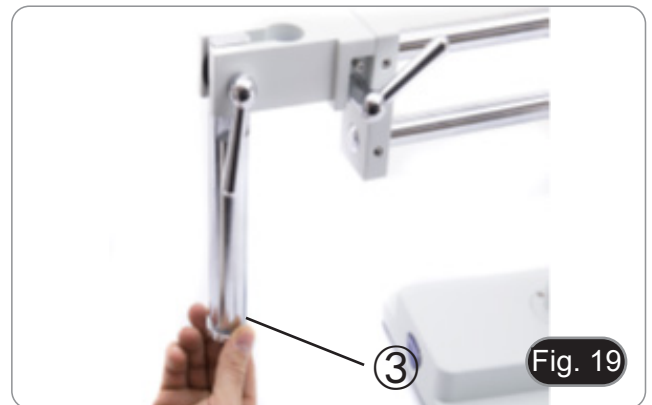

8.8 SZ-STLX

1. Screw the pillar on the base. (Fig. 21)



2. Tighten the screw to lock the pillar. (Fig. 22)



3. Insert the drop preventing ring and fix it at the desired height by screwing the fixing knob. (Fig. 23)



4. Insert the horizontal arm and secure it with the fixing screw ①. (Fig. 24)





5. Head holder can be installed in several ways according to specific need of the user.

Installation mode n° 1: (Fig. 25-27)

Insert the rear part of the head support (round black part) ③ (Fig. 25) from the top into the hole of the horizontal arm ④ and screw in the prevention knob ② from the bottom.

- **This mode allows the installation of heavy heads (or with heavy cameras installed on top of the head).**

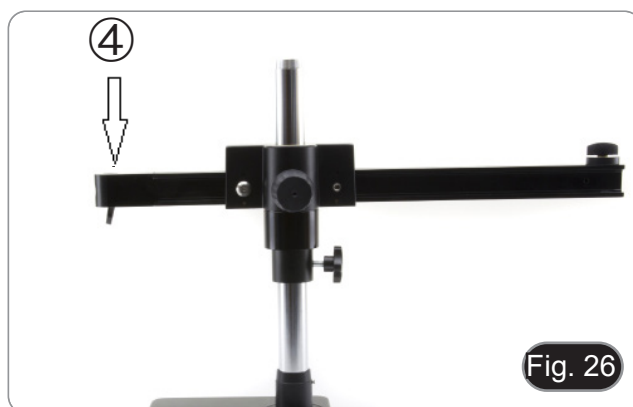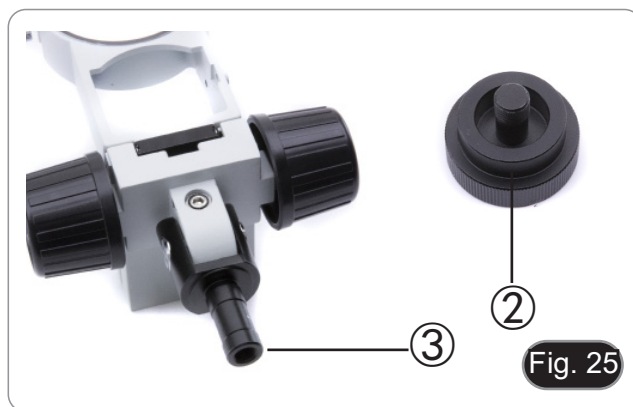

Installation mode n° 2: (Fig. 28-29)

Insert the rear part of the head support (round black part) ③ (Fig. 28) from below into the hole in the horizontal arm and screw in the prevention knob ② from above.



- These two modes allow the tilting of the head. (Fig. 29)



Installation mode n° 3: (Fig. 30)

Insert the back part of the head holder (black round part) ③ (Fig. 25) in the hole at the end of the horizontal arm and tighten the knob ⑤.




- This mode allows the swivel of the head. (Fig. 31).



8.9 SZ-STL5 / SZ-STL5LED


1. Adjust the height of the Desk Clamp ① to suit desktop surface. (Fig. 32)

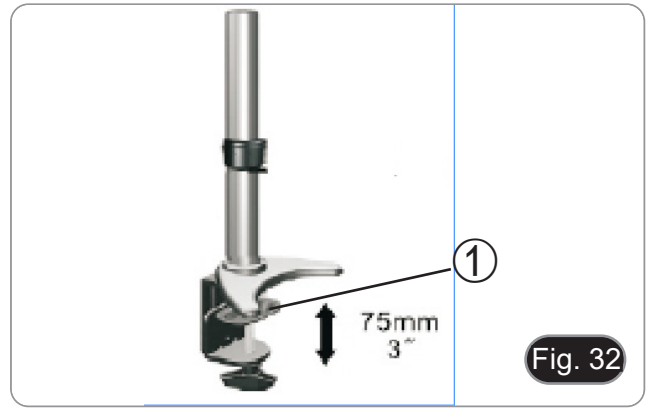


2. Attach the Desk Clamp ① on to the edge of the desk in the desired position and with the clamp opening facing towards the edge of desktop (Fig. 33). Tighten by hand the knob ② to ensure that the Desk Clamp fully clamps to the desktop surface and is secure. (Fig. 34)



3. To position the Collar at your desired height, you will need to loosen the Collar as shown. Tighten by hand until the Collar is firmly in place. (Fig. 35)

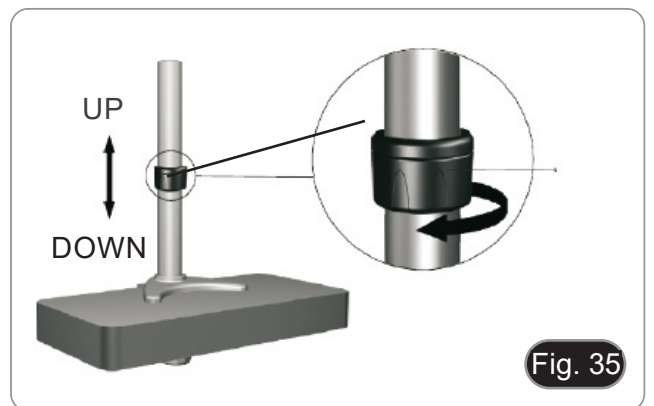

4. Mount the focus on to the arm, using the provided screws and Allen wrench. (Fig. 36)

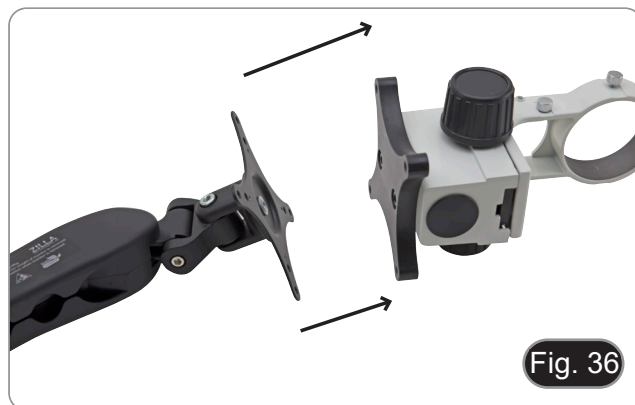

8.10 Installing the head (all models)

Install the head and screw the fixing knob. (Fig. 37)




8.11 Installing the eyepieces (all models)

1. Remove the dust caps from the eyepiece sleeves and insert the eyepieces. (Fig. 38)
2. Lock the eyepieces by tightening the locking screw ①.




8.12 Installing the photo port (SZX-T / TA)

1. Loosen the fixing screws ① of the supplied photo port and remove the existing photo port. (Fig. 39)

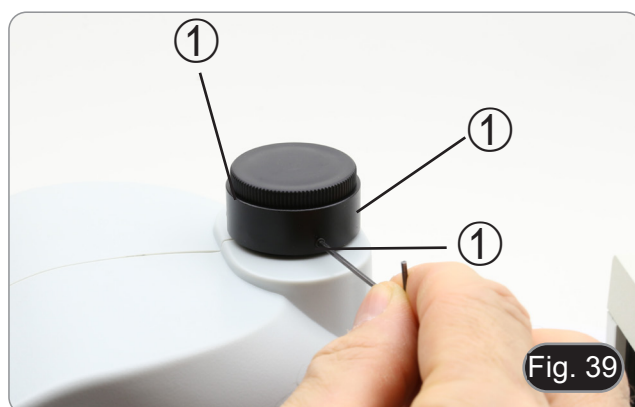

2. Insert the ring of the photo port ② making sure to leave the fixing screw of the photo adapter ③ facing right. (Fig. 40)
3. Lock the fixing screws ①. (Fig. 39)

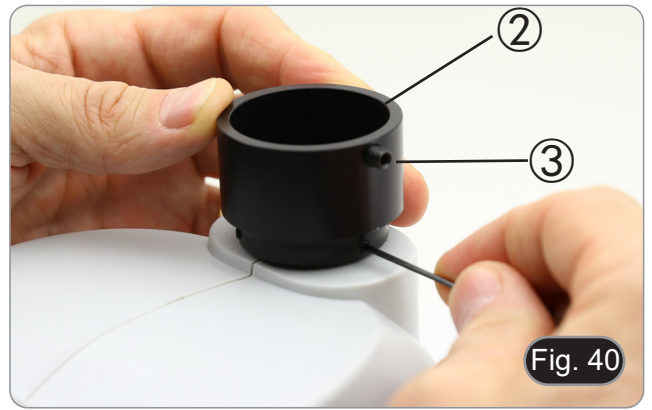

9. Use of the microscope

9.1 Adjusting interpupillary distance

1. Hold the right and left eyepiece tube with both hands and adjust the interpupillary distance by moving the two parts until one circle of light can be seen.
 - If two circles appear, the interpupillary distance is too big, and if two overlapped circles appear, the interpupillary distance is too small. (Fig. 41)



9.2 Focusing

Put the sample to be observed on the stage plate and focus the sample using the focusing knobs ①.

- If necessary adjust the height of the microscope head along the vertical stand.
- Remember to lock the fixing knob ② after setting the height of the microscope. (Fig. 42)




9.3 Adjusting the tension of the focus knob

- This adjustment allows to increase or decrease the tension of the knob by avoiding an involuntary descent of the microscope body under its own weight. Adjust the tension just above the point where the focus is stable.


9.3.1 SZ-A1

1. Grab the knobs ③ both hands and, while holding the left knob, turn the right knob.
 - The tension increases or decreases depending on the direction of rotation of the right knob. (Fig. 43)

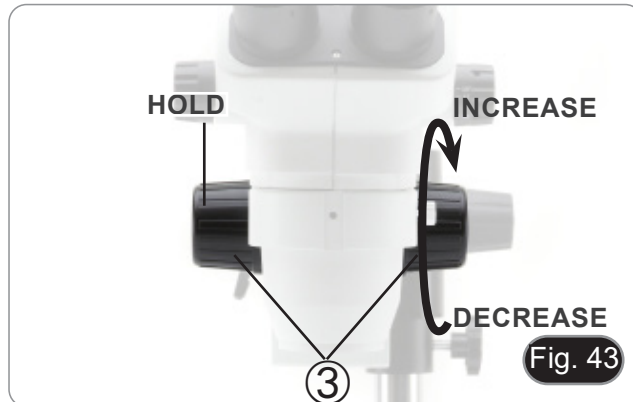


9.3.2 SZ-A6

1. Turn the adjusting ring ④ clockwise until the desired tension is achieved.
 - Turning it counterclockwise will cause the tension to drop, resulting in a loss of focus. (Fig. 44)

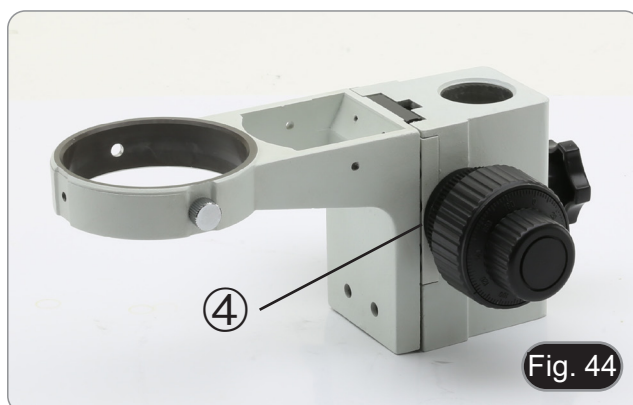

9.4 Focus lock lever (SZ-A6)

1. The lock lever serves as the focus memory function. After focusing the sample, pull the lever ① towards the front of the microscope and lock it. (Fig. 45)
 - This defines the upper focus point.
2. Now you can move the focus of the microscope with the coarse knob, replace the sample and then bring the system back to the upper point: the sample will be approximately in focus and you will only have to make a fine adjustment to obtain the optimal focus.
 - The micrometric movement is not affected by the focus block.
- **To remove the lock, move the lever in the opposite direction to the one used for the lock.**

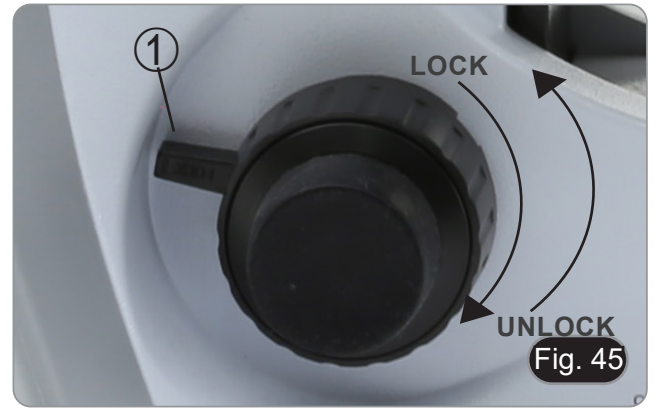

9.5 Diopter compensation

- **This compensation makes possible for people wearing glasses to adjust the microscope to their eyes and use the microscope without glasses.**
1. Put the zoom down to the lowest magnification ② and focus the specimen with the focusing knobs ③. (Fig. 46)
 2. Put the zoom to the maximum magnification and repeat the focusing.
 3. Return to the lowest magnification: the specimen will be out of focus.
-
4. Adjust the diopter compensation ring of the right eyepiece ④ (Fig. 47) until the image of the right eyepiece is clear and sharp. Repeat the procedure for the left eyepiece.
 5. Check the focus of the image for the whole zoom range. It should be perfectly parfocal (focus is maintained during the change of magnification).



9.6 Magnification

1. Select the desired magnification by adjusting the zoom knob ①. (Fig. 48)
- Change the eyepieces and/or add an appropriate additional lens if needed.
 - **Only for SZO series:** The microscope body is equipped with a “click-stop” function that allows to obtain a precise setting of the desired magnification (Fig. 43). Click stop can be activated or deactivated by operating with the provided Allen wrench in the hole placed in the right side of the microscope body.



Fig. 48

9.7 Use of additional lens

1. Screw the desired additional lens on the microscope body. (Fig. 49 has a specific Working Distance.)
- The stroke of the focus adapter could not compensate the different working distances of the several additional lenses.
 - In the event that the focus support fails to focus the sample, the entire body of the microscope must be raised or lowered.

Total magnification used can be calculated as:
 Eyepiece magnification * Zoom magnification * Objective lens magnification.



Fig. 49

SZX Series (0.67x - 4.5x / F.N. 22 mm)

Eyepiece	10x		15x		20x		25x	
Field Number (mm)	22		16		12		9	
Objective	Total Mag.	F.O.V. (mm)	Total Mag.	F.O.V. (mm)	Total Mag.	F.O.V. (mm)	Total Mag.	F.O.V. (mm)
0.3X	2.01X-13.5X	109.45-16.30	3.02X-20.25X	79.60-11.85	4.02X-27X	59.70-8.89	5.03X-33.75X	44.78-6.67
0.5X	3.35X-22.5X	65.67-9.78	5.03X-33.75X	47.76-7.11	6.7X-45X	35.8-5.33	8.38X-56.25X	26.87-4.00
0.75X	5.03X-33.75X	43.78-6.52	7.54X-50.63X	31.84-4.74	10.05X-67.5X	23.88-3.56	12.56X-84.37X	17.91-2.67
1X	6.7X-45X	32.84-4.89	10.05X-67.5X	23.88-3.56	13.4X-90X	17.91-2.67	16.75X-112.5X	13.43-2.00
1.5X	10.05X-67.5X	21.89-3.26	15.08X-101.25X	15.92-2.37	20.1X-135X	11.94-1.78	25.13X-168.75X	8.96-1.33
2X	13.4X-90X	16.42-2.44	20.1X-135X	11.94-1.78	26.8X-180X	8.96-1.33	33.5X-225X	6.72-1.00

SZX-A Series (0.65x - 5.5x / F.N. 23 mm)

Eyepiece	10x		15x		20x		25x	
Field Number (mm)	23		16		12		9	
Objective	Total Mag.	F.O.V. (mm)	Total Mag.	F.O.V. (mm)	Total Mag.	F.O.V. (mm)	Total Mag.	F.O.V. (mm)
0.3X	1.95X-16.5X	117.95-13.94	2.93X-24.75X	82.05-9.70	3.9X-33X	61.54-7.27	4.88X-41.25X	46.15-5.45
0.5X	3.25X-27.5X	70.77-8.36	4.88X-41.25X	49.23-5.82	6.5X-55X	36.92-4.36	8.13X-68.75X	27.69-3.27
0.75X	4.88X-41.25X	47.18-5.58	7.31X- 61.88X	32.82-3.88	9.75X-82.5X	24.62-2.91	12.19X-103.13X	18.46-2.18
1X	6.5X-55X	35.38-4.18	9.75X-82.5X	24.62-2.91	13X-110X	18.46-2.18	16.25X-137.5X	13.85-1.64
1.5X	9.75X-82.5X	23.59-2.79	14.63X-123.75X	16.41-1.94	19.5X-165X	12.31-1.45	24.38X-206.25X	9.23-1.09
2X	13X-110X	17.69-2.09	19.5X-165X	12.31-1.45	26X-220X	9.23-1.09	32.5X-275X	6.92-0.82

SZO Series (0.67x - 4.5x / F.N. 23 mm)


Eyepiece	10x		15x		20x		25x	
Field Number (mm)	23		16		12		9	
Objective	Total Mag.	F.O.V. (mm)	Total Mag.	F.O.V. (mm)	Total Mag.	F.O.V. (mm)	Total Mag.	F.O.V. (mm)
0.3X	2.01X-13.5X	114.43-17.04	3.02X-20.25X	79.60-11.85	4.02X-27X	59.70-8.89	5.03X-33.75X	44.78-6.67
0.5X	3.35X-22.5X	68.66-10.22	5.03X-33.75X	47.76-7.11	6.7X-45X	35.82-5.33	8.38X-56.25X	26.87-4.00
0.75X	5.03X-33.75X	45.77-6.81	7.54X- 50.63X	31.84-4.74	10.05X-67.5X	23.88-3.56	12.56X-84.38X	17.91-2.67
1X	6.7X-45X	34.33-5.11	10.05X-67.5X	23.88-3.56	13.4X-90X	17.91-2.67	16.75X-112.5X	13.43-2.00
1.5X	10.05X-67.5X	22.89-3.41	15.08X-101.25X	15.92-2.37	20.1X-135X	11.94-1.78	25.13X-168.75X	8.96-1.33
2X	13.4X-90X	17.16-2.56	20.1X-135X	11.94-1.78	26.8X-180X	8.96-1.33	33.5X-225X	6.72-1.00

9.8 Use of additional lenses 0.3X-0.5X

The additional lenses 0.3X and 0.5X have a long working distance and therefore the total stroke of the focusing column cannot compensate.

To make the additional lenses 0.3X and 0.5X work correctly, proceed as follows:

1. Screw the additional lens on the microscope body as already described in chapter 9.7.
2. Uninstall the microscope body from the head holder.
3. Install the spacer ① in the head holder and screw the fixing knob ②. (Fig. 50)
4. Re-install the microscope body onto the spacer and screw the fixing knob ③. (Fig. 51)
5. Begin working normally.

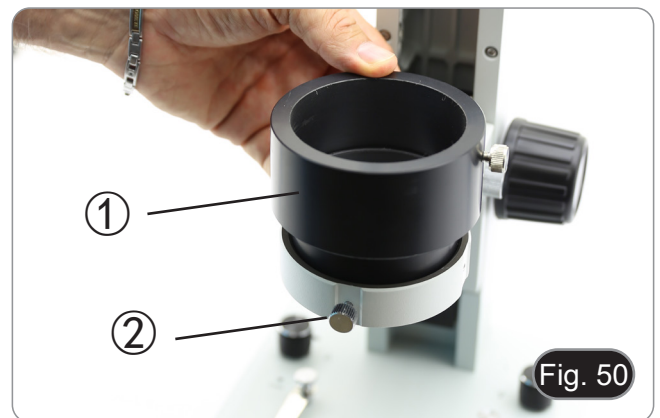


9.9 Black/white stage plate (SZ-ST1 / 2 / 3 / 7 / 8)

You can use a black/white contrast disc to increase the contrast of the image when working in incident light. (Fig. 52). If you are looking at bright samples, place the disc with the black side facing up.



9.10 Use of illumination (SZ-ST2 / 3 / 7 / 8)

1. Turn the transmitted light knob ② in order to turn ON/OFF or to change the intensity of the transmitted light LED. (Fig. 53)
 2. Turn the incident light knob ① in order to turn ON/OFF or to change the intensity of the incident light LED.
- It is possible to use both illuminations at the same time.

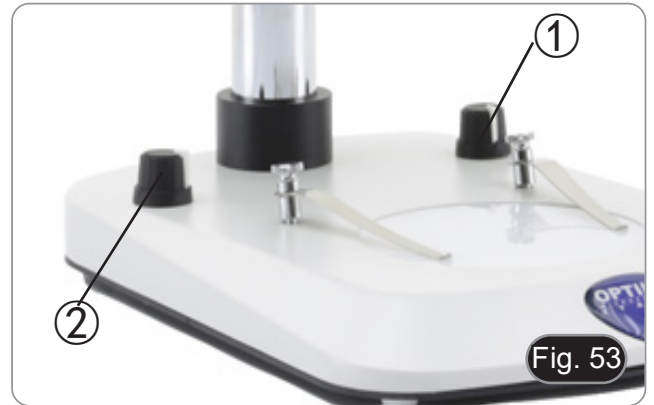

Only for SZ-ST7 / SZ-ST8:

- Tilt and position the self-supporting arms of the base ③ to optimally illuminate the sample. (Fig. 54)
- The arms can be placed individually in the desired position.



9.11 Use of illumination (SZ-OBL)

1. Turn the transmitted light knob ① in order to turn ON/OFF or to change the intensity of the transmitted light LED. (Fig. 55)
 2. Turn the mirror rotation knob ② to tilt the mirror until the desired oblique illumination is obtained.
- The mirror has a smooth surface and a knurled surface. The two surfaces make it possible to optimise observation by providing adequate contrast depending on the sample to be observed.



9.12 Use of eye shields (SZO-B / T)

• Use with eyeglasses

Fold rubber eyeshields with both hands. Folded eyeshields avoid scratching the lenses of eyeglasses. (Fig. 55)



- **Use without eyeglasses**

Raise eye shields and observe at the microscope placing eyes to the shields, avoiding external light to disturb the observation. (Fig. 56)



9.13 Use of overhanging stand

9.13.1 SZ-STL1

Moving the horizontal arm

1. Unlock the knob on the right side of the horizontal arm ①. (Fig. 58)
2. The arm can be extended or shortened according to specific needs. (Fig. 59)




Swivel the head

1. Unlock the fixing knob ① and rotate the head to the desired swivel angle (left or right), then tighten the knob again. (Fig. 60)



Rotating the horizontal arm


1. Loosen the horizontal arm fixing knob ② and rotate the arm, then tighten again the fixing knob. (Fig. 61)
- **NOTE: 180° rotation of the microscope with respect to the base could cause a rollover of the entire system.**

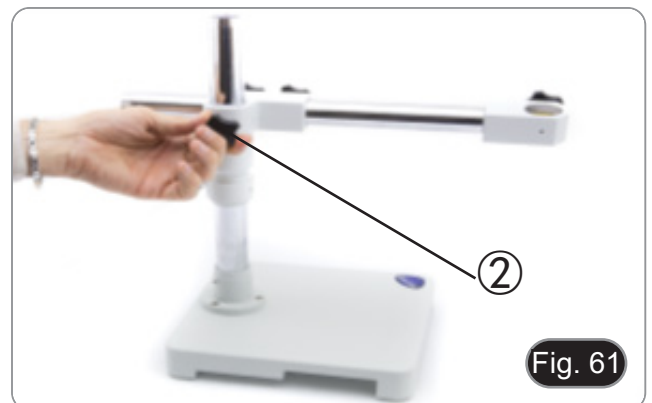

9.13.2 SZ-STL2

Moving the horizontal arm

1. Unlock the knob on the left side of the horizontal arm ①. (Fig. 62)

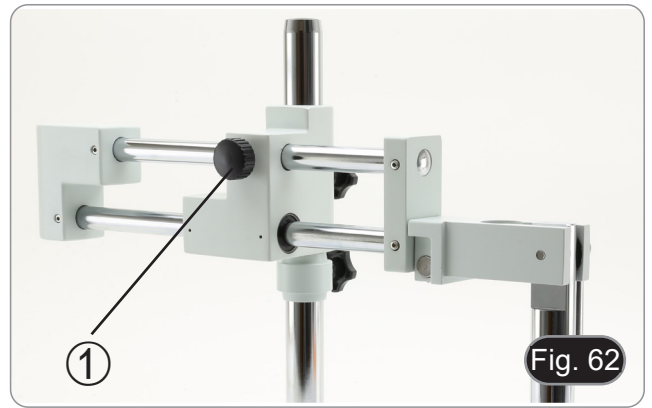

2. The arm can be extended or shortened according to specific needs. (Fig. 63)




Tilting the head holder

1. Loosen the knob ② (Fig. 64) on the right side of the head holder. The tilting pillar can be moved. Once the desired angle is achieved, tighten the knob again.



Swivel the head

1. Unlock the fixing knob ③ and rotate the head to the desired swivel angle (left or right), then tighten the knob again. (Fig. 65-66)

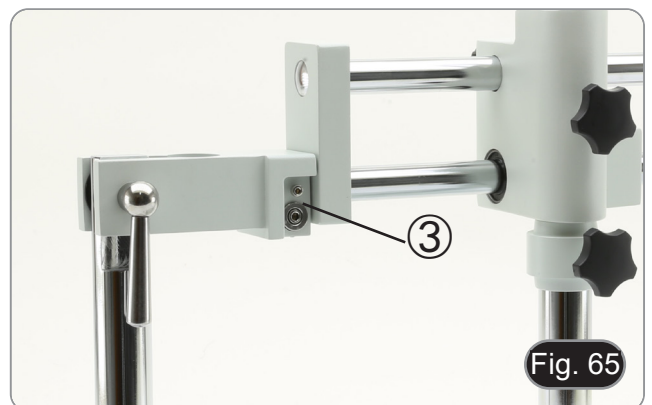



Rotating the horizontal arm


1. Loosen the horizontal arm fixing knob ④ and rotate the arm, then tighten again the knob. (Fig. 67)
- **NOTE: 180° rotation of the microscope with respect to the base could cause a rollover of the entire system.**



9.13.3 SZ-STLX

Moving the horizontal arm

1. Unlock the knob on the right side of the horizontal arm ①. (Fig. 68)

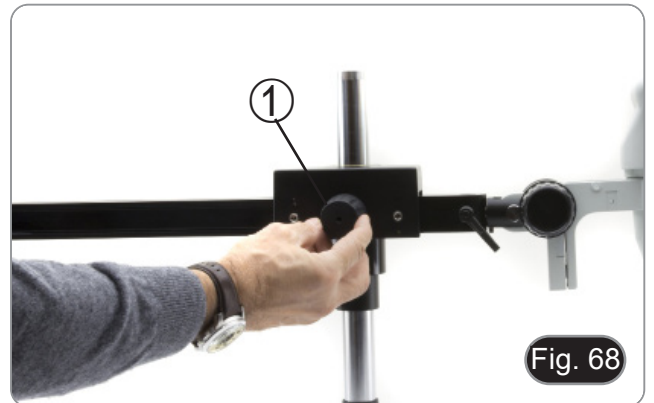


2. The arm can be extended or shortened according to specific needs. (Fig. 69)



Adjusting the horizontal lock

1. Unlock the fixing knob of the stopper ② and move it in a position suitable to user's needs. (Fig. 70)
2. Lock the fixing knob to set the movement limit.

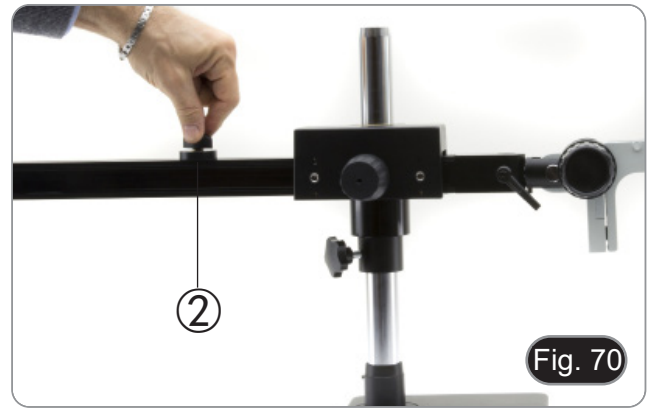

Tilting the head holder

1. Loosen the Allen screw ③ (Fig. 71) on the top of the head holder.
2. The tilting black part can be moved. Once the desired angle is achieved, tighten the wrench again.



Swivel the head

1. Unlock the fixing knob ④ and rotate the head to the desired swivel angle (left or right), then tighten the knob again. (Fig. 72-73)



Rotating the horizontal arm


1. Loosen the horizontal arm fixing knob ⑤ and rotate the arm, then tighten again the knob. (Fig. 74)
- **NOTE: 180° rotation of the microscope with respect to the base could cause a rollover of the entire system.**




9.13.4 SZ-STL5 / SZ-STL5LED

Adjusting the Mount Bracket Resistance



- Product is brilliantly engineered to control the resistance in the Tilting Mount Bracket to suit swing side to side of 90 degree and tilt forward and backward of 90 degree. It is possible to control the amount of resistance in the Tilting Mount Bracket.
1. If the Tilting Mount Bracket tends to automatically fall, it may be required to adjust the Tilting Mount Bracket joint to suit your microscope tilt position of forward and backward of 90 degree. This can be done by using Hex Allen Wrench 6mm to increase the resistant of the Tilting Mount Bracket in order to secure tilt position, adjust the M5x15mm Tension Hex Socket Cap Screw located around the Tilting Mount Bracket Joint using 6mm Hex Allen Wrench. (Fig. 75)

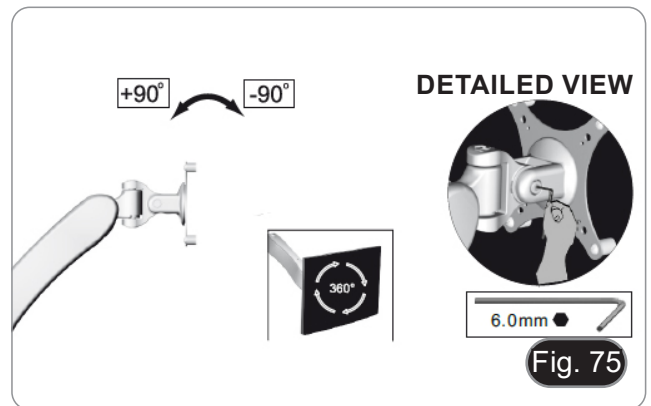

2. To increase or decrease the resistance of the Pivot Joint to suit microscope swing side to side, adjust the Tension Hex Cap Screw located on front side of the Articulating Arm to secure the position. (Fig. 76)
3. To increase the resistance, tighten the M5x15mm Tension Hex Cap Screw using Allen Wrench 4mm in a clockwise direction. To decrease the resistance, loosen the M5x15mm Tension Hex Cap Screw using Allen Wrench 4mm supplied in an anti-clockwise direction.

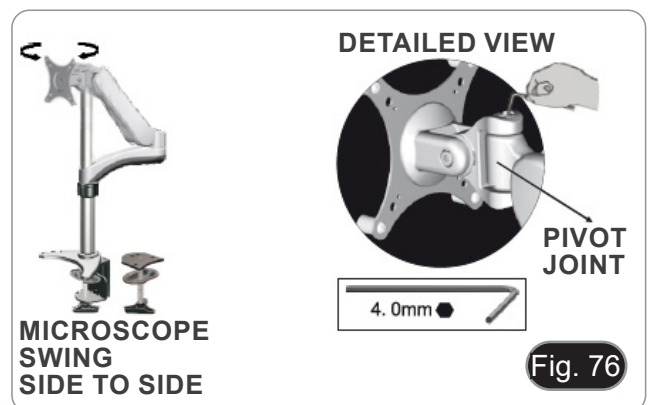

4. This arm can be lift up and down as shown. (Fig. 77).
- If the arm tends to automatically move to side, it may be required tension adjustment on the Articulating Arm to suit your microscope arm swing to side position. This can be done by using Hex Allen Wrench 2.5 mm supplied. (Fig. 78)

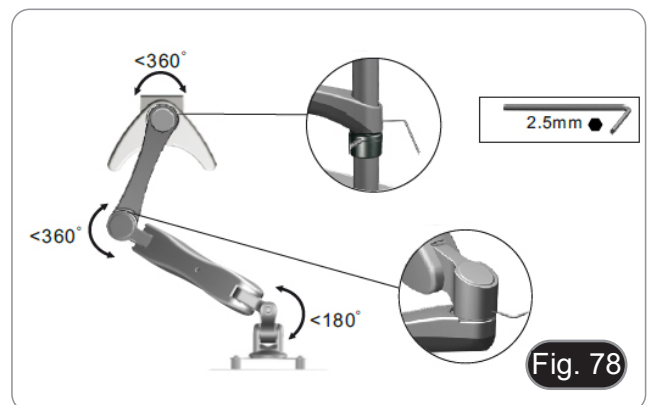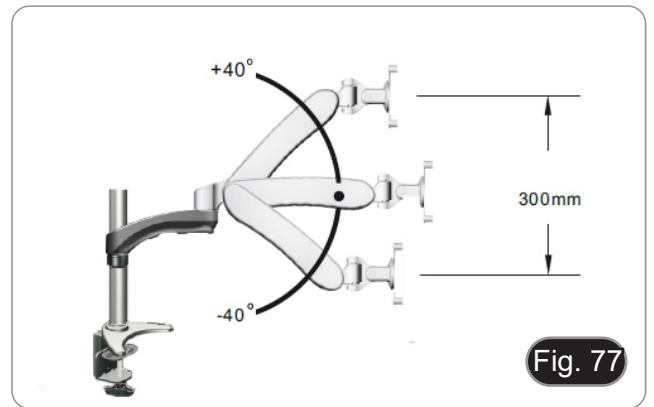

Adjusting the light intensity


Rotate the light intensity adjustment knobs ① to turn ON/OFF and to increase / decrease the light intensity of each single LED arm. (Fig. 79)



10. Microphotography

10.1 Installing the C-mount adapter

1. Loosen the clamping screw ① on the trinocular port and remove the dust cap ②. (Fig. 80)
2. Screw the C-mount adapter ③ to the camera ④ and insert the round dovetail of the C-mount into the empty hole of the trinocular port (Fig. 81), then tighten the clamping screw ①.

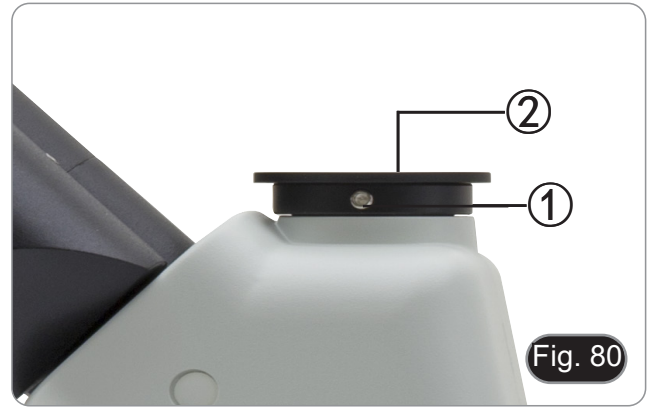

10.2 Use of reflex cameras

1. Insert the Reflex adapter ① into the relay tube ②.
 2. Screw the "T2" ring ③ (not provided) to the reflex adapter.
 3. Connect the Reflex camera ④ to the "T2" ring just installed. (Fig. 82)
 4. Mount the other end of the relay tube ② into the empty hole of the trinocular port, then tighten the clamping screw. (Fig. 80)
- "T2" ring is not provided along with the microscope, but is commercially available.
 - While shooting dark specimens, darken eyepieces and viewfinder with a dark cloth to minimize the diffused light.
 - To calculate the magnification of the camera: objective magnification * camera magnification * lens magnification.
- **When using an SLR camera, mirror movement may cause the camera to vibrate.**
 - **We suggest lifting the mirror, using long exposure times and a remote cord.**



11. Maintenance

Microscopy environment

This microscope is recommended to be used in a clean, dry and shock free environment with a temperature of 5°-40°C and a maximum relative humidity of 75 % (non condensing). Use a dehumidifier if needed.

To think about when and after using the microscope



- The microscope should always be kept vertically when moving it and be careful so that no moving parts, such as the eyepieces, fall out.
- Never mishandle or impose unnecessary force on the microscope.
- Never attempt to service the microscope yourself.
- After use, turn off the light immediately, cover the microscope with the provided dust-cover, and keep it in a dry and clean place.

Electrical safety precautions



- Before plugging in the power supply, make sure that the supplying voltage of your region matches with the operation voltage of the equipment and that the lamp switch is in off- position.
- Users should observe all safety regulations of the region. The equipment has acquired the CE safety label. However, users do have full responsibility to use this equipment safely.

Cleaning the optics

- If the optical parts need to be cleaned try first to: use compressed air.
- If that is not sufficient: use a soft lint-free piece of cloth with water and a mild detergent.
- And as a final option: use the piece of cloth moistened with a 3:7 mixture of ethanol and ether.
- **Note: ethanol and ether are highly flammable liquids. Do not use them near a heat source, near sparks or near electric equipment. Use these chemicals in a well ventilated room.**
- Remember to never wipe the surface of any optical items with your hands. Fingerprints can damage the optics.
- Do not disassemble objectives or eyepieces in attempt to clean them.

For the best results, use the OPTIKA cleaning kit (see catalogue).

If you need to send the microscope to Optika for maintenance, please use the original packaging.

12. Troubleshooting

Review the information in the table below to troubleshoot operating problems.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
I. Optical Section:		
The illumination is ON, but the field of view is dark.	The plug is not connected to the illumination	Connect the cable
	The brightness is too low	Adjust to a proper setting
The edge of the field of view is vignetted or the brightness is asymmetric.	The incident illuminator is not correctly oriented	Change the angle of the incident illuminator
Dust and stains can be seen in the field of view.	There are stains and dust on the specimen	Clean the specimen
	There are stains and dust on the eyepiece	Clean the eyepiece
Poor image quality: <ul style="list-style-type: none"> The image is not sharp The contrast is not high The details are not clear Image glares 	The lenses (additional lens, objective, eyepieces) are dirt	Thoroughly clean all the optical system
One side of the image is out of focus.	The specimen is out of place (tilted)	Place the specimen flat on the stage.
II. Mechanical Section:		
The focus knob is hard to turn.	The tension adjustment collar is too tight	Loosen the tension adjustment collar
The focus is unstable.	The tension adjustment collar is too loose	Tighten the tension adjustment collar
III. Electric Section:		
The LED doesn't turn on.	No power supply	Check the power cord connection
The brightness is not enough	The brightness adjustment is low	Adjust the brightness
The light blinks	The power cord is poorly connected	Check the power cord
IV. Viewing tube assembly:		
The field of view of the two eyes is different	The interpupillary distance is not correct	Adjust the interpupillary distance
	The diopter correction is not right	Adjust the diopter correction
	The viewing technique is not correct, and the operator is straining the eyesight	When look into the eyepieces, do not stare at the specimen but look at the whole field of view. Periodically, move the eyes away to look at a distant object, then back into the eyepieces
V. Microphotography and video:		
The image is unfocused	Incorrect focusing	Adjusting the focus system as in the present manual
Bright patches appear on the image	Stray light is entering the microscope through the eyepieces and through the camera viewfinder	Cover the eyepieces and the viewfinder with a dark cloth

Equipment disposal

Art.13 Dlsg 25 July 2005 N°151. "According to directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC relating to the reduction in the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and waste disposal."



The basket symbol on equipment or on its box indicates that the product at the end of its useful life should be collected separately from other waste. The separate collection of this equipment at the end of its lifetime is organized and managed by the producer. The user will have to contact the manufacturer and follow the rules that he adopted for end-of-life equipment collection. The collection of the equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal, helps to prevent possible adverse effects on the environment and health and promotes reuse and/or recycling of materials of the equipment. Improper disposal of the product involves the application of administrative penalties as provided by the laws in force.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain
spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA
usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China
china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® India
india@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Central America
camerica@optikamicroscopes.com

Serie SZ

MANUALE DI ISTRUZIONI

Modello	
SZ-A1	SZ-A6
SZX-B	SZX-T
SZX-BA	SZX-TA
SZO-B	SZO-T
SZ-ST1	SZ-ST2
SZ-ST3	SZ-ST7
SZ-ST8	SZ-OBL
ST-150	ST-152
SZ-STL1	SZ-STL2
SZ-STLX	SZ-STL5
SZ-STL5LED	

Ver. 2.3 2022



Sommario

1.	Avvertenza	56
2.	Informazioni sulla sicurezza	56
3.	Contenuto della confezione	57
3.1	SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA	57
3.2	SZO-B / SZO-T	58
3.3	SZ-A1	58
3.4	SZ-A6	59
3.5	ST-150	59
3.6	ST-152	60
3.7	SZ-ST1	60
3.8	SZ-ST2 / SZ-ST3	61
3.9	SZ-ST7 / SZ-ST8	61
3.10	SZ-OBL	62
3.11	SZ-STL1	62
3.12	SZ-STL2	63
3.13	SZ-STLX	63
3.14	SZ-STL5	64
3.15	SZ-STL5LED	65
4.	Disimballaggio	66
5.	Uso previsto	66
6.	Simboli	66
7.	Descrizione dello strumento	67
7.1	Diagramma di Sistema	67
7.2	SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA	68
7.3	SZO-B / SZO-T	68
7.4	SZ-A1	69
7.5	SZ-A6	69
7.6	ST-150	70
7.7	ST-152	70
7.8	SZ-ST1	71
7.9	SZ-ST2 / SZ-ST3	71
7.10	SZ-ST7 / SZ-ST8	72
7.11	SZ-OBL	72
7.12	SZ-STL1	73
7.13	SZ-STL2	73
7.14	SZ-STLX	74
7.15	SZ-STL5	74
7.16	SZ-STL5LED	75
8.	Assemblaggio	76
8.1	SZ-A1 / SZ-A6	76
8.2	SZ-ST1 / ST-150	76
8.3	ST-152	76
8.4	SZ-ST2 / SZ-ST3	76
8.5	SZ-ST7 / SZ-ST8 / SZ-OBL	77
8.6	SZ-STL1	77
8.7	SZ-STL2	80
8.8	SZ-STLX	82
8.9	SZ-STL5 / SZ-STL5LED	85
8.10	Installare la testa (tutti i modelli)	86
8.11	Installare gli oculari (tutti i modelli)	86
8.12	Installare l'uscita foto (SZX-T / TA)	86
9.	Uso del microscopio	88
9.1	Regolazione della distanza interpupillare	88
9.2	Messa a fuoco	88
9.3	Regolazione della tensione delle manopole di messa a fuoco	88
9.3.1	SZ-A1	88
9.3.2	SZ-A6	88
9.4	Leva di blocco messa a fuoco (SZ-A6)	89
9.5	Compensazione diottrica	89
9.6	Ingrandimento	90
9.7	Uso di lenti addizionali	90
9.8	Uso delle lenti addizionali 0.3X-0.5X	91

9.9	Piattello bianco/nero (SZ-ST1 / 2 / 3 / 7 / 8)	91
9.10	Uso dell'illuminazione (SZ-ST2 / 3 / 7 / 8)	92
9.11	Uso dell'illuminazione (SZ-OBL)	92
9.12	Uso del paraocchi in gomma (SZO-B / T)	92
9.13	Uso delle basi a sbalzo	94
9.13.1	SZ-STL1	94
9.13.2	SZ-STL2	95
9.13.3	SZ-STLX	96
9.13.4	SZ-STL5 / SZ-STL5LED	98
10.	Microfotografia	100
10.1	Uso di telecamere a passo "C"	100
10.2	Uso di fotocamere Reflex	100
11.	Manutenzione	101
12.	Guida alla risoluzione dei problemi	102
	Smaltimento	103

1. Avvertenza

Questo microscopio è uno strumento scientifico di alta precisione, progettato per durare a lungo con una minima manutenzione; la realizzazione è secondo i migliori standard ottici e meccanici, per poter essere utilizzato quotidianamente. Vi ricordiamo che questo manuale contiene informazioni importanti per la sicurezza e per la manutenzione dello strumento, e deve quindi essere messo a disposizione di coloro che lo utilizzeranno.

Decliniamo ogni responsabilità derivante da un utilizzo dello strumento non indicato nel presente manuale.

2. Informazioni sulla sicurezza



Per evitare shock elettrici

Prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica, assicurarsi che il voltaggio della rete locale coincida con il voltaggio dello strumento e che l'interruttore dell'illuminazione sia nella posizione "OFF".

Gli utenti dovranno seguire tutte le norme di sicurezza locali. Lo strumento è certificato CE. In ogni caso, gli utilizzatori sono gli unici responsabili per un utilizzo sicuro dello strumento. Per l'utilizzo in sicurezza dello strumento è importante attenersi alle seguenti istruzioni e leggere il manuale in tutte le sue parti.

3. Contenuto della confezione

3.1 SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA



① Corpo del microscopio

• SZX-B/BA Binoculare / SZX-T/TA Trinoculare

② Oculari

③ Brugole (solo per SZX-T/TA)

④ Copertina antipolvere

⑤ Anello uscita foto (solo per SZX-T/TA)


3.2 SZO-B / SZO-T



- ① Corpo del microscopio
 - SZO-B Binoculare / SZO-T Trinoculare
- ② Oculari


- ③ Brugola (solo per SZO-T)
- ④ Copertina antipolvere

3.3 SZ-A1

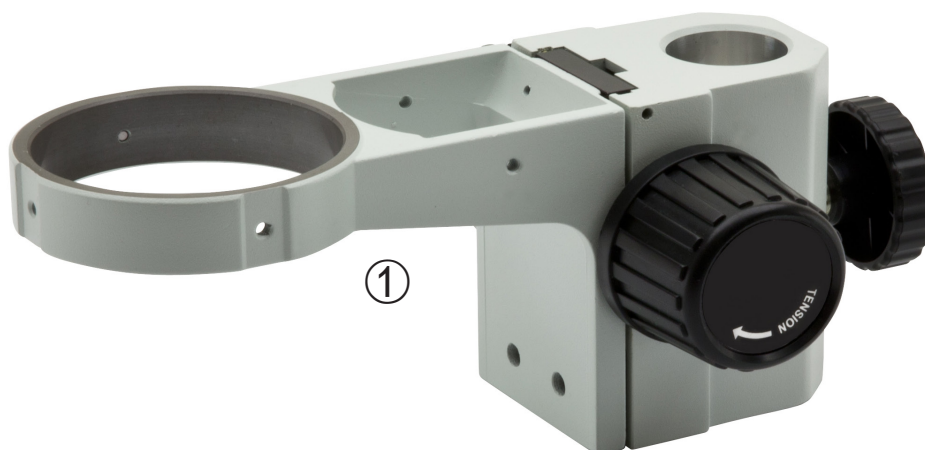


- ① Messa a fuoco macro

3.4 SZ-A6

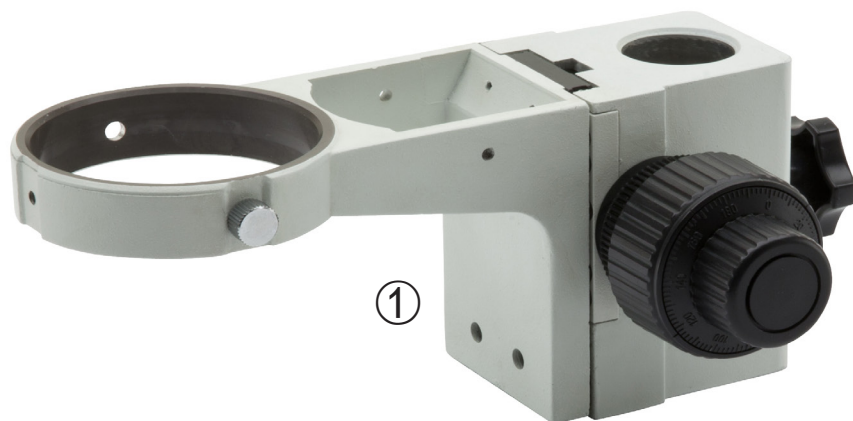

① Messa a fuoco macro-micro

3.5 ST-150

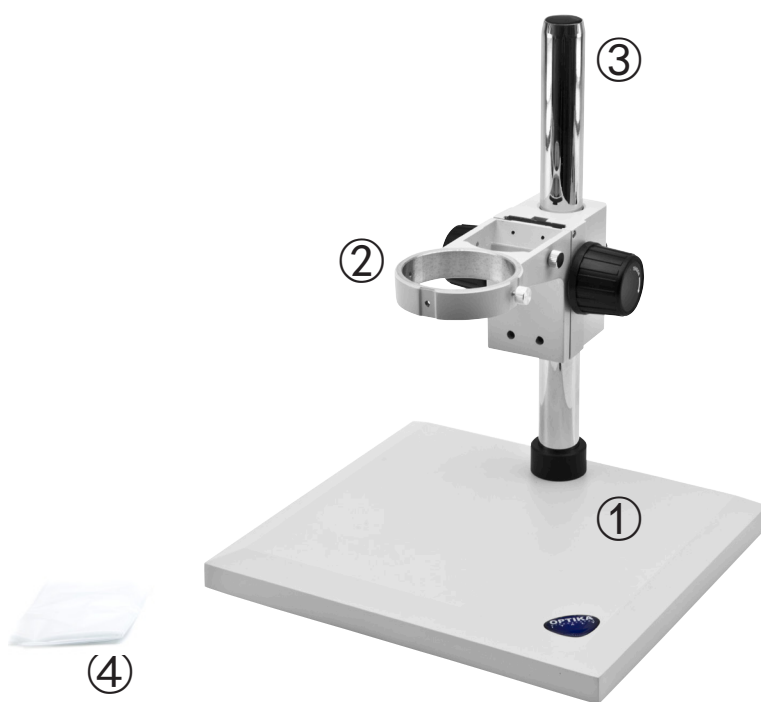


① Base

② Supporto testa / messa a fuoco

③ Colonna

④ Copertina antipolvere

3.6 ST-152

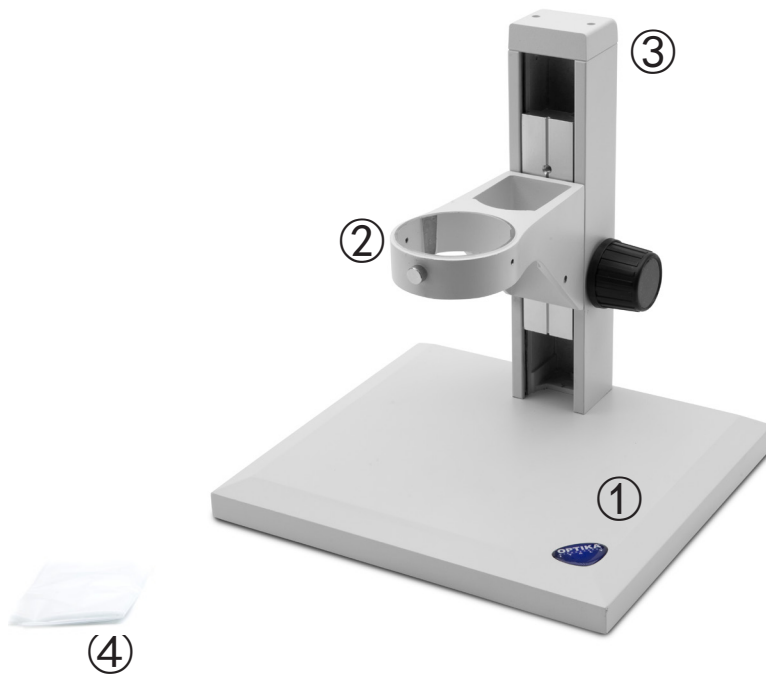

- ① Base
- ② Supporto testa / messa a fuoco
- ③ Colonna
- ④ Copertina antipolvere

3.7 SZ-ST1



- ① Base
- ② Mollettine (una coppia)
- ③ Disco bianco / nero

3.8 SZ-ST2 / SZ-ST3



- ① Base
- ② Disco opalino
- ③ Mollettine (una coppia)

- ④ Illuminatore luce incidente
- ⑤ Disco bianco / nero
- ⑥ Alimentatore

3.9 SZ-ST7 / SZ-ST8



- ① Base
- ② Disco opalino
- ③ Mollettine (una coppia)

- ④ Disco bianco / nero
- ⑤ Alimentatore


3.10 SZ-OBL



- ① Base
- ② Colonna
- ③ Piattello in vetro

- ④ Alimentatore
- ⑤ Copertina antipolvere


3.11 SZ-STL1

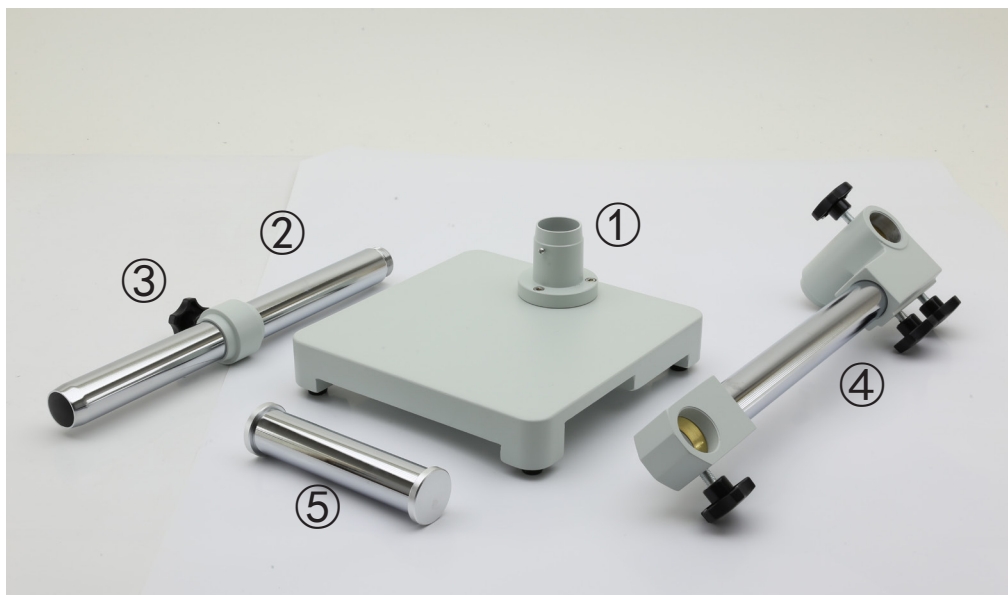

- ① Base
- ② Colona
- ③ Anello prevenzione discesa


- ④ Braccio orizzontale
- ⑤ Braccio di supporto messa a fuoco

3.12 SZ-STL2

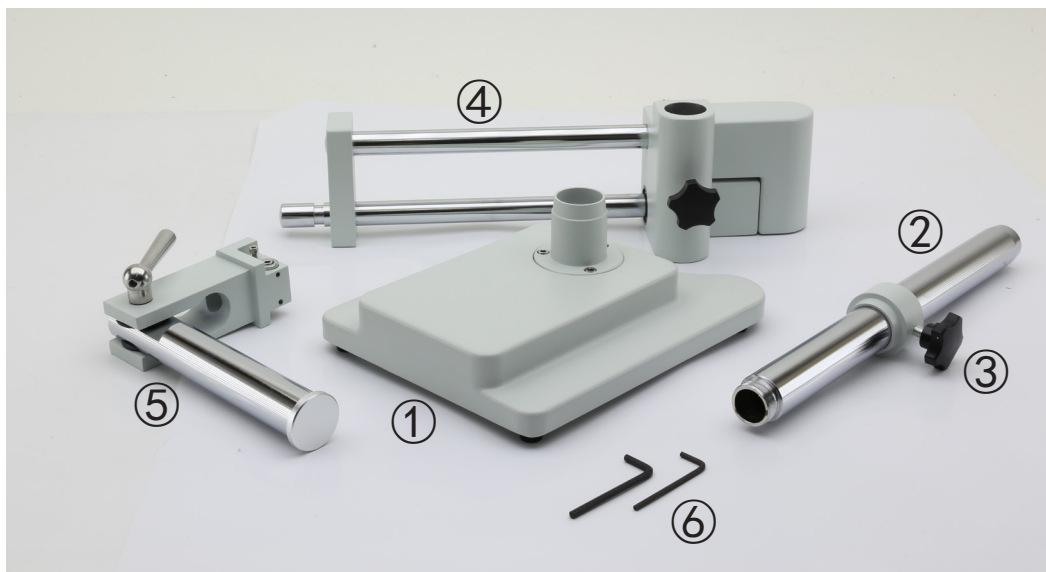


- ① Base
- ② Colonna
- ③ Anello prevenzione discesa
- ④ Braccio orizzontale
- ⑤ Braccio di supporto messa a fuoco
- ⑥ Brugole

3.13 SZ-STLX

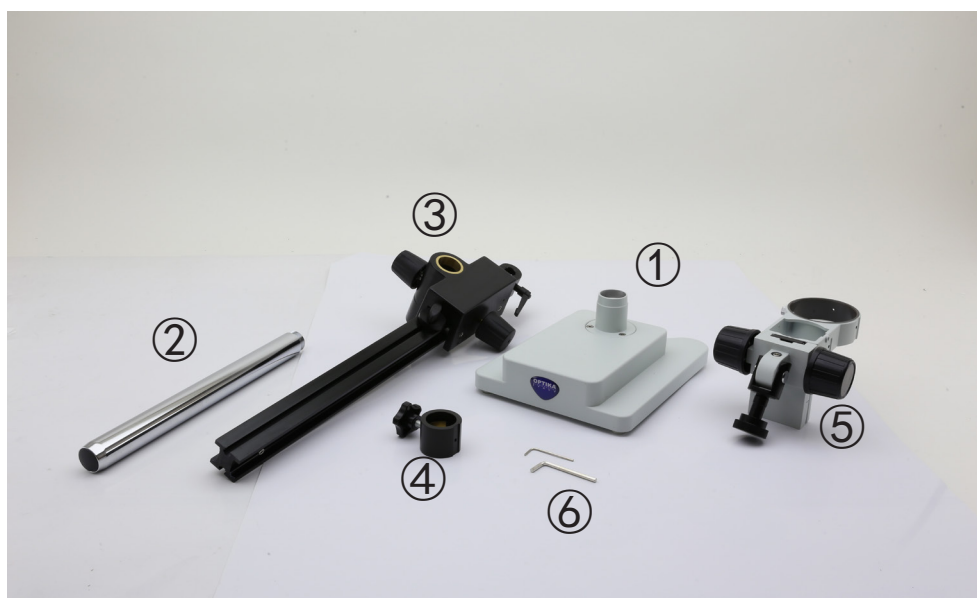

- ① Base
- ② Colonna
- ③ Braccio orizzontale
- ④ Anello prevenzione discesa
- ⑤ Messa a fuoco
- ⑥ Brugole

3.14 SZ-STL5

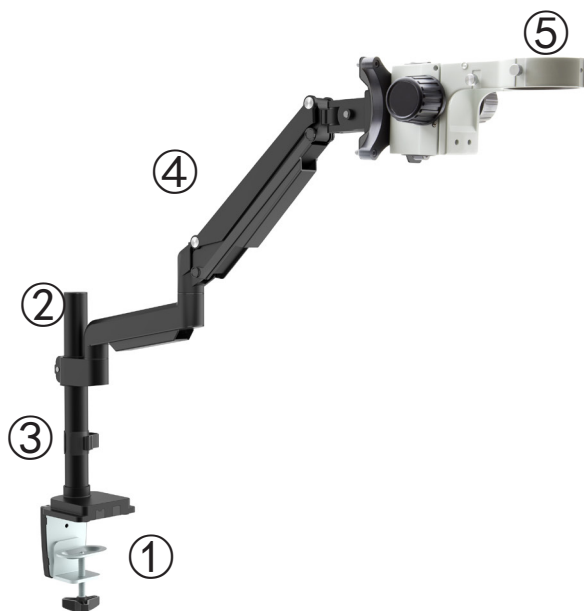

- ① Supporto da tavolo
- ② Colonna
- ③ Anello prevenzione discesa
- ④ Braccio orizzontale
- ⑤ Supporto testa / messa a fuoco
- ⑥ Fascette fermacavo
- ⑦ Guarnizione rotonda
- ⑧ Viti corte M4x12 mm (4 pz)
- ⑨ Viti lunghe M4x25 mm (4 pz)
- ⑩ Chiavi a brugola
- ⑪ Piedini in gomma (4 pz)
- ⑫ Guarnizione rettangolare
- ⑬ Supporto da tavolo per alti spessori

3.15 SZ-STL5LED



- ① Supporto da tavolo
- ② Colonna
- ③ Anello prevenzione discesa
- ④ Braccio orizzontale
- ⑤ Supporto testa / messa a fuoco
- ⑥ Bracci LED autoportanti
- ⑦ Scatola controllo luminosità con alimentatore
- ⑧ Fascette fermacavo
- ⑨ Guarnizione rotonda
- ⑩ Viti corte M4x12 mm (4 pz)
- ⑪ Viti lunghe M4x25 mm (4 pz)
- ⑫ Chiavi a brugola
- ⑬ Piedini in gomma (4 pz)
- ⑭ Guarnizione rettangolare
- ⑮ Supporto da tavolo per alti spessori

4. Disimballaggio

Il microscopio è riposto in un imballo di polistirolo espanso. Rimuovere il nastro adesivo dal collo ed aprire la parte superiore dell'imballo. Fare attenzione a non far cadere le parti ottiche (obiettivi e oculari) nell'estrarre il microscopio dalla scatola per evitare che vengano danneggiati. Utilizzare entrambe le mani (una intorno allo stativo e una alla base), sfilare il microscopio dal contenitore e appoggiarlo su un piano stabile.



Evitare di toccare le superfici ottiche come lenti, filtri o vetri. Tracce di grasso o altri residui possono ridurre la qualità visiva dell'immagine finale e corrodere la superficie delle ottiche in breve tempo.

5. Uso previsto

Modelli standard

Solo per applicazioni di ricerca ed usi didattici. Non indicato per utilizzo diagnostico e terapeutico umano e veterinario.

Modelli IVD

Anche per uso diagnostico, finalizzato ad ottenere informazioni sulla situazione fisiologica o patologica del soggetto.

6. Simboli

La seguente tabella riporta i simboli utilizzati in questo manuale.



PERICOLO

Questo simbolo indica un rischio potenziale ed avverte di procedere con cautela.



SHOCK ELETTRICO

Questo simbolo indica un rischio di shock elettrico.

7. Descrizione dello strumento

7.1 Diagramma di Sistema



7.2 SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA




7.3 SZO-B / SZO-T




7.4 SZ-A1




7.5 SZ-A6

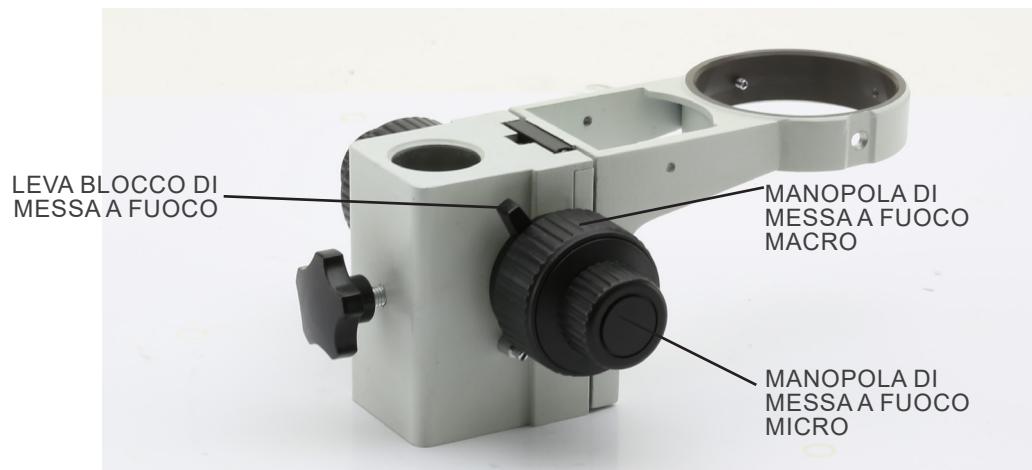


7.6 ST-150

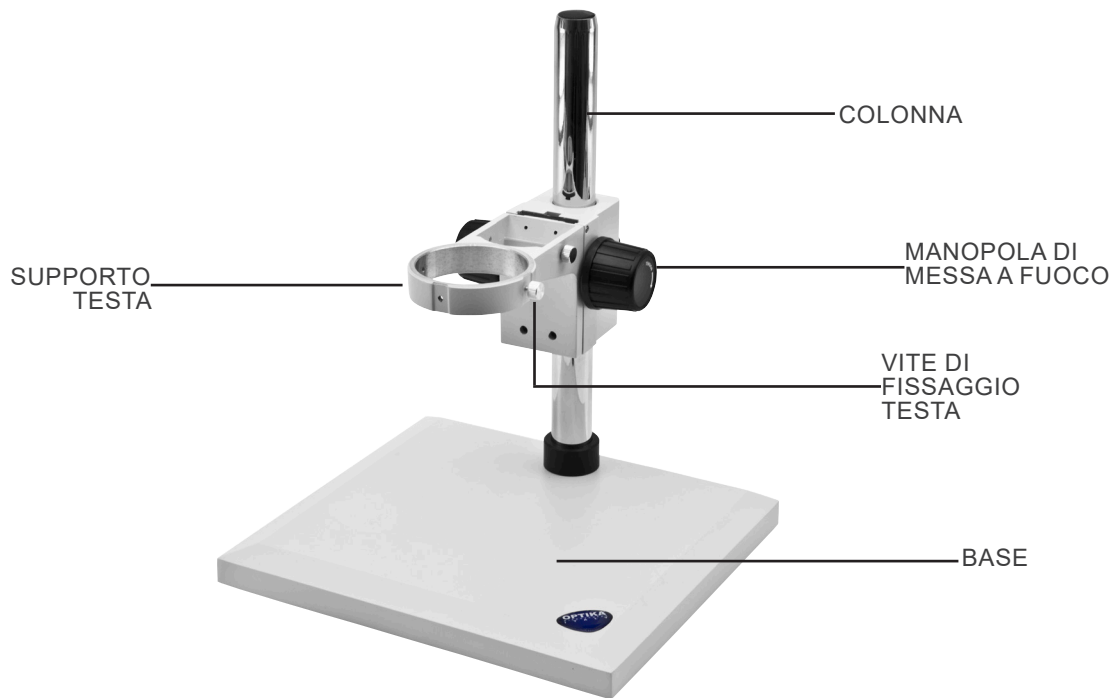


7.7 ST-152

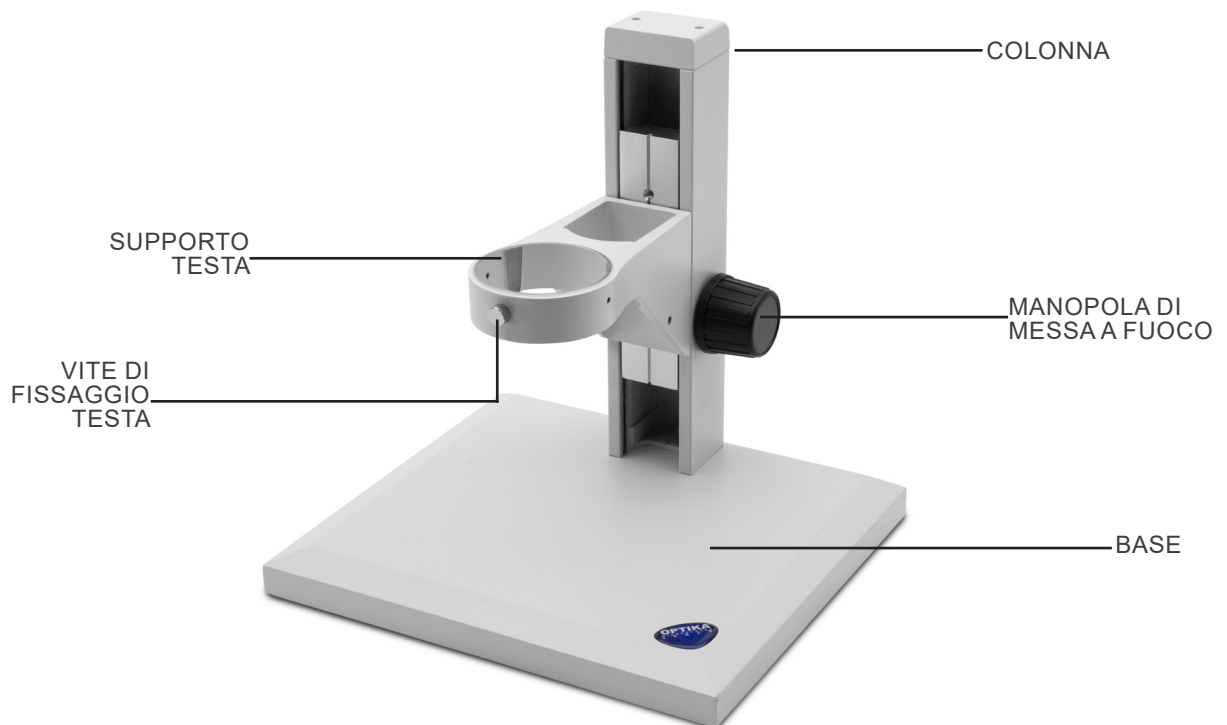


7.8 SZ-ST1

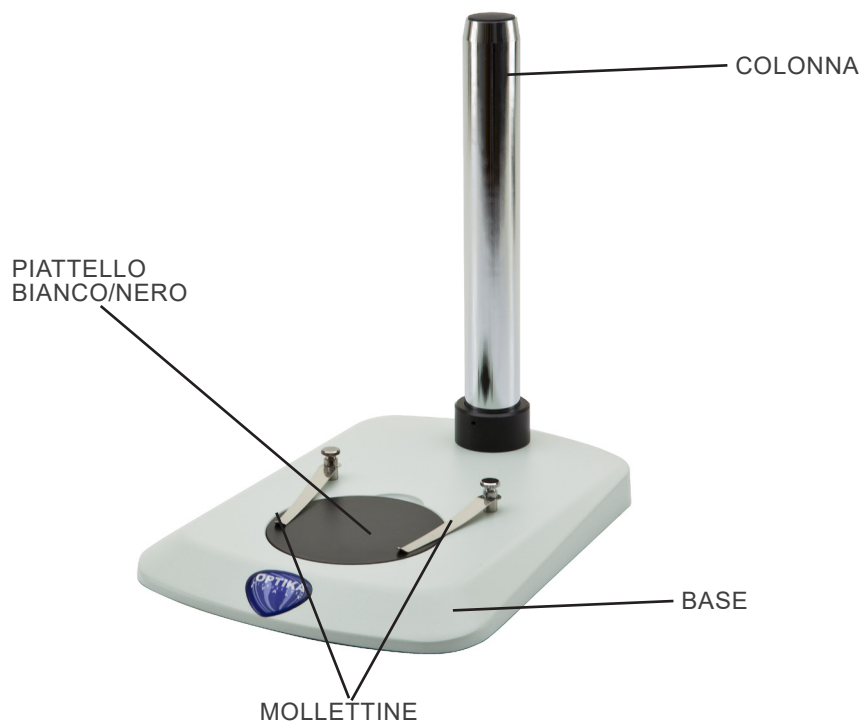


7.9 SZ-ST2 / SZ-ST3

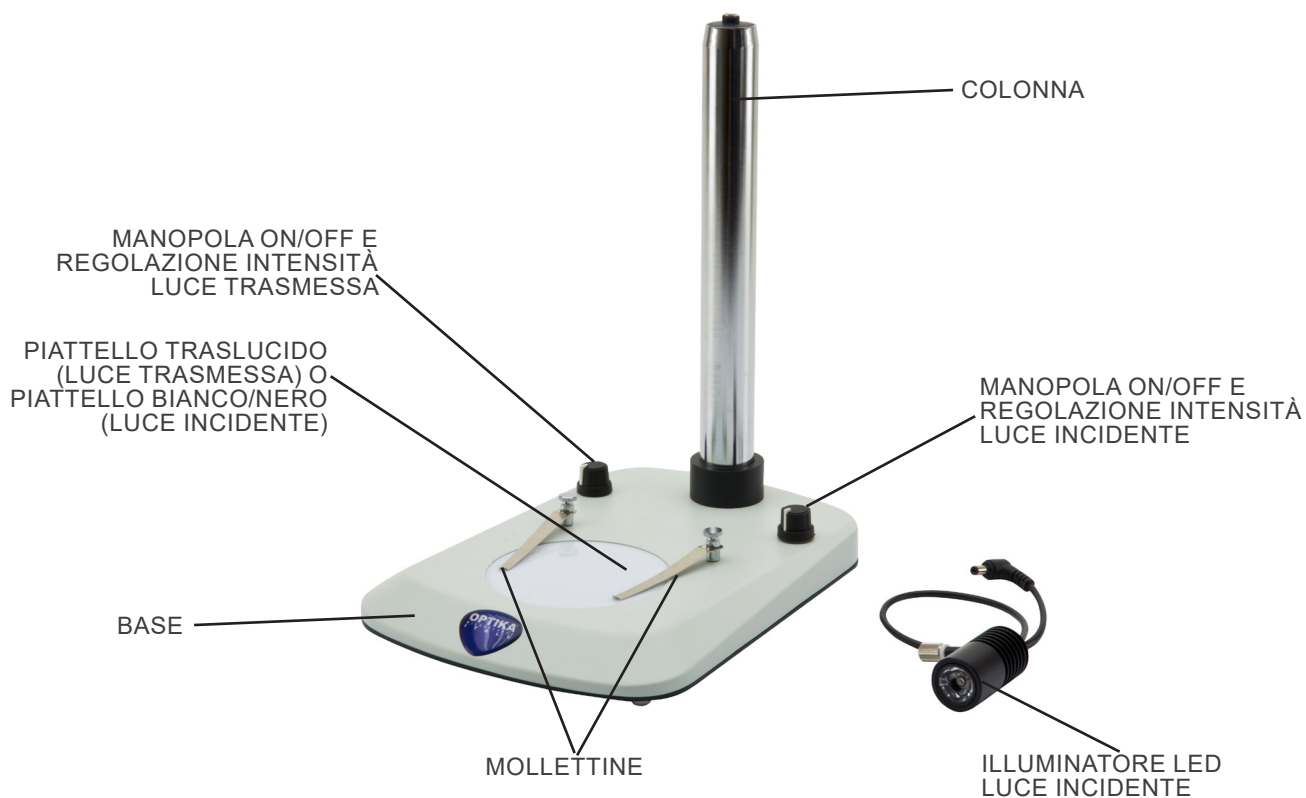


7.10 SZ-ST7 / SZ-ST8

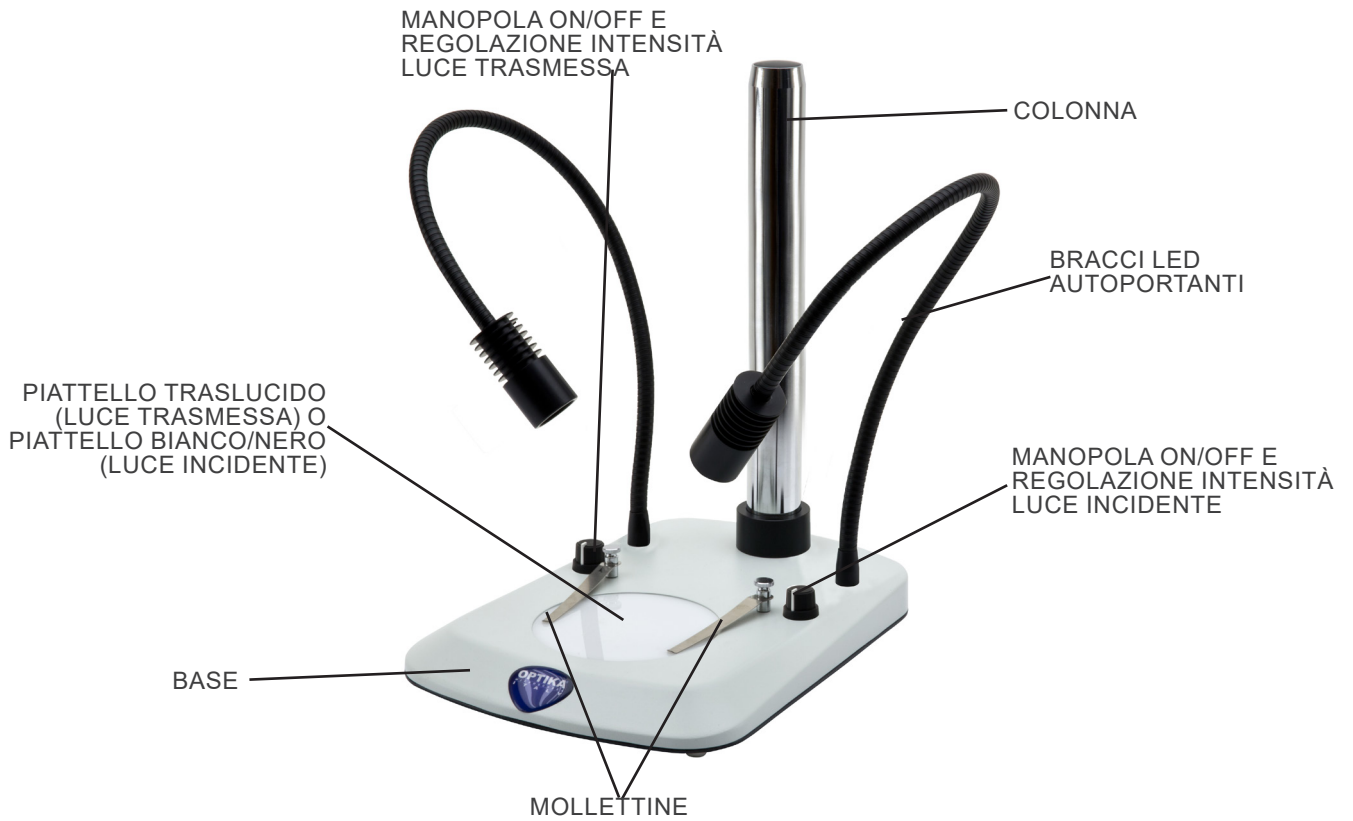


7.11 SZ-OBL

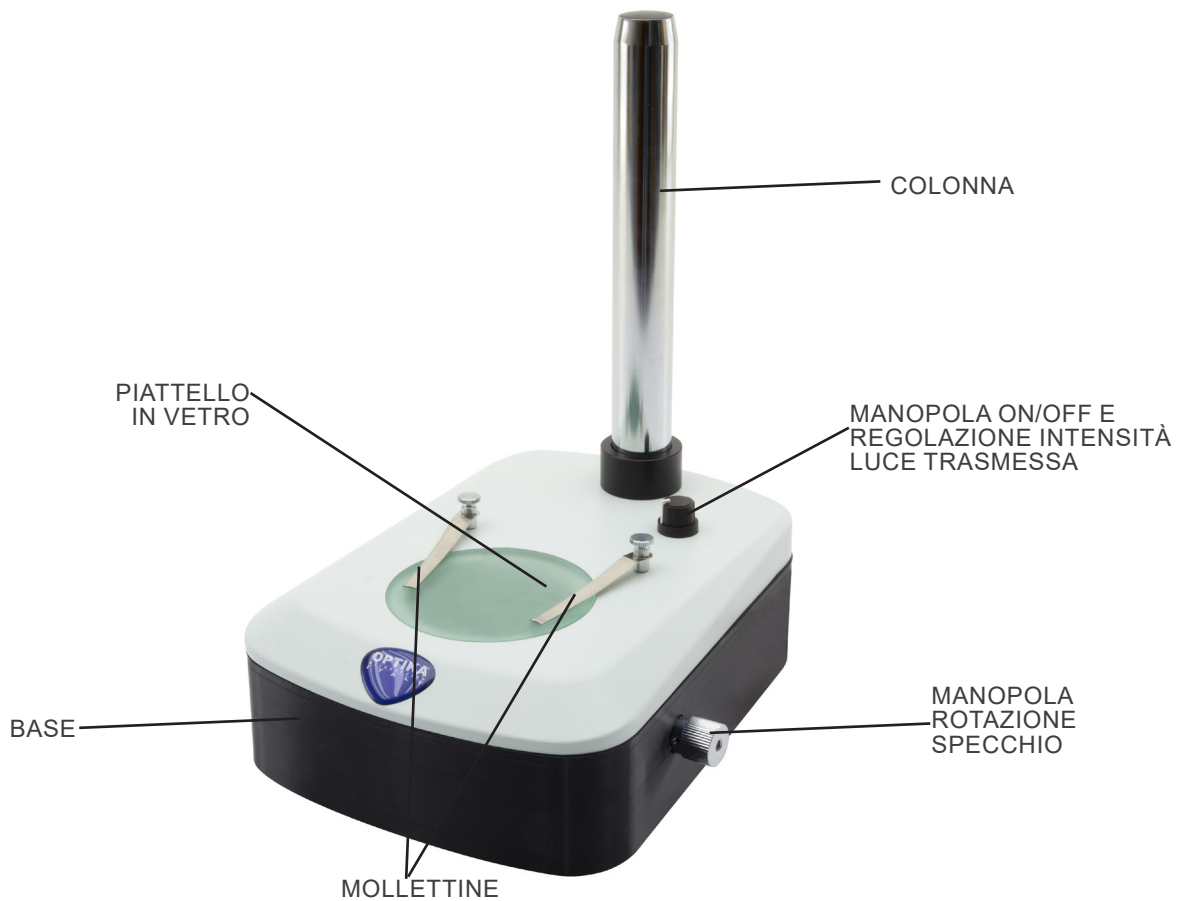


7.12 SZ-STL1

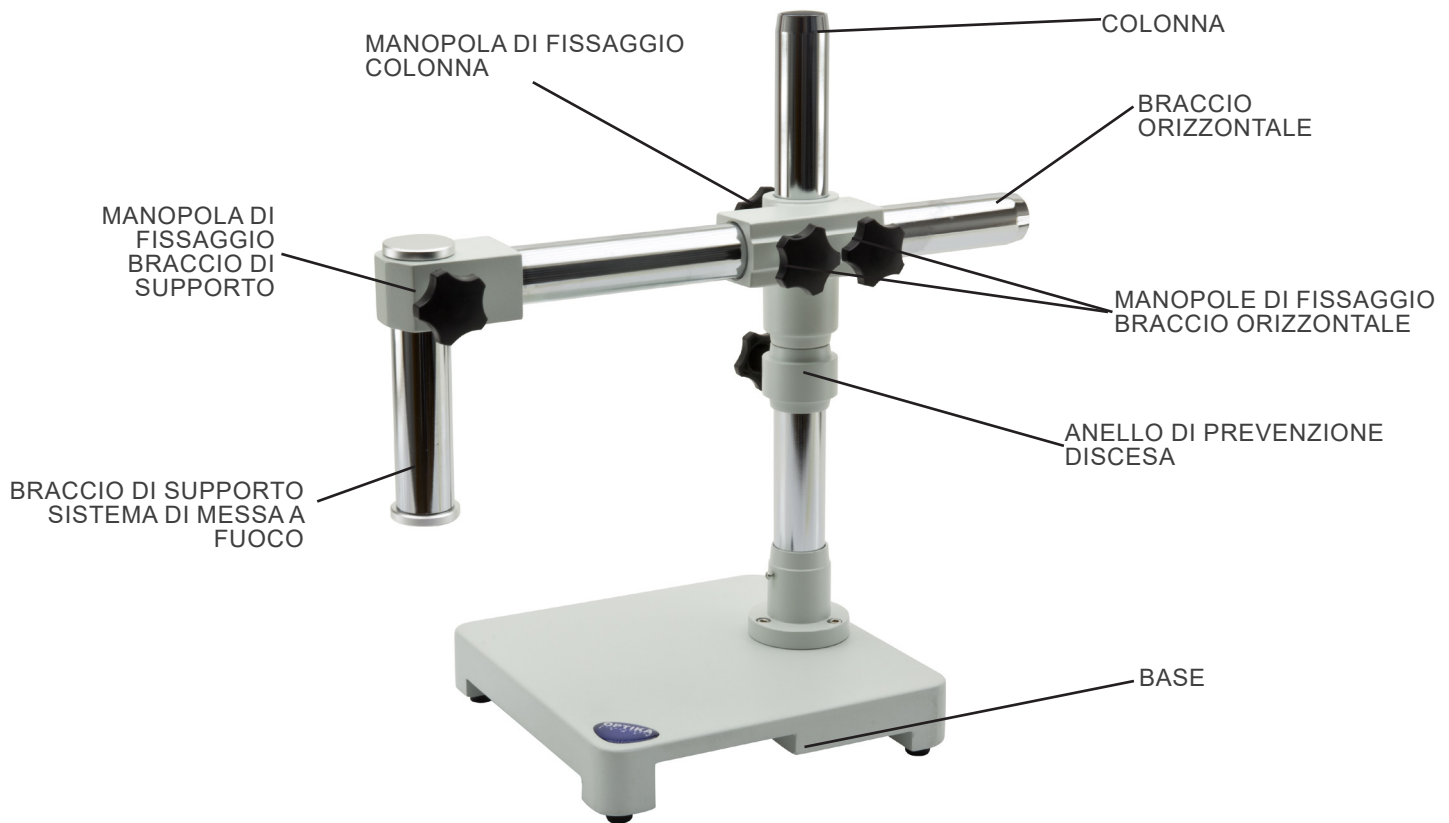


7.13 SZ-STL2

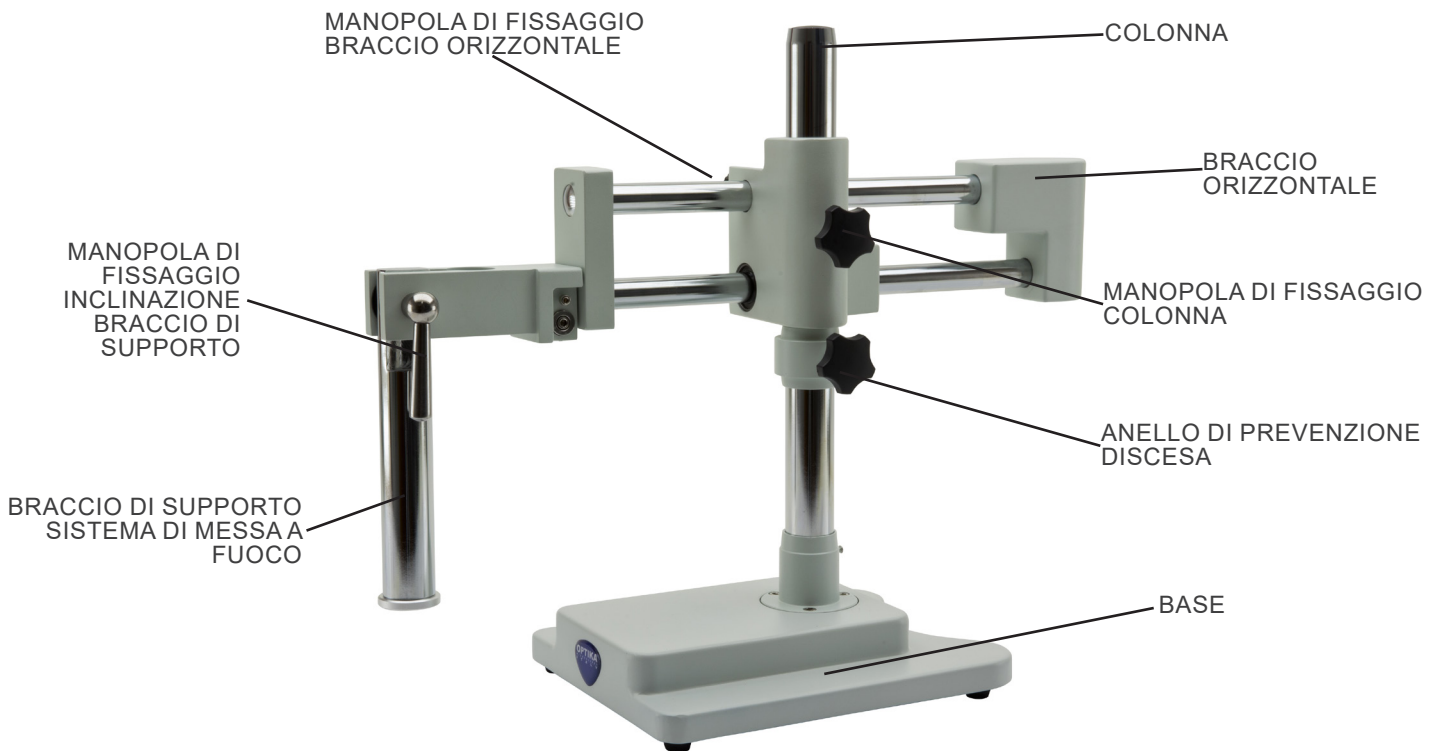


7.14 SZ-STLX

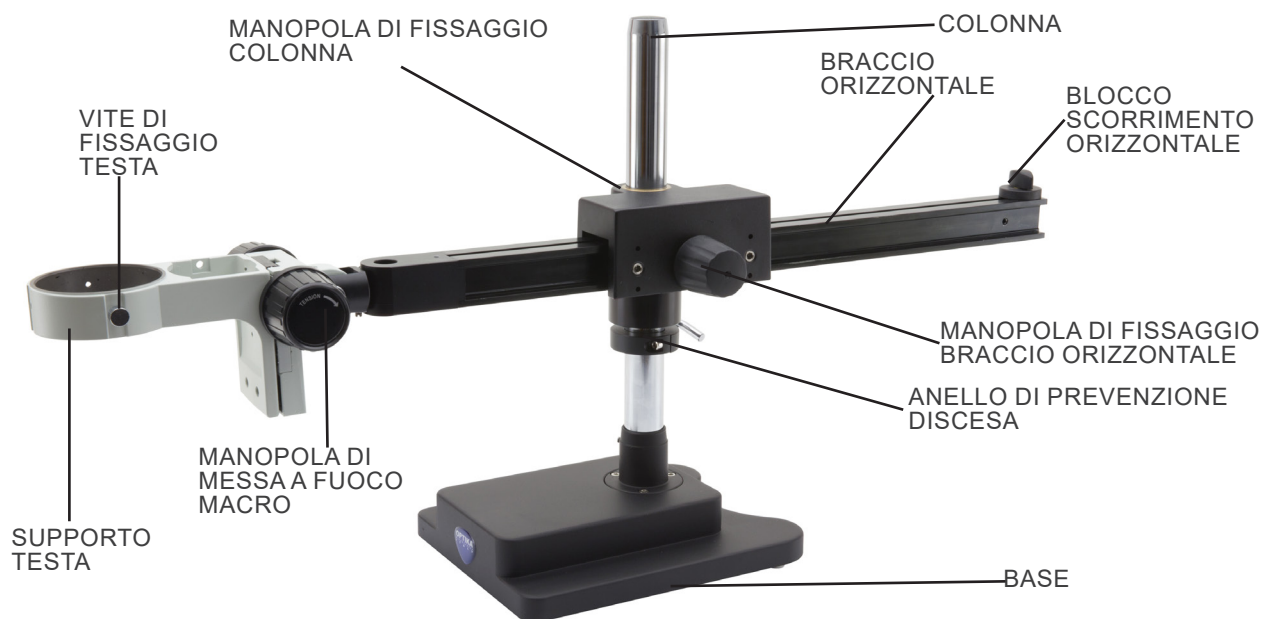

7.15 SZ-STL5

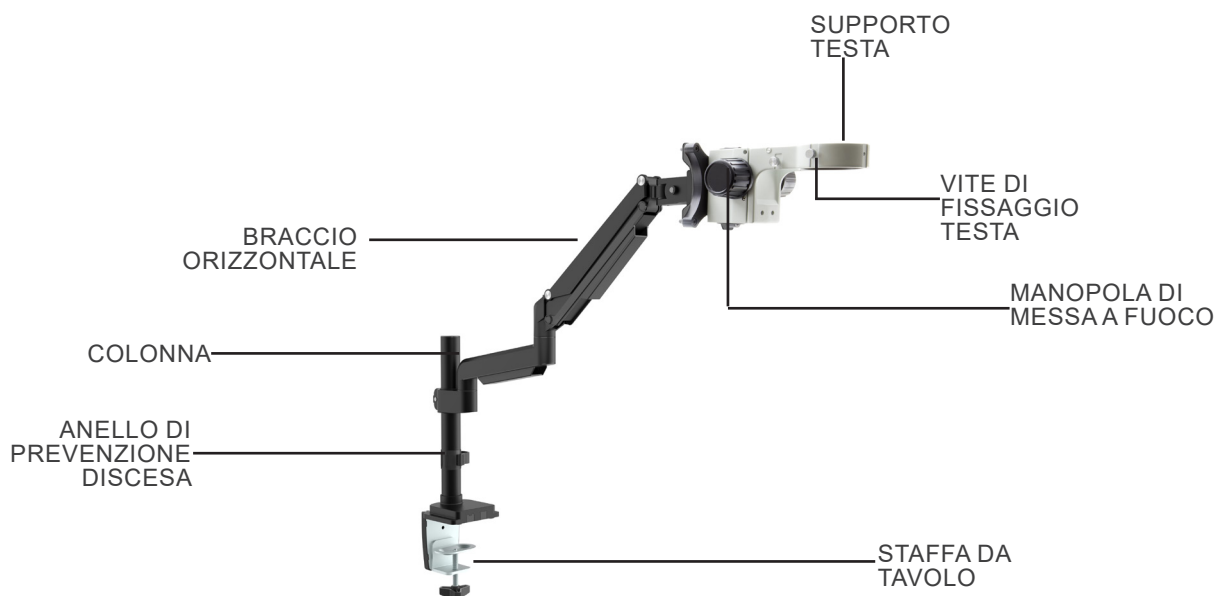


7.16 SZ-STL5LED

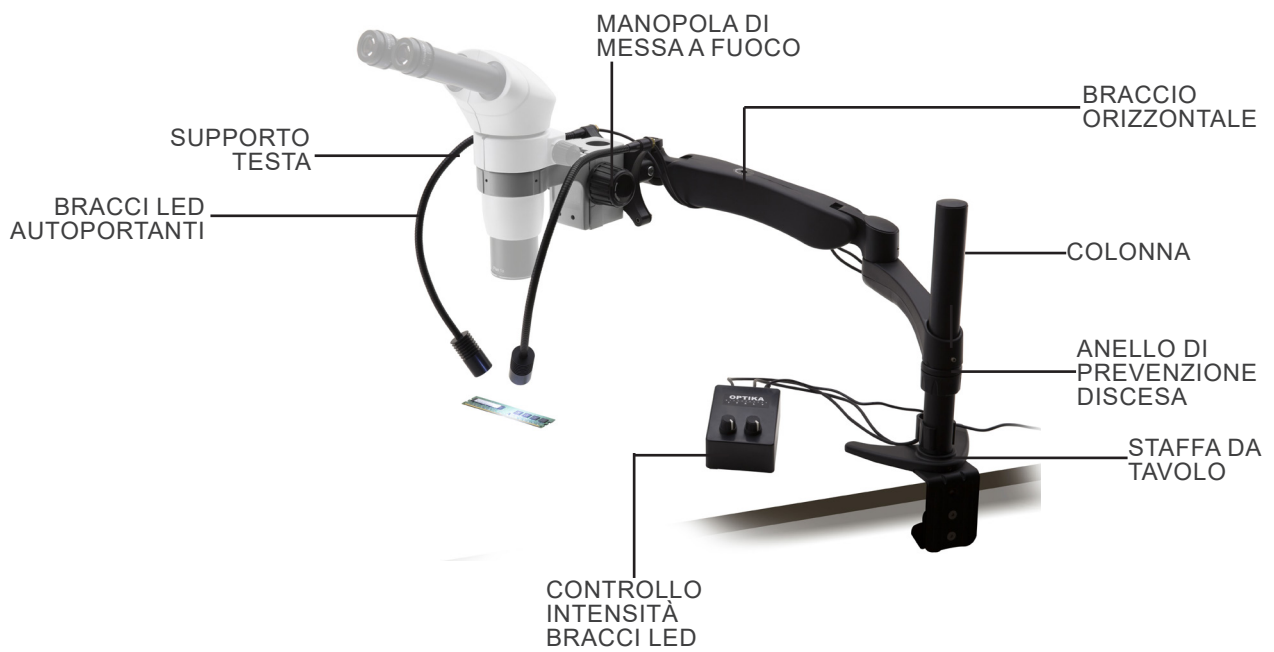

8. Assemblaggio

8.1 SZ-A1 / SZ-A6

- Il montaggio dei sistemi di messa a fuoco SZ-A1 e SZ-A6 si applica a tutte le basi tranne ST-152, SZ-STL1, SZ-STL2, SZ-STLX e SZ-STL5. Per il montaggio su queste basi si rimanda al paragrafo specifico.
1. Inserire il sistema di messa a fuoco sulla colonna e, una volta raggiunta l'altezza desiderata, serrare la manopola di bloccaggio ① posta nella parte posteriore del sistema di messa a fuoco. (Fig. 1)

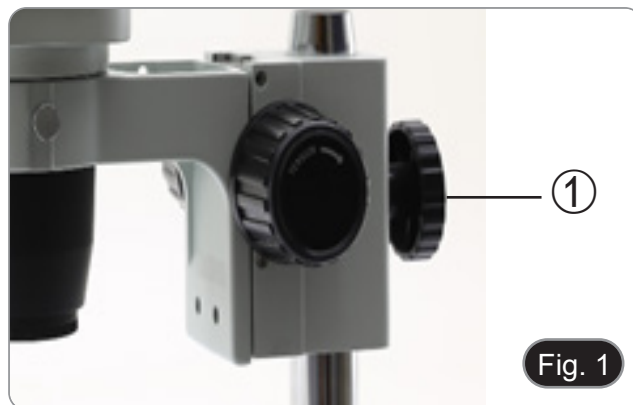

8.2 SZ-ST1 / ST-150

1. Rimuovere la base dal suo imballo e posizionarla su una superficie piana. La base arriva già montata dalla fabbrica e non necessita di ulteriore procedura di montaggio, se non quella del montaggio del sistema di messa a fuoco.

8.3 ST-152


1. Rimuovere la base dal suo imballo e posizionarla su una superficie piana. La base arriva già montata dalla fabbrica e non necessita di ulteriore procedura di montaggio.

8.4 SZ-ST2 / SZ-ST3

1. Installare il faretto LED per luce incidente come mostrato in Fig. 2.
- Allentando la vite di fissaggio ② è possibile modificare l'angolo di inclinazione del faretto per ottimizzare l'illuminazione sul campione.



2. Inserire lo spinotto del cavo nel connettore posto sulla sommità della colonna ③. (Fig. 3)

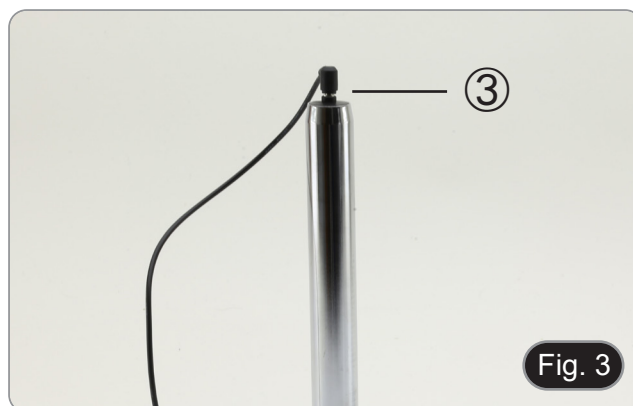

3. Collegare lo spinotto dell'alimentatore al connettore posto nella parte posteriore della base del microscopio. (Fig. 4)



8.5 SZ-ST7 / SZ-ST8 / SZ-OBL

1. Rimuovere la base dal suo imballo e posizionarla su una superficie piana. La base arriva già montata dalla fabbrica e non necessita di ulteriore procedura di montaggio, se non quella del montaggio del sistema di messa a fuoco.
2. Collegare lo spinotto dell'alimentatore al connettore posto nella parte posteriore della base del microscopio. (Fig. 4)

8.6 SZ-STL1

1. Avvitare la colonna alla base. (Fig. 5)



2. Avvitare le viti per bloccare la colonna. (Fig. 6)



3. Inserire l'anello di prevenzione discesa e fissarlo all'altezza desiderata avvitando la manopola di fissaggio. (Fig. 7)



4. Inserire il braccio orizzontale e bloccarlo con la vite di fissaggio ①. (Fig. 8 - 9)



5. Installare il supporto per la testa. Svitare la manopola di blocco ③ ed inserire dall'alto il braccio per il supporto della messa a fuoco ② dall'alto nel foro del braccio orizzontale. (Fig. 10)



6. Una volta inserito a fondo bloccare la vite di fissaggio ④.
(Fig. 11)



7. Inserire dal basso il sistema di messa a fuoco, serrare la vite di fissaggio ⑤ ed avvitare nuovamente la manopola di blocco ③ dal basso. (Fig. 12-13)



8.7 SZ-STL2

1. Avvitare la colonna alla base. (Fig. 14)



2. Avvitare le viti per bloccare la colonna. (Fig. 15)




3. Inserire l'anello di prevenzione discesa e fissarlo all'altezza desiderata avvitando la manopola di fissaggio. (Fig. 16)





4. Inserire il braccio orizzontale e bloccarlo con la vite di fissaggio ① (Fig. 17)



5. Per una maggiore sicurezza, serrare la vite di fissaggio ② con la brugola in dotazione. (Fig. 18)

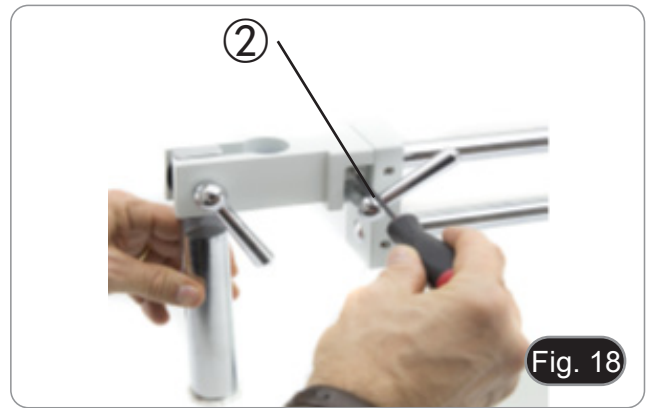

6. Installare il sistema di messa a fuoco. Svitare la manopola di blocco ③ ed inserire il supporto ④ dal basso nella colonna. Al termine riavvitare la manopola di blocco ③. (Fig. 19-20)

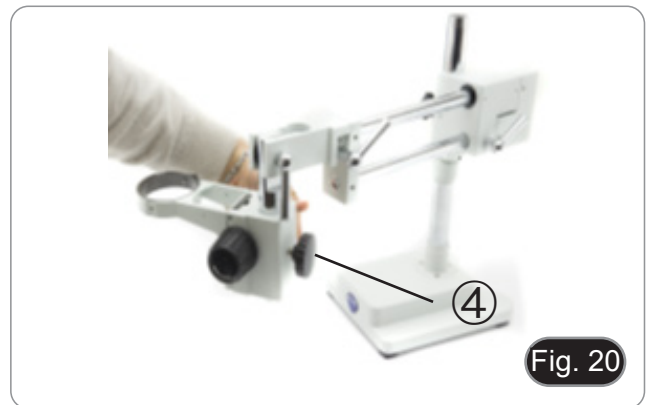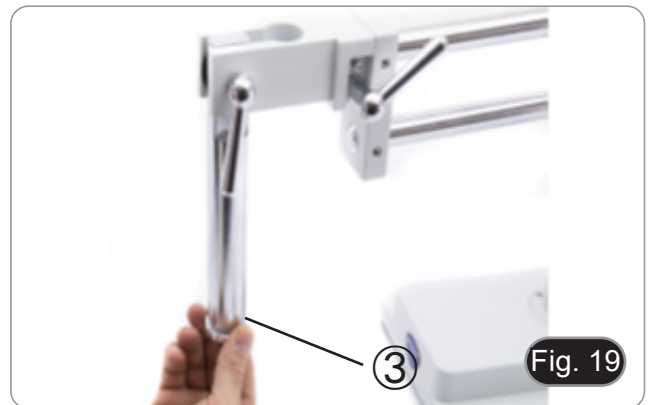

8.8 SZ-STLX

1. Avvitare la colonna alla base. (Fig. 21)



2. Avvitare le viti per bloccare la colonna. (Fig. 22)



3. Inserire l'anello di prevenzione discesa e fissarlo all'altezza desiderata avvitando la manopola di fissaggio. (Fig. 23)



4. Inserire il braccio orizzontale e bloccarlo con la vite di fissaggio ①. (Fig. 24)





5. Il supporto testa può essere installato in diversi modi a seconda delle specifiche esigenze dell'utente.

Modo di installazione n° 1: (Fig. 25-27)


Inserire la parte posteriore del supporto testa (parte rotonda nera) ③ (Fig. 25) dall'alto nel foro del braccio orizzontale ④ e avvitare la manopola di prevenzione ② dal basso.

- **Questa modalità consente l'installazione di teste pesanti (o con telecamere pesanti installate sopra la testa).**

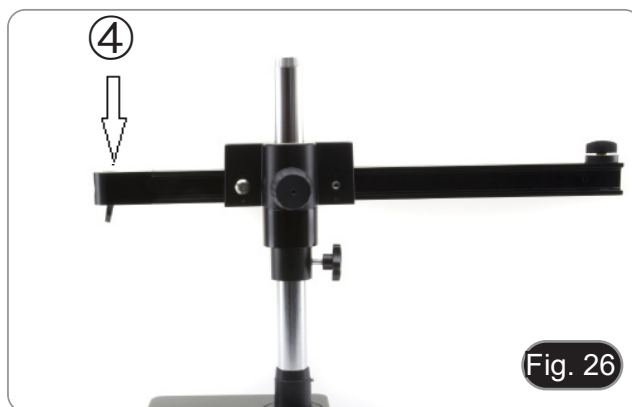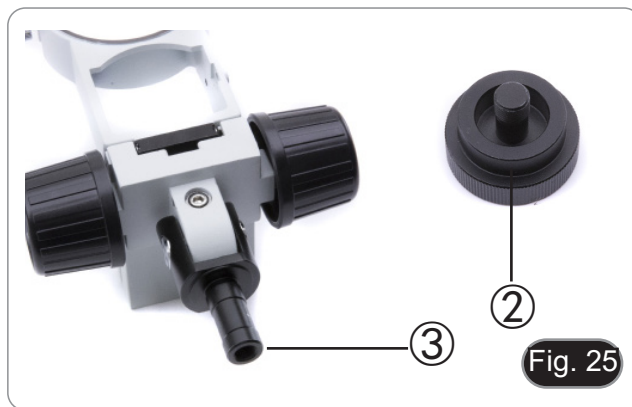

Modo di installazione n° 2: (Fig. 28-29)

Inserire la parte posteriore del supporto testa (parte rotonda nera) ③ (Fig. 28) dal basso nel foro del braccio orizzontale e avvitare la manopola di prevenzione ② dall'alto.

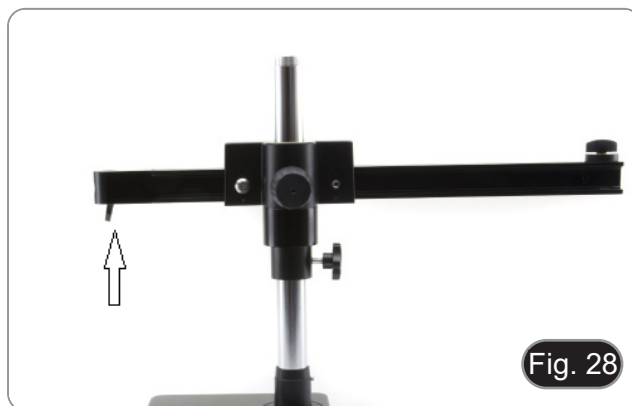

- Queste due modalità consentono l'inclinazione della testa. (Fig. 29)



Modo di installazione n° 3: (Fig. 30)

Inserire la parte posteriore del supporto testa (parte rotonda nera) ③ nel foro all'estremità del braccio orizzontale e serrare la manopola ⑤.




- Questa modalità permette di angolare la testa. (Fig. 31)



8.9 SZ-STL5 / SZ-STL5LED


1. Regolare l'altezza della pinza da tavolo ① in base alla superficie del tavolo. (Fig. 32)

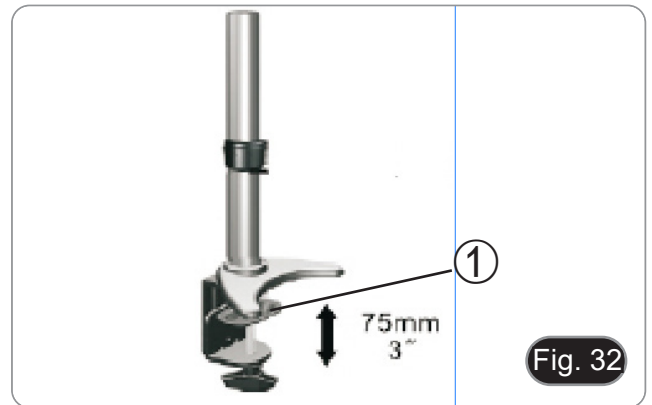


2. Fissare la pinza da tavolo ① sul bordo del tavolo nella posizione desiderata e con l'apertura del morsetto rivolta verso il bordo del tavolo (Fig. 33). Serrare a mano la manopola ② per assicurarsi che la pinza da tavolo si agganci completamente alla superficie del tavolo e sia sicura (Fig. 34).



3. Per posizionare l'anello di prevenzione discesa all'altezza desiderata, è necessario allentare l'anello di prevenzione discesa come mostrato in figura. Serrare a mano fino a quando questo non è saldamente in posizione. (Fig. 35)

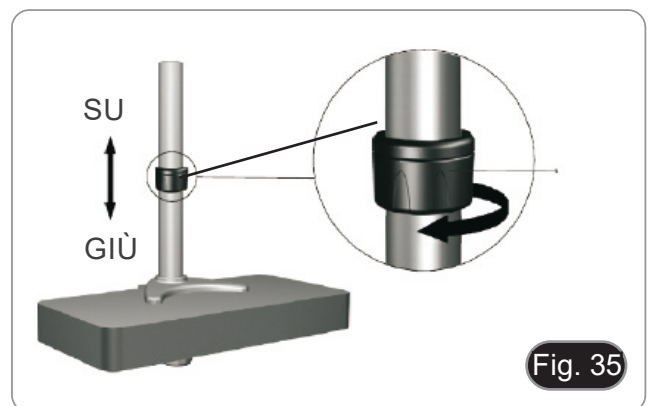

4. Montare il gruppo di messa a fuoco sul braccio, utilizzando le viti e la chiave a brugola in dotazione. (Fig. 36)

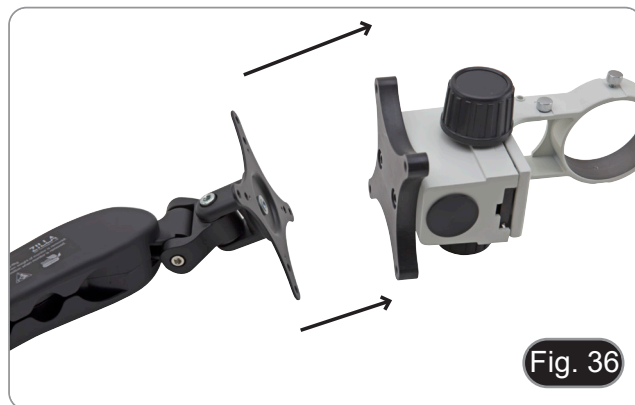

8.10 Installare la testa (tutti i modelli)

Inserire la testa e fissare la vite di bloccaggio. (Fig. 37)




8.11 Installare gli oculari (tutti i modelli)

1. Rimuovere i tappi antipolvere dai portaoculari ed inserire gli oculari. (Fig. 38)
2. Bloccare gli oculari serrando la vitina di bloccaggio ①.




8.12 Installare l'uscita foto (SZX-T / TA)

1. Allentare le viti di fissaggio ① dell'uscita foto in dotazione e rimuovere l'uscita foto esistente. (Fig. 39)

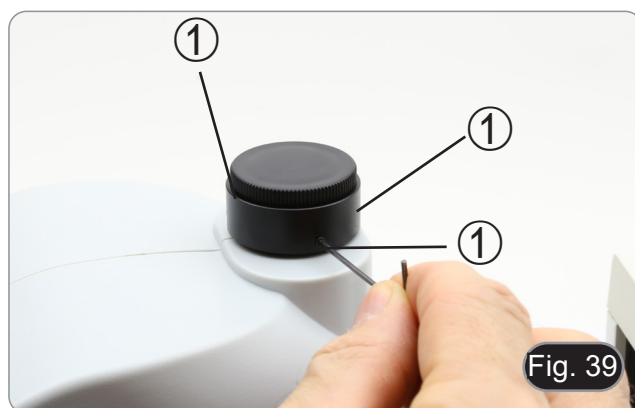

2. Inserire l'anello dell'uscita foto ② facendo attenzione a lasciare la vite di fissaggio dell'adattatore fotografico ③ rivolta verso destra. (Fig. 40)
3. Stringere le viti di fissaggio ①. (Fig. 39)

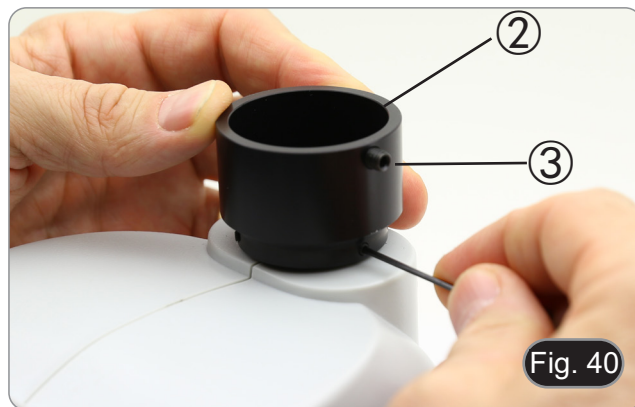

9. Uso del microscopio


9.1 Regolazione della distanza interpupillare

1. Afferrare con entrambe le mani i portaoculari destro e sinistro e regolare la distanza interpupillare spostando i tubi fino a che si osserva una sola immagine (Fig. 41).
- Se si osservano due immagini la distanza è troppo elevata.
 - Se si osservano due cerchi sovrapposti, la distanza è troppo bassa.



9.2 Messa a fuoco

1. Mettere il campione da osservare sul piattello e mettere a fuoco usando le manopole di messa a fuoco sullo stativo ①.
- Se necessario, regolare l'altezza del corpo del microscopio lungo la colonna verticale.
 - Bloccare la vite di blocco ② dopo avere effettuato la regolazione in altezza. (Fig. 42)

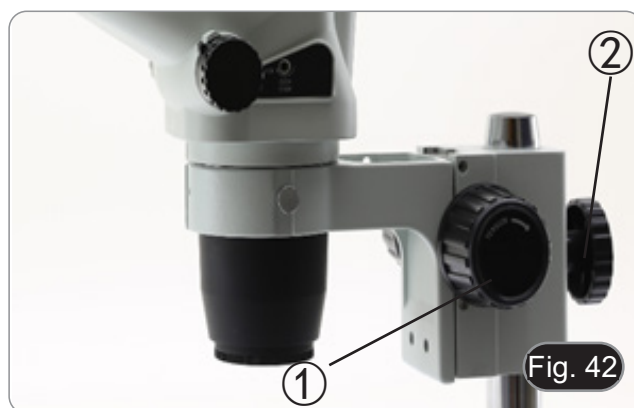


9.3 Regolazione della tensione delle manopole di messa a fuoco

- Questa regolazione consente di aumentare o diminuire la tensione delle manopole di messa a fuoco, evitando una discesa indesiderata del microscopio sotto il suo stesso peso. Regolare la tensione appena al di sopra del punto di stabilità del fuoco.

9.3.1 SZ-A1

1. Afferrare le manopole ③ con entrambe le mani e, tenendo ferma la manopola di destra ruotare la manopola di sinistra.
- La tensione aumenta o diminuisce in funzione del senso di rotazione della manopola di sinistra. (Fig. 43)

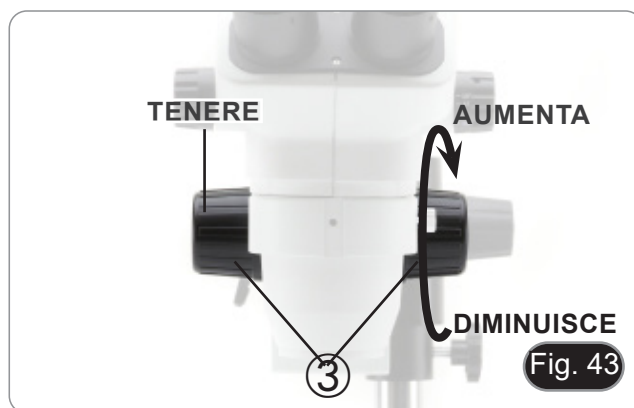


9.3.2 SZ-A6

1. Ruotare in senso orario l'anello di regolazione ④ fino ad ottenere la tensione desiderata.
- La rotazione in senso antiorario provoca una diminuzione della tensione, con conseguente perdita del fuoco. (Fig. 44)



9.4 Leva di blocco messa a fuoco (SZ-A6)

- La leva di blocco svolge la funzione di memoria di messa a fuoco.
1. Dopo avere messo a fuoco il campione, tirare verso la parte anteriore del microscopio la leva ① e bloccarla (Fig. 45).
 - In questo modo si definisce il punto superiore di messa a fuoco.
 2. Ora si può spostare il fuoco del microscopio con la manopola macrometrica, sostituire il campione e quindi riportare il sistema fino al punto superiore: il campione sarà approssimativamente a fuoco e si dovrà effettuare solamente una regolazione fine per ottenere la messa a fuoco ottimale.
 - Il movimento micrometrico non viene influenzato dal blocco di messa a fuoco.
- **Per rimuovere il blocco, spostare la leva in senso opposto a quello utilizzato per il blocco.**

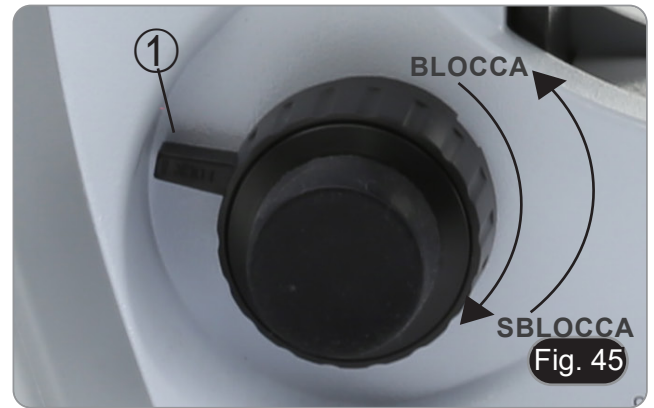

9.5 Compensazione diottrica

- **Questa compensazione consente ai portatori di occhiali di adattare il microscopio alla propria vista ed usare il microscopio senza occhiali.**
1. Portare lo zoom al minimo ingrandimento ② e mettere a fuoco con la manopola di messa a fuoco ③. (Fig. 46)
 2. Portare lo zoom a massimo ingrandimento e rimettere a fuoco.
 3. Tornare al minimo ingrandimento: il campione non sarà a fuoco.
 4. Regolare l'anello di regolazione diottrica dell'oculare destro ④ (Fig. 47) fino a che l'immagine è a fuoco. Ripetere la procedura per l'oculare sinistro.
 5. Ora verificare la messa a fuoco del campione lungo l'intero range di zoom. Il sistema ora è perfettamente parfocale (il fuoco è mantenuto durante il cambio di ingrandimento).



9.6 Ingrandimento

1. Selezionare l'ingrandimento desiderato mediante il selettore zoom ②. (Fig. 48)
- Se necessario usare oculari diversi e/o un'adeguata lente addizionale per ottenere l'ingrandimento voluto.
 - **Solo per serie SZO:** Il corpo del microscopio della è dotato di una funzione "clic stop" che consente di ottenere un ingrandimento preciso (Fig. 43). Il clic stop può essere attivato o disattivato inserendo la brugola in dotazione nel foro posto sulla parte destra del microscopio.



9.7 Uso di lenti addizionali

1. Avvitare la lente addizionale al corpo del microscopio. (Fig. 49)
- Ogni lente ha una specifica Distanza di Lavoro.
 - La corsa del supporto di messa a fuoco non può compensare le diverse distanza di lavoro delle varie lenti addizionali.
 - Nel caso in cui il supporto di messa a fuoco non riuscisse a mettere a fuoco il campione, si deve alzare o abbassare tutto il corpo del microscopio.

L'ingrandimento totale si calcola in questo modo:
 Ingrandimento oculare * Ingrandimento Zoom * Ingrandimento lente addizionale.



Serie SZX (0.67x - 4.5x / F.N. 22 mm)

Oculare	10x		15x		20x		25x	
Indice di campo (mm)	22		16		12		9	
Obiettivo	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)
0.3X	2.01X-13.5X	109.45-16.30	3.02X-20.25X	79.60-11.85	4.02X-27X	59.70-8.89	5.03X-33.75X	44.78-6.67
0.5X	3.35X-22.5X	65.67-9.78	5.03X-33.75X	47.76-7.11	6.7X-45X	35.82-5.33	8.38X-56.25X	26.87-4.00
0.75X	5.03X-33.75X	43.78-6.52	7.54X-50.63X	31.84-4.74	10.05X-67.5X	23.88-3.56	12.56X-84.37X	17.91-2.67
1X	6.7X-45X	32.84-4.89	10.05X-67.5X	23.88-3.56	13.4X-90X	17.91-2.67	16.75X-112.5X	13.43-2.00
1.5X	10.05X-67.5X	21.89-3.26	15.08X-101.25X	15.92-2.37	20.1X-135X	11.94-1.78	25.13X-168.75X	8.96-1.33
2X	13.4X-90X	16.42-2.44	20.1X-135X	11.94-1.78	26.8X-180X	8.96-1.33	33.5X-225X	6.72-1.00

Serie SZX-A (0.65x - 5.5x / F.N. 23 mm)

Oculare	10x		15x		20x		25x	
Indice di campo (mm)	23		16		12		9	
Obiettivo	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)
0.3X	1.95X-16.5X	117.95-13.94	2.93X-24.75X	82.05-9.70	3.9X-33X	61.54-7.27	4.88x-41.25x	46.15-5.45
0.5X	3.25X-27.5X	70.77-8.36	4.88X-41.25X	49.23-5.82	6.5X-55X	36.92-4.36	8.13x-68.75X	27.69-3.27
0.75X	4.88X-41.25X	47.18-5.58	7.31X- 61.88X	32.82-3.88	9.75X-82.5X	24.62-2.91	12.19x-103.13X	18.46-2.18
1X	6.5X-55X	35.38-4.18	9.75X-82.5X	24.62-2.91	13X-110X	18.46-2.18	16.25X-137.5X	13.85-1.64
1.5X	9.75X-82.5X	23.59-2.79	14.63X-123.75X	16.41-1.94	19.5X-165X	12.31-1.45	24.38X-206.25X	9.23-1.09
2X	13X-110X	17.69-2.09	19.5X-165X	12.31-1.45	26X-220X	9.23-1.09	32.5X-275X	6.92-0.82

Serie SZO (0.67x - 4.5x / F.N. 23 mm)


Oculare	10x		15x		20x		25x	
Indice di campo (mm)	23		16		12		9	
Obiettivo	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)
0.3X	2.01X-13.5X	114.43-17.04	3.02X-20.25X	79.60-11.85	4.02X-27X	59.70 -8.89	5.03X-33.75X	44.78-6.67
0.5X	3.35X-22.5X	68.66-10.22	5.03X-33.75X	47.76-7.11	6.7X-45X	35.82-5.33	8.38X-56.25X	26.87-4.00
0.75X	5.03X-33.75X	45.77-6.81	7.54X- 50.63X	31.84-4.74	10.05X-67.5X	23.88-3.56	12.56X-84.38X	17.91-2.67
1X	6.7X-45X	34.33-5.11	10.05X-67.5X	23.88-3.56	13.4X-90X	17.91-2.67	16.75X-112.5X	13.43-2.00
1.5X	10.05X-67.5X	22.89-3.41	15.08X-101.25X	15.92-2.37	20.1X-135X	11.94-1.78	25.13X-168.75X	8.96-1.33
2X	13.4X-90X	17.16-2.56	20.1X-135X	11.94-1.78	26.8X-180X	8.96-1.33	33.5X-225X	6.72-1.00

9.8 Uso delle lenti addizionali 0.3X-0.5X

Le lenti addizionali 0.3X e 0.5X hanno una elevata distanza di lavoro e quindi la corsa totale della colonna di messa a fuoco non può compensare.

Per far funzionare correttamente gli obiettivi addizionali 0.3X e 0.5X, procedere come segue:

1. Avvitare la lente addizionale come descritto al paragrafo 9.7.
2. Rimuovere il corpo del microscopio dal supporto.
3. Installare il distanziatore ① nel supporto testa ed avvitare la vite di fissaggio ②. (Fig. 50)
4. Rimontare il corpo del microscopio sul distanziatore ed avvitare la vite di fissaggio ③. (Fig. 51)
5. Iniziare a lavorare normalmente.

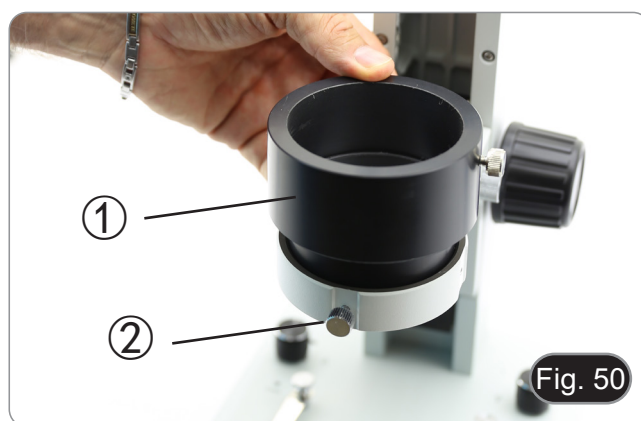


9.9 Piattello bianco/nero (SZ-ST1 / 2 / 3 / 7 / 8)

- È possibile usare un disco di contrasto bianco/nero per aumentare il contrasto dell'immagine quando si lavora in luce incidente.
1. Rimuovere il disco opalino trasparente usato in luce trasmessa.
 2. Inserire il disco bianco/nero con il lato desiderato rivolto verso l'alto. (Fig. 52)
- Se si osservano campioni chiari, posizionare il disco con la parte nera rivolta verso l'alto.



9.10 Uso dell'illuminazione (SZ-ST2 / 3 / 7 / 8)

1. Ruotare la manopola della luce trasmessa ② per accendere/spengere o regolare l'intensità luminosa del LED trasmessa. (Fig. 53)
 2. Ruotare la manopola della luce incidente ① per accendere/spengere o regolare l'intensità luminosa del LED per luce incidente.
- È possibile usare entrambi gli illuminatori simultaneamente.

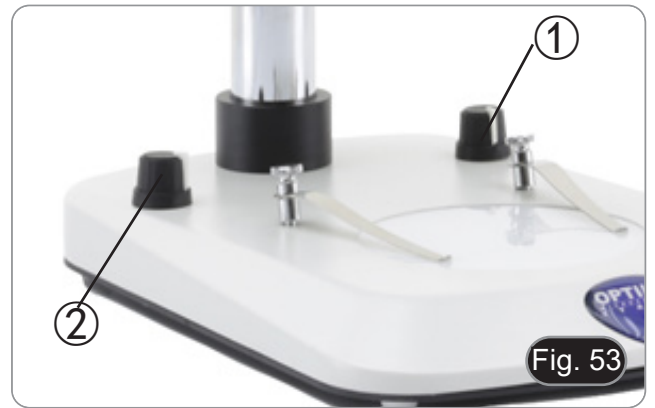

Solo per SZ-ST7 / SZ-ST8:

- Inclinare e posizionare i bracci autoportanti della base ③ per illuminare in maniera ottimale il campione. (Fig. 54)
- I bracci possono essere sistemati singolarmente nella posizione desiderata.



9.11 Uso dell'illuminazione (SZ-OBL)

1. Ruotare la manopola della luce trasmessa ① per accendere/spengere o regolare l'intensità luminosa del LED per luce trasmessa. (Fig. 55)
 2. Ruotare la manopola di rotazione dello specchio ② per inclinare lo specchio fino ad ottenere l'illuminazione obliqua desiderata.
- Lo specchio ha una superficie liscia ed una zigrinata. Le due superfici consentono di ottimizzare l'osservazione fornendo un contrasto adeguato in funzione del campione da osservare.



9.12 Uso dei paraocchi in gomma (SZO-B / T)

• Uso con occhiali da vista

Abbassare i paraocchi in gomma con entrambe le mani. La presenza dei paraocchi abbassati evita di graffiare le lenti degli occhiali. (Fig. 56)



- **Uso senza occhiali da vista**

Rialzare i paraocchi ed osservare al microscopio appoggiando gli occhi ai paraocchi, in modo da evitare che la luce esterna arrivi a disturbare l'occhio. (Fig. 57)



9.13 Uso delle basi a sbalzo

9.13.1 SZ-STL1

Spostare il braccio orizzontale

1. Allentare le manopole sulla parte destra del braccio orizzontale ①. (Fig. 58)
2. Il braccio può essere allungato o accorciato in base alle specifiche esigenze. (Fig. 59)




Angolare la testa

1. Allentare le manopole ① e ruotare la testa fino all'angolo desiderato (destra o sinistra), quindi serrare la vite di fissaggio. (Fig. 60)



Ruotare il braccio orizzontale


1. Allentare la vite di fissaggio del braccio orizzontale ② e ruotare il braccio, quindi serrare la vite di fissaggio. (Fig. 61)
- **NOTA: Una rotazione del microscopio di 180° rispetto alla base potrebbe causare un rovesciamento di tutto il sistema.**

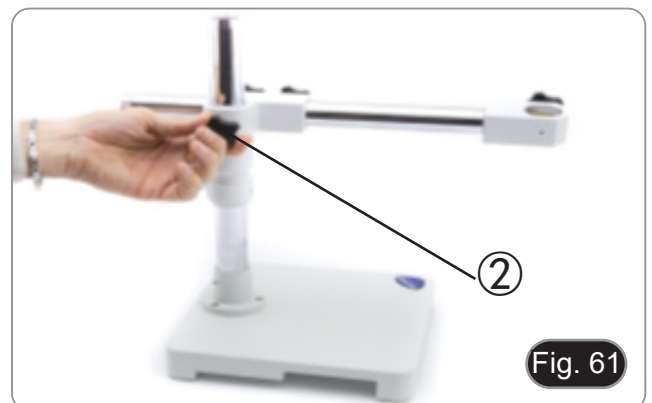

9.13.2 SZ-STL2

Spostare il braccio orizzontale

1. Allentare la manopola sulla parte sinistra del braccio orizzontale ①. (Fig. 62)

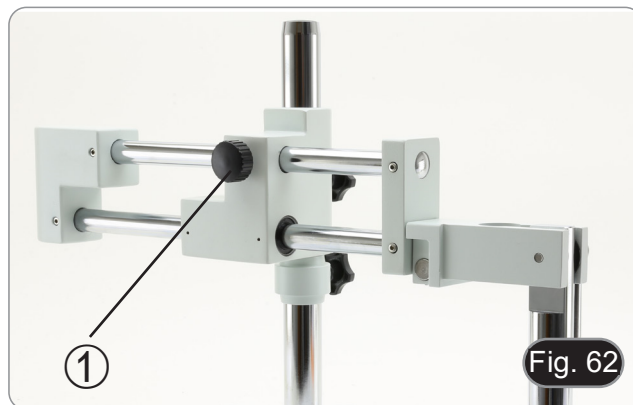

2. Il braccio può essere allungato o accorciato in base alle specifiche esigenze. (Fig. 63)




Inclinare il supporto della testa

1. Allentare la manopola ② (Fig. 64) sulla parte destra del supporto. La colonna inclinabile può essere spostata. Una volta raggiunto l'angolo desiderato, serrare la manopola.



Angolare la testa

1. Allentare la vite di fissaggio ③ e ruotare la testa fino all'angolo desiderato (destra o sinistra), quindi serrare la vite di fissaggio. (Fig. 65-66)

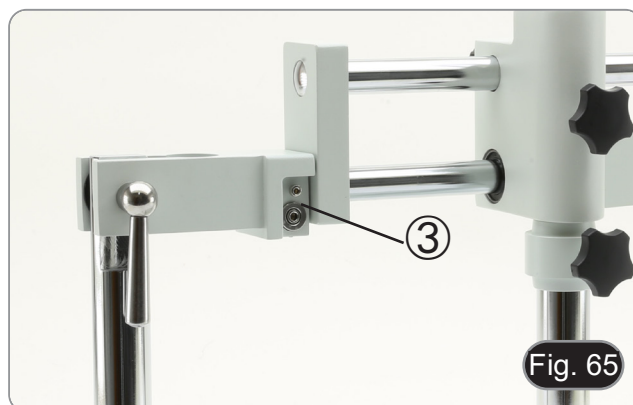



Ruotare il braccio orizzontale

1. Allentare la vite di fissaggio del braccio orizzontale ④ e ruotare il braccio, quindi serrare la vite di fissaggio. (Fig. 67)
- **NOTA: Una rotazione del microscopio di 180° rispetto alla base potrebbe causare un rovesciamento di tutto il sistema.**



9.13.3 SZ-STLX

Spostare il braccio orizzontale

1. Allentare la manopola sulla parte destra del braccio orizzontale ①. (Fig. 68)




2. Il braccio può essere allungato o accorciato in base alle specifiche esigenze. (Fig. 69)



Regolazione del blocco orizzontale

1. Sbloccare la manopola di fissaggio del blocco ② e spostarla in una posizione adatta alle esigenze dell'utente. (Fig. 70)
2. Bloccare la manopola di fissaggio per impostare il limite di movimento.

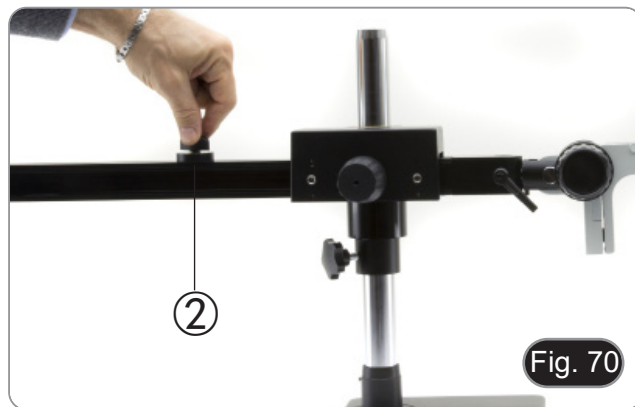

Inclinare il supporto testa

1. Allentare la vite a brugola ③ (Fig. 71) sulla parte superiore del supporto della testa.
2. La parte nera basculante può essere spostata. Una volta raggiunto l'angolo desiderato, serrare nuovamente la vite.



Angolare la testa

1. Sbloccare la manopola di fissaggio ④ e ruotare la testa fino all'angolo di rotazione desiderato (a sinistra o a destra), quindi stringere nuovamente la manopola. (Fig. 72-73)



Ruotare il braccio orizzontale


1. Allentare la manopola di fissaggio del braccio orizzontale ⑤ e ruotare il braccio, quindi stringere nuovamente la manopola. (Fig. 74)
- **NOTA:** la rotazione di 180° del microscopio rispetto alla base potrebbe causare un ribaltamento dell'intero sistema.




9.13.4 SZ-STL5 / SZ-STL5LED

Regolazione della tensione del braccio



- Questo strumento è stato sviluppato per poter regolare la resistenza all'inclinazione del braccio sia lateralmente sia dall'alto verso il basso, con un'ampiezza massima di movimento di 90 gradi in entrambe le direzioni. E' possibile controllare il livello di resistenza dello snodo del braccio.
1. Se lo snodo dell'attacco a muro tende automaticamente a scendere, è possibile sia necessario regolarne la tensione per riportare il vostro microscopio nella posizione desiderata sfruttando l'oscillazione verso l'alto o verso il basso. Questo si può fare utilizzando la chiave a brugola esagonale da 6 mm per aumentare la resistenza dello snodo e fissare la posizione, regolare la Vite di Tensione con testa esagonale M5x15mm posizionata ai lati dello snodo utilizzando la chiave a brugola esagonale 6 mm. (Fig. 75)

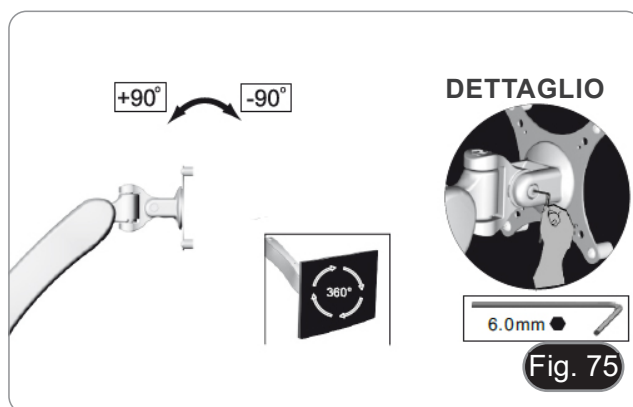

2. Per aumentare o diminuire la resistenza dello snodo ruotabile e permettere al microscopio di ruotare lateralmente, regolare la vite di tensione esagonale situata sul lato frontale dello snodo del braccio per fissare la posizione. (Fig. 76)
3. Per aumentare la resistenza, stringere la vite di tensione esagonale M5x15mm utilizzando la chiave a brugola esagonale 4 mm in senso orario. Per diminuire la resistenza, allentare la vite di tensione utilizzando la chiave a brugola esagonale fornita ruotando in senso anti-orario.

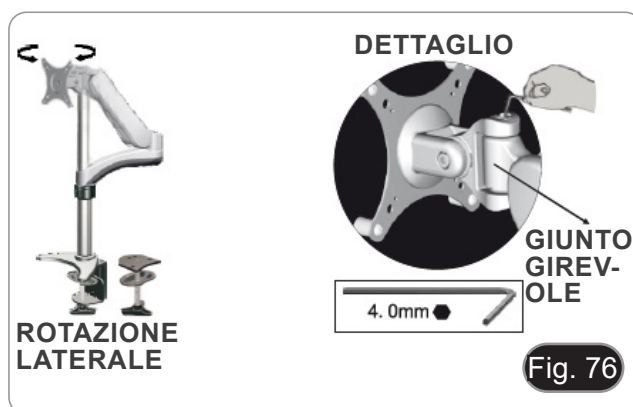

4. Lo strumento può salire o scendere come mostrato. (Fig. 77)
- Se tende automaticamente a muoversi lateralmente, è possibile sia necessario regolare la tensione dell'articolazione del braccio per permettere al vostro microscopio di ruotare lateralmente. Questo è possibile utilizzando la chiave a brugola 2,5 mm fornita. (Fig. 78)

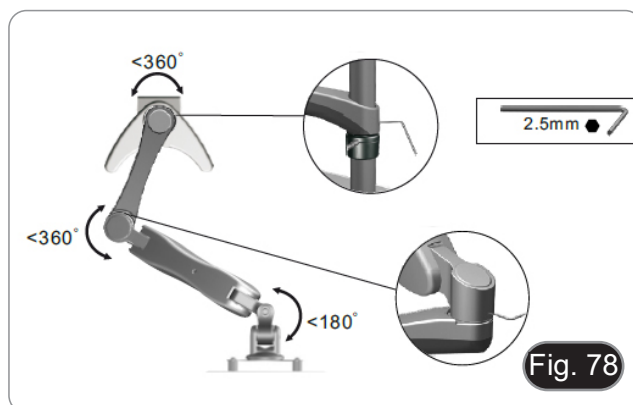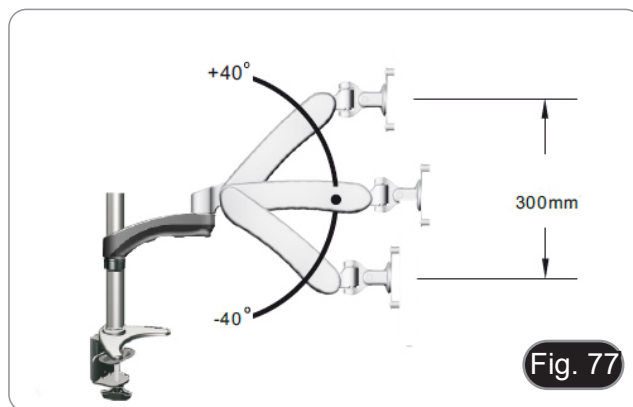

Regolazione della luminosità


Ruotare le manopole di regolazione dell'intensità luminosa ① per accendere/spegnere e per aumentare/diminuire l'intensità luminosa di ogni singolo braccio LED. (Fig. 79)



10. Microfotografia

10.1 Uso di telecamere a passo "C"

1. Allentare la vite di bloccaggio ① sul tubo trinoculare e rimuovere il tappo antipolvere ②. (Fig. 80)

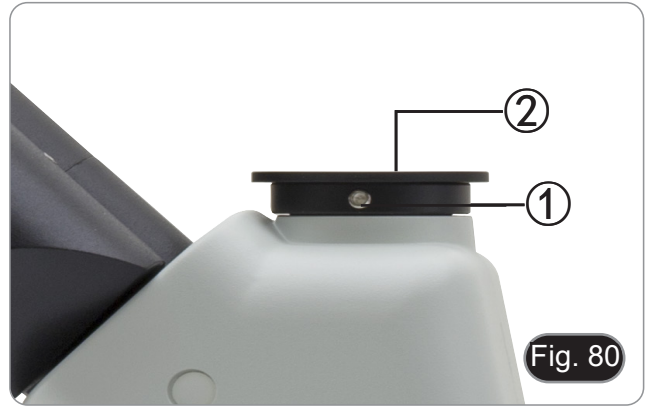

2. Avvitare l'adattatore passo C ③ alla telecamera ④ e installare l'attacco rotondo del passo C nel foro vuoto del tubo trinoculare, quindi riavvitare la vite di serraggio ①. (Fig. 81)



10.2 Uso di fotocamere Reflex

1. Inserire l'adattatore per reflex ① nel tubo di collegamento a microscopio ②.
 2. Avvitare l'anello "T2" ③ (non in dotazione) all'adattatore per reflex.
 3. Collegare la fotocamera Reflex ④ all'anello "T2" appena montato. (Fig. 82)
 4. Montare la parte terminale del tubo di collegamento ② nel foro vuoto del tubo trinoculare, quindi riavvitare la vite di serraggio. (Fig. 80)
- L'anello "T2" non è fornito insieme al microscopio, ma è disponibile in commercio.
 - Per la fotografia di preparati scuri, oscurare gli oculari e il mirino con un panno scuro per limitare la luce diffusa.
 - Per misurare l'ingrandimento della macchina fotografica calcolare: $\text{ingrandimento obiettivo} * \text{ingrandimento macchina fotografica} * \text{ingrandimento lente}$.
 - **Se si utilizza una macchina SLR, il movimento dello specchio potrebbe far vibrare la macchina.**
 - **Si consiglia di sollevare lo specchio, di usare tempi di esposizione lunghi e uno scatto remoto.**



11. Manutenzione

Ambiente di lavoro

Si consiglia di utilizzare il microscopio in un ambiente pulito e secco, privo di urti, ad una temperatura fra 0°C e 40°C e con una umidità relativa massima dell'85% (in assenza di condensazione). Si consiglia l'uso di un deumidificatore se necessario.

Prima e dopo l'utilizzo del microscopio



- Tenere il microscopio sempre in posizione verticale quando lo si sposta.
- Assicurarsi inoltre che le parti mobili, ad esempio gli oculari, non cadano.
- Non maneggiare senza precauzioni e non adoperare inutile forza sul microscopio.
- Non cercare di provvedere da soli alla riparazione.
- Dopo l'uso spegnere immediatamente la lampada, coprire il microscopio con l'apposita copertina antipolvere in dotazione e tenerlo in un luogo asciutto e pulito.

Precauzioni per un utilizzo sicuro



- Prima di collegare l'alimentatore alla rete elettrica assicurarsi che il voltaggio locale sia idoneo a quello dell'apparecchio e che l'interruttore della lampada sia posizionato su OFF.
- Attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza della zona in cui ci si trova ad operare.

Pulizia delle ottiche

- Qualora le ottiche necessitino di essere pulite, utilizzare prima di tutto aria compressa.
- Se questo non fosse sufficiente usare un panno non sfilacciato, inumidito con acqua e un detergente delicato.
- Come ultima opzione è possibile usare un panno inumidito con una soluzione 3:7 di alcol etilico ed etere.
- **Attenzione: l'alcol etilico e l'etere sono sostanze altamente infiammabili. Non usarle vicino ad una fonte di calore, a scintille o presso apparecchiature elettriche. Le sostanze devono essere adoperate in un luogo ben ventilato.**
- Non strofinare la superficie di nessun componente ottico con le mani. Le impronte digitali possono danneggiare le ottiche.
- Non smontare gli obiettivi o gli oculari per cercare di pulirli.

Per un migliore risultato, utilizzare il kit di pulizia OPTIKA (vedi catalogo).

Se si necessita di spedire il microscopio al produttore per la manutenzione, si prega di utilizzare l'imballo originale.

12. Guida alla risoluzione dei problemi

Consultare le informazioni riportate nella tabella seguente per risolvere eventuali problemi operativi.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
I. Sezione Ottica:		
Il LED è acceso, ma il campo visivo è scuro	L'alimentatore è scollegato.	Collegarlo
	La luminosità è troppo bassa	Regolarla ad un livello adeguato
I bordi del campo visivo sono vignettati o la luminosità è asimmetrica.	L'illuminatore per luce incidente non è orientato correttamente	Modificare l'angolo dell'illuminatore per luce incidente
Nel campo visivo si osservano sporco e polvere.	Sporco e polvere sul campione	Pulire il campione
	Sporco e polvere sull'oculare	Pulire l'oculare
Bassa qualità dell'immagine. <ul style="list-style-type: none"> • Immagine non buona. • Basso contrasto. • Dettagli non nitidi. • Riflessi nell'immagine 	Le lenti (lenti addizionali, oculari) sono sporche	Pulire accuratamente tutte le componenti ottiche
Un lato dell'immagine non è a fuoco	Il campione non è ben posizionato (inclinato)	Posizionare in piano il campione sul piattello.
II. Sezione Meccanica:		
La manopola macrometrica è difficile da ruotare	L'anello di regolazione della tensione è troppo stretto	Allentare l'anello di regolazione della tensione
La messa a fuoco è instabile	L'anello di regolazione della tensione è troppo allentato	Stringere l'anello di regolazione della tensione
III. Sezione Elettrica:		
Il LED non si accende.	Lo strumento non viene alimentato	Verificare il collegamento del cavo di alimentazione
La luminosità è insufficiente	La luminosità è regolata bassa	Regolare la luminosità
La luce lampeggia	Il cavo di alimentazione non è collegato bene	Verificare il collegamento del cavo
IV. Testa di osservazione:		
Il campo visivo è diverso per ciascun occhio	La distanza interpupillare non è corretta	Regolare la distanza interpupillare
	La correzione diottrica non è giusta	Regolare la correzione diottrica
	La tecnica di visione non è corretta, e l'operatore sforza la vista	Quando guarda il campione non focalizzi lo sguardo in un unico punto ma guardi l'intero campo visivo a disposizione. Periodicamente distolga lo sguardo e guardi un punto distante, dopodichè torni ad analizzare il campione.
V. Microfotografia:		
L'immagine non è a fuoco	Messa a fuoco incorretta	Regolare la messa a fuoco come spiegato nel manuale
Sull'immagine compaiono delle macchie chiare	Nel microscopio entra della luce diffusa attraverso gli oculari.	Coprire gli oculari con un panno scuro

Smaltimento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n°151. "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto riportato sulla apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo della apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain
spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA
usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China
china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® India
india@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Central America
camerica@optikamicroscopes.com

Serie SZ

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo	
SZ-A1	SZ-A6
SZX-B	SZX-T
SZX-BA	SZX-TA
SZO-B	SZO-T
SZ-ST1	SZ-ST2
SZ-ST3	SZ-ST7
SZ-ST8	SZ-OBL
ST-150	ST-152
SZ-STL1	SZ-STL2
SZ-STLX	SZ-STL5
SZ-STL5LED	

Ver. 2.3 2022



Índice

1.	Advertencia	108
2.	Información de seguridad	108
3.	Contenido del embalaje	109
3.1	SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA	109
3.2	SZO-B / SZO-T	110
3.3	SZ-A1	110
3.4	SZ-A6	111
3.5	ST-150	111
3.6	ST-152	112
3.7	SZ-ST1	112
3.8	SZ-ST2 / SZ-ST3	113
3.9	SZ-ST7 / SZ-ST8	113
3.10	SZ-OBL	114
3.11	SZ-STL1	114
3.12	SZ-STL2	115
3.13	SZ-STLX	115
3.14	SZ-STL5	116
3.15	SZ-STL5LED	117
4.	Desembalaje	118
5.	Utilización	118
6.	Símbolos	118
7.	Descripción del instrumento	119
7.1	Diagrama del Sistema	119
7.2	SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA	120
7.3	SZO-B / SZO-T	120
7.4	SZ-A1	121
7.5	SZ-A6	121
7.6	ST-150	122
7.7	ST-152	122
7.8	SZ-ST1	123
7.9	SZ-ST2 / SZ-ST3	123
7.10	SZ-ST7 / SZ-ST8	124
7.11	SZ-OBL	124
7.12	SZ-STL1	125
7.13	SZ-STL2	125
7.14	SZ-STLX	126
7.15	SZ-STL5	126
7.16	SZ-STL5LED	127
8.	Montaje	128
8.1	SZ-A1 / SZ-A6	128
8.2	SZ-ST1 / ST-150	128
8.3	ST-152	128
8.4	SZ-ST2 / SZ-ST3	128
8.5	SZ-ST7 / SZ-ST8 / SZ-OBL	129
8.6	SZ-STL1	129
8.7	SZ-STL2	132
8.8	SZ-STLX	134
8.9	SZ-STL5 / SZ-STL5LED	137
8.10	Instalar el cabezal (todos los modelos)	138
8.11	Instalar los oculares (todos los modelos)	138
8.12	Instalación de la salida foto (SZX-T/TA)	138
9.	Uso del microscopio	140
9.1	Regulación de la distancia interpupilar	140
9.2	Enfoque	140
9.3	Ajuste de la tensión de los botones de enfoque	140
9.3.1	SZ-A1	140
9.3.2	SZ-A6	140
9.4	Palanca de bloqueo del enfoque (SZ-A6)	141
9.5	Compensación dioptrica	141
9.6	Aumento	142
9.7	Uso de lentes adicionales	142
9.8	Uso de lentes adicionales 0.3X-0.5X	143
9.9	Placa blanco/negro (SZ-ST1 / 2 / 3 / 7 / 8)	143
9.10	Uso de la iluminación (SZ-ST2 / 3 / 7 / 8)	144
9.11	Uso de la iluminación (SZ-OBL)	144
9.12	Uso de protectores de goma (SZO-B / T)	144
9.13	Uso de bases en voladizo	146
9.13.1	SZ-STL1	146

9.13.2 SZ-STL2	147
9.13.3 SZ-STLX	148
9.13.4 SZ-STL5 / SZ-STL5LED	150
10. Microfotografía	152
10.1 Uso de cámaras de paso "C"	152
10.2 Uso de cámara Reflex	152
11. Mantenimiento	153
12. Guía de solución de problemas	154
Medidas ecológicas y reciclaje	155

1. Advertencia

Este microscopio es un instrumento científico de precisión. Su utilización está pensada para una larga duración con un mínimo nivel de mantenimiento. Para su fabricación se han utilizado elementos ópticos y mecánicos de elevada calidad que lo convierten en el instrumento ideal para la utilización diaria en las aulas y el laboratorio. Informamos que esta guía contiene importantes informaciones sobre la seguridad y el mantenimiento del producto y por lo tanto debe ser accesible a todos aquellos que utilizan dicho instrumento.

2. Información de seguridad



Evitar una descarga eléctrica

Antes de conectar el microscopio a la toma de corriente, asegurarse que la tensión de entrada del lugar donde se usa coincide con la tensión de utilización del microscopio y que el interruptor del iluminador esté en posición off. El usuario debe consultar las normas de seguridad de su país. El instrumento está dotado de una etiqueta de seguridad CE. No obstante estas pautas, el usuario debería utilizar el microscopio en función de sus necesidades pero con un mínimo de responsabilidad y seguridad. Por favor, siga las siguientes instrucciones y lea éste manual en su totalidad para asegurar la operación segura del equipo.

3. Contenido del embalaje

3.1 SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA



① Cuerpo del microscopio

• SZX-B/BA Binocular / SZX-T/TA Trinocular

② Oculares

③ Llave Allen (sólo para SZX-T/TA)

④ Cubierta antipolvo

⑤ Anillo de salida de fotos (sólo para SZX-T/TA)


3.2 SZO-B / SZO-T



- ① Cuerpo del microscopio
 - SZO-B Binocular / SZO-T Trinocular
- ② Oculares


- ③ Llave Allen (sólo para SZO-T)
- ④ Cubierta antipolvo

3.3 SZ-A1

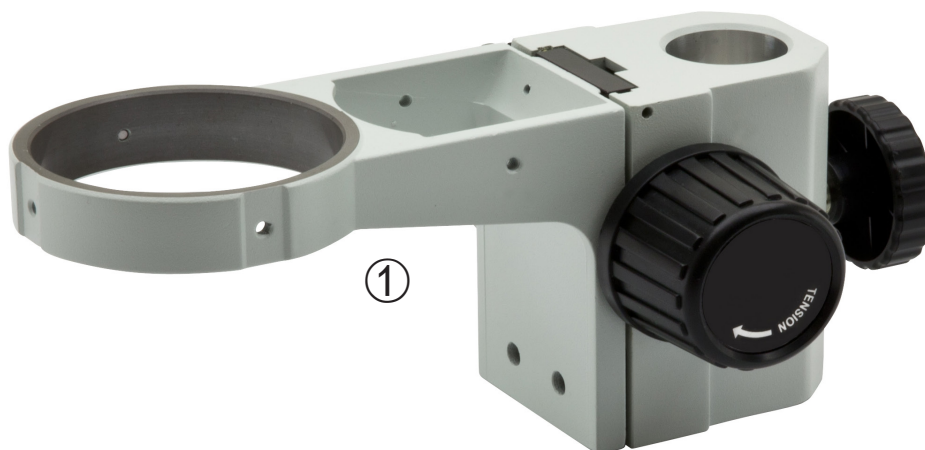

- ① Enfoque Macro

3.4 SZ-A6

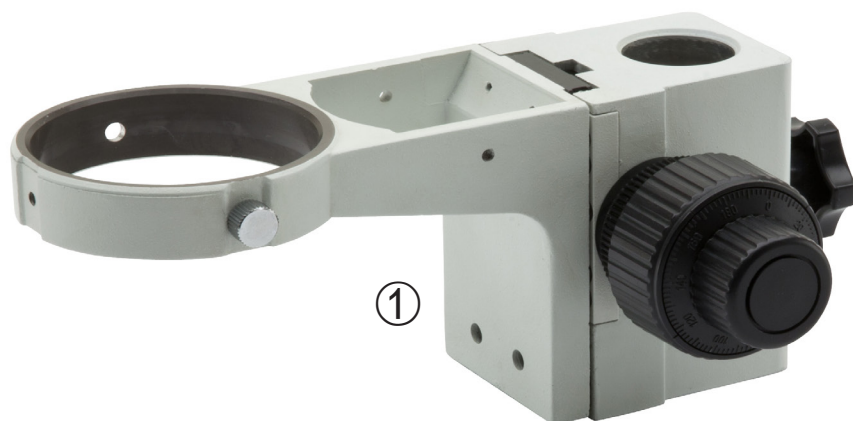

① Enfoque Macro/Micro

3.5 ST-150




① Base

② Soporte de cabezal / enfoque

③ Pilar

④ Cubierta antipolvo

3.6 ST-152

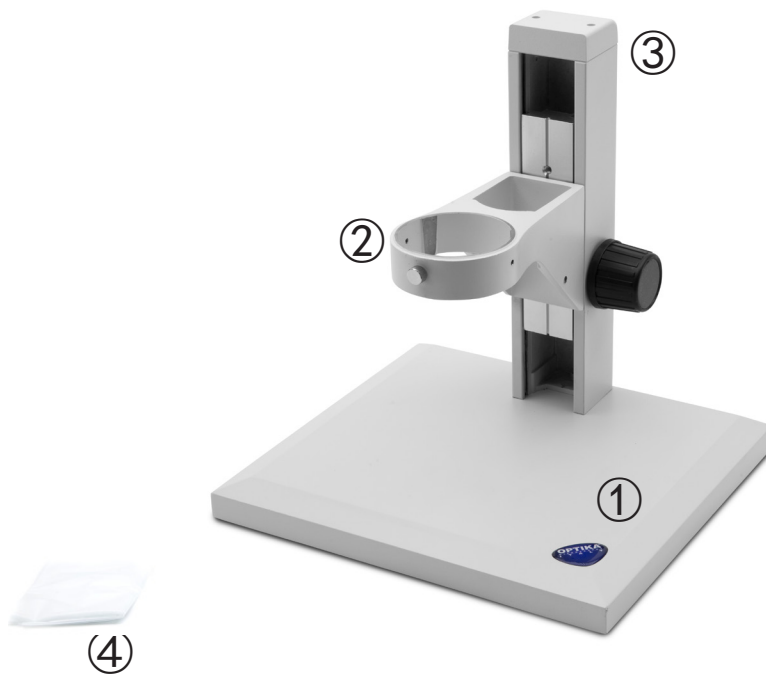

- ① Base
- ② Soporte de cabezal / enfoque

- ③ Pilar
- ④ Cubierta antipolvo

3.7 SZ-ST1



- ① Base
- ② Pinzas de muestras (una pareja)

- ③ Placa blanca/negra

3.8 SZ-ST2 / SZ-ST3



- ① Base
- ② Placa opalina
- ③ Pinzas de muestras (una pareja)

- ④ Iluminador luz incidente
- ⑤ Placa blanca/negra
- ⑥ Fuente de alimentación

3.9 SZ-ST7 / SZ-ST8



- ① Base
- ② Placa opalina
- ③ Pinzas de muestras (una pareja)

- ④ Placa blanca/negra
- ⑤ Fuente de alimentación


3.10 SZ-OBL



- ① Base
- ② Pilar
- ③ Placa de vidrio

- ④ Alimentación
- ⑤ Cubierta de polvo


3.11 SZ-STL1

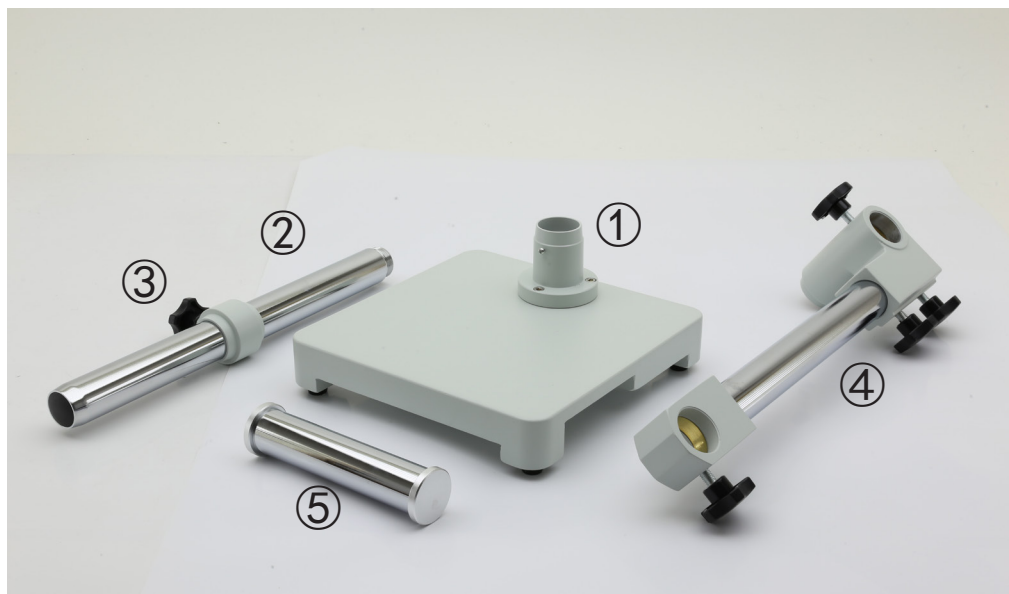

- ① Base
- ② Brazo vertical
- ③ Anillo de prevención de descenso

- ④ Brazo horizontal
- ⑤ Brazo de soporte de enfoque

3.12 SZ-STL2

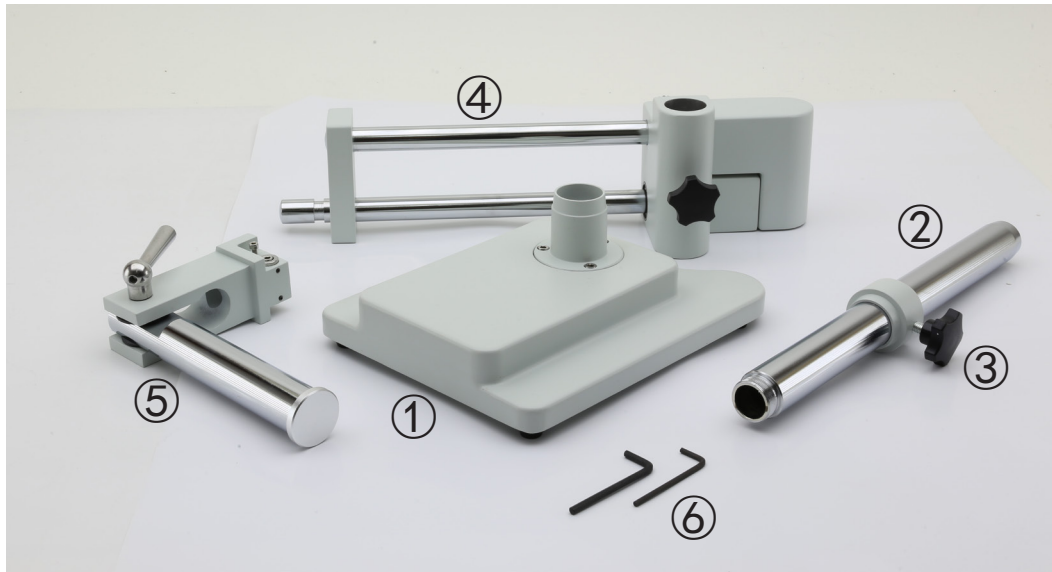


- ① Base
- ② Brazo vertical
- ③ Anillo de prevención de descenso
- ④ Brazo horizontal
- ⑤ Brazo de soporte de enfoque
- ⑥ Llave Allen

3.13 SZ-STLX




- ① Base
- ② Brazo vertical
- ③ Brazo horizontal
- ④ Anillo de prevención de descenso
- ⑤ Enfoque
- ⑥ Llave Allen

3.14 SZ-STL5

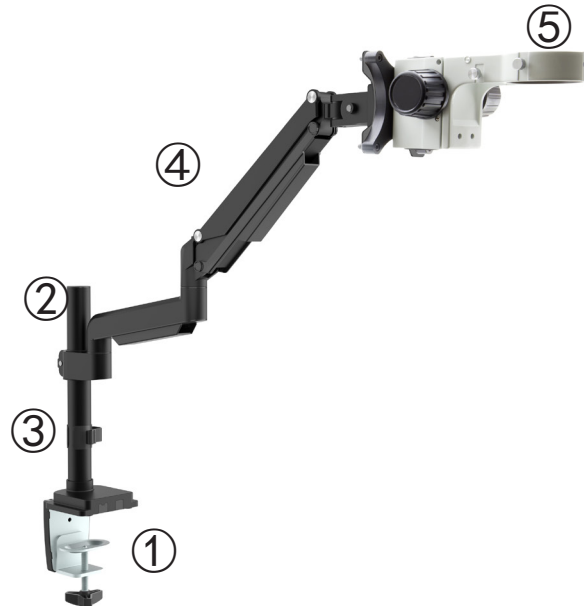

- ① Pinza de mesa
- ② Pilar
- ③ Anillo de prevención de caídas
- ④ Brazo horizontal
- ⑤ Soporte de cabezal / enfoque
- ⑥ Bridas para cables
- ⑦ Junta circular
- ⑧ Tornillos cortos M4x12 mm (4 piezas)
- ⑨ Tornillos largos M4x25 mm (4 piezas)
- ⑩ Llaves Allen
- ⑪ Pies de goma (4 piezas)
- ⑫ Junta rectangular
- ⑬ Pinza de mesa para grandes espesores

3.15 SZ-STL5LED

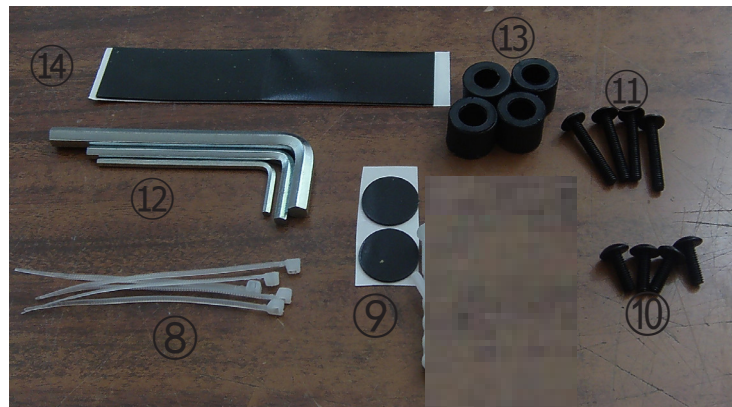

- ① Pinza de mesa
- ② Pilar
- ③ Anillo de prevención de caídas
- ④ Brazo horizontal
- ⑤ Soporte de cabezal / enfoque
- ⑥ Brazos autoportantes LED
- ⑦ Caja de control de luminosidad con fuente de alimentación
- ⑧ Bridas para cables
- ⑨ Junta circular
- ⑩ Tornillos cortos M4x12 mm (4 piezas)
- ⑪ Tornillos largos M4x25 mm (4 piezas)
- ⑫ Llaves Allen
- ⑬ Pies de goma (4 piezas)
- ⑭ Junta rectangular
- ⑮ Pinza de mesa para grandes espesores

4. Desembalaje

El microscopio está embalado dentro de una caja de porexpan. Quitar el precinto que hay alrededor de la caja y abrirla. Tenga cuidado al abrir la caja ya que algunos accesorios ópticos como objetivos y oculares podrían caerse o dañarse. Con las dos manos (una sujetando el brazo y la otra la base) extraer el microscopio de dentro la caja de porexpan y poner sobre la mesa, procurando que ésta sea fuerte y estable.



Evite tocar superficies ópticas como lentes, filtros o gafas. Rastros de grasa u otros residuos pueden reducir la calidad visual de la imagen final y corroer la superficie de la óptica en poco tiempo.

5. Utilización

Modelos estándar

Para uso exclusivo de investigación y docencia. No está destinado a ningún uso terapéutico o diagnóstico animal o humano.

Modelos IVD

También para uso diagnóstico, orientado a obtener información sobre la situación fisiológica o patológica del sujeto.

6. Símbolos

A continuación le mostramos una lista de los símbolos que encontrará a lo largo de éste manual.



PRECAUCIÓN

Éste símbolo indica riesgo alto y le advierte de proceder con precaución.



DESCARGA ELÉCTRICA

Éste símbolo indica riesgo de descarga eléctrica.

7. Descripción del instrumento

7.1 Diagrama del Sistema



7.2 SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA




7.3 SZO-B / SZO-T




7.4 SZ-A1




7.5 SZ-A6

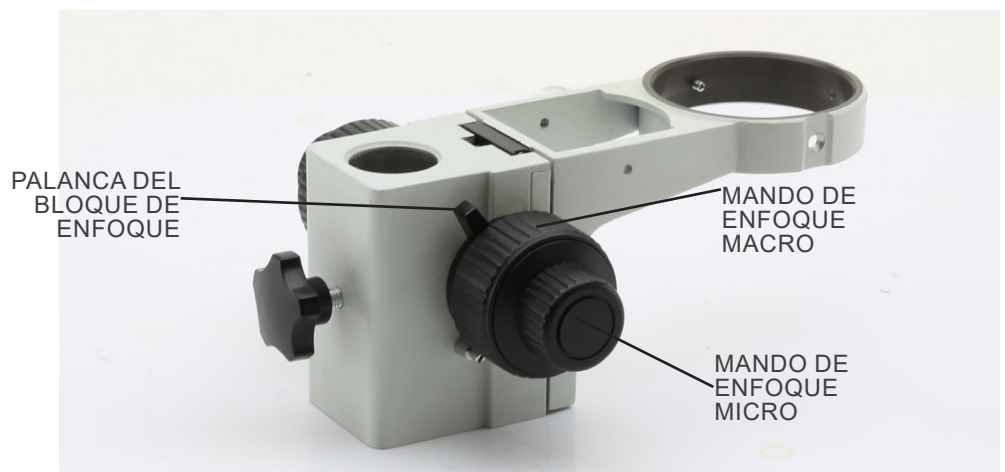


7.6 ST-150

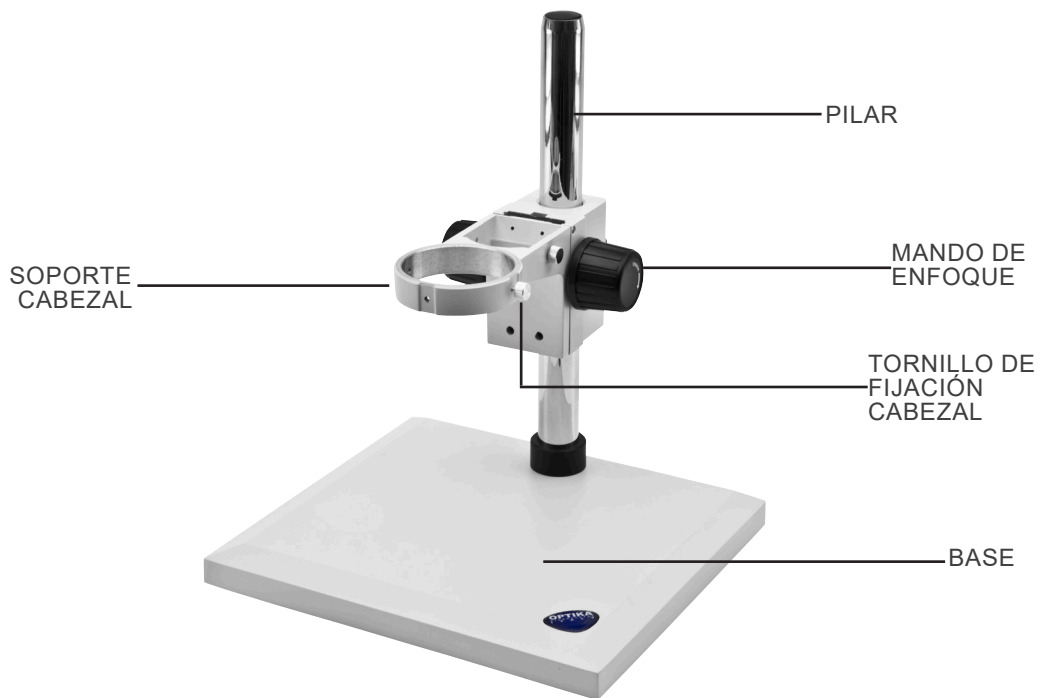


7.7 ST-152

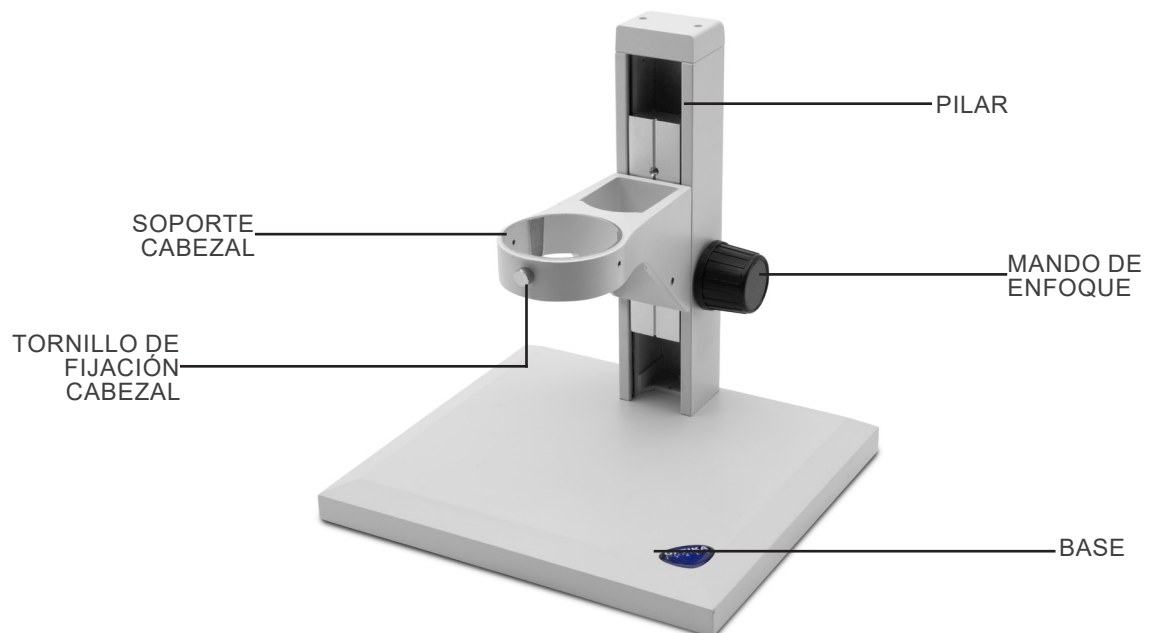


7.8 SZ-ST1

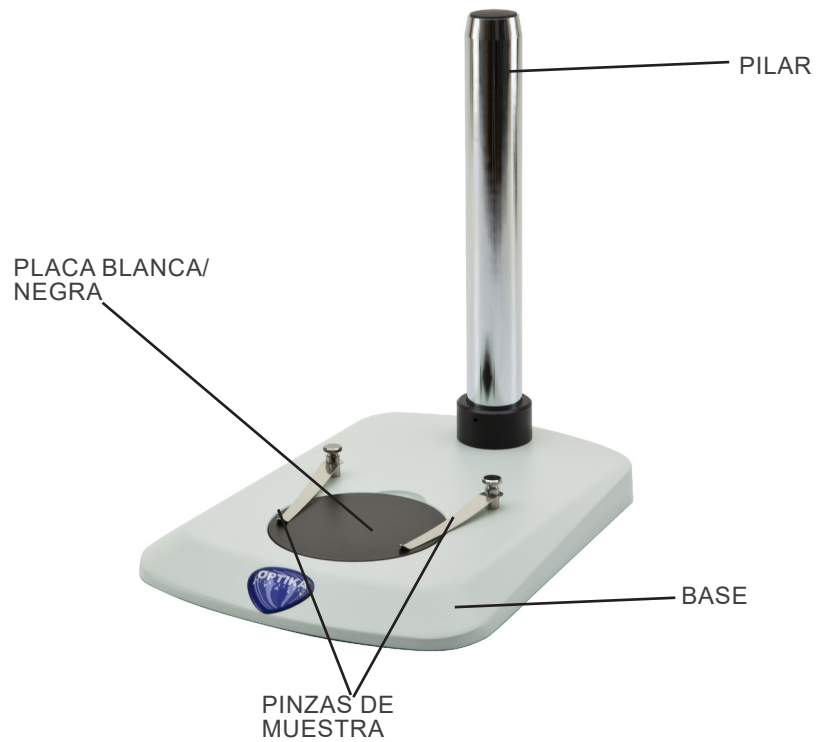


7.9 SZ-ST2 / SZ-ST3

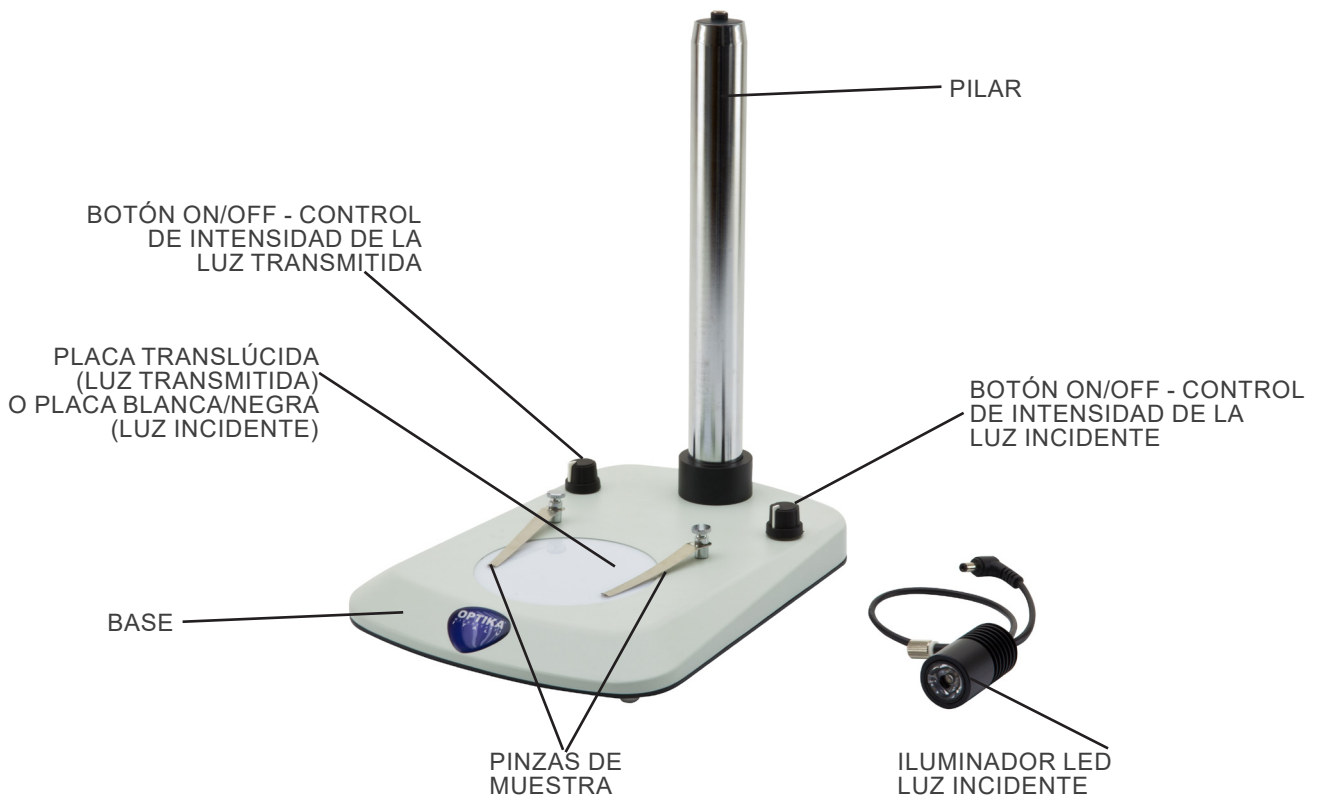


7.10 SZ-ST7 / SZ-ST8

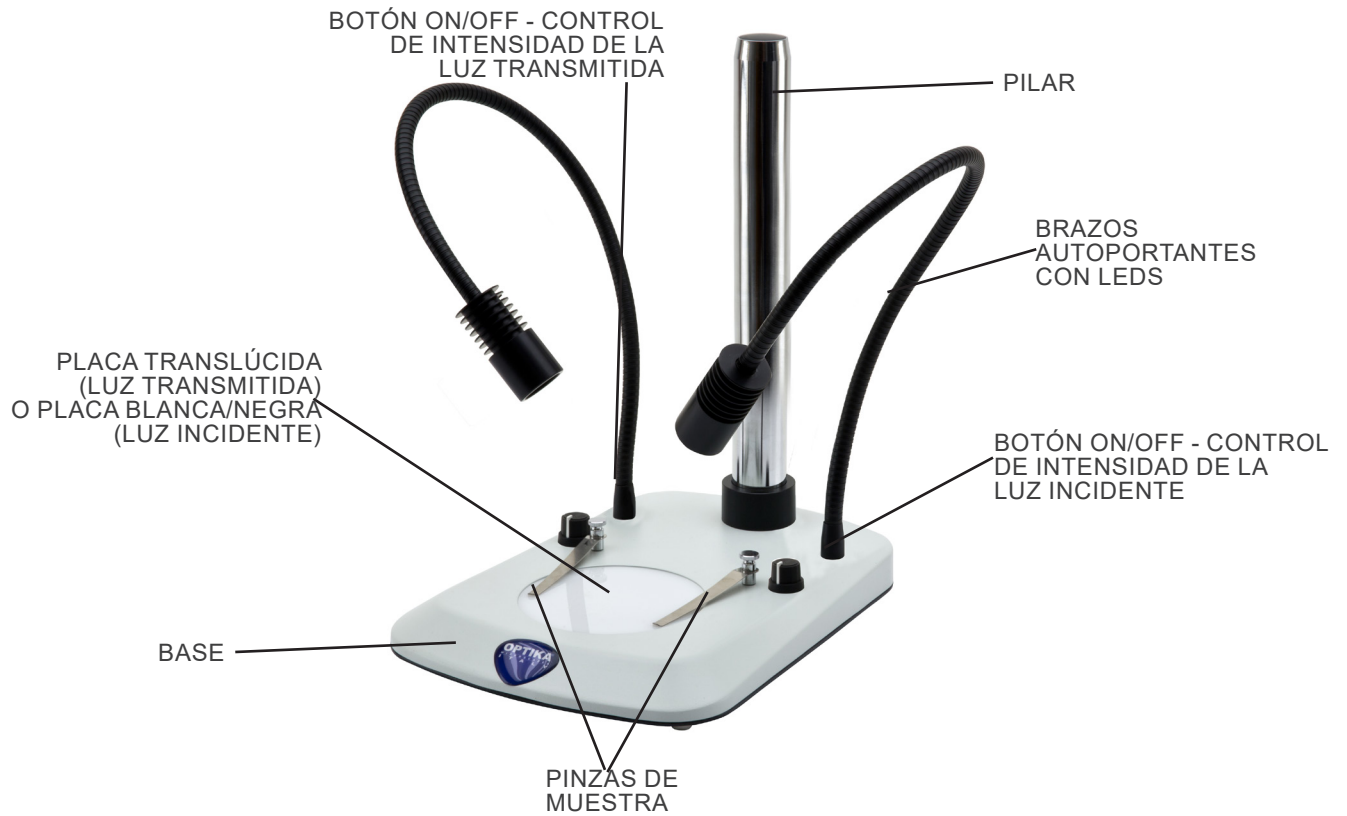


7.11 SZ-OBL

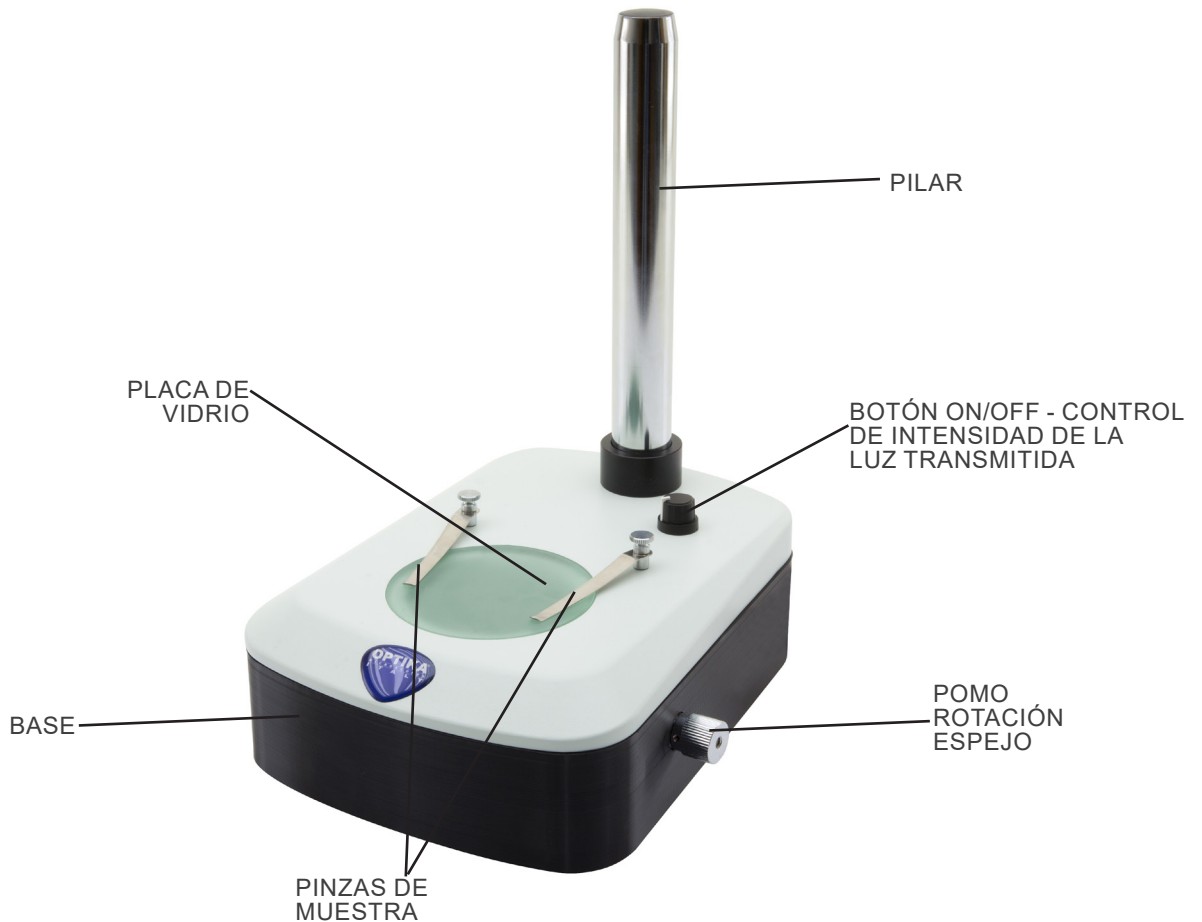


7.12 SZ-STL1

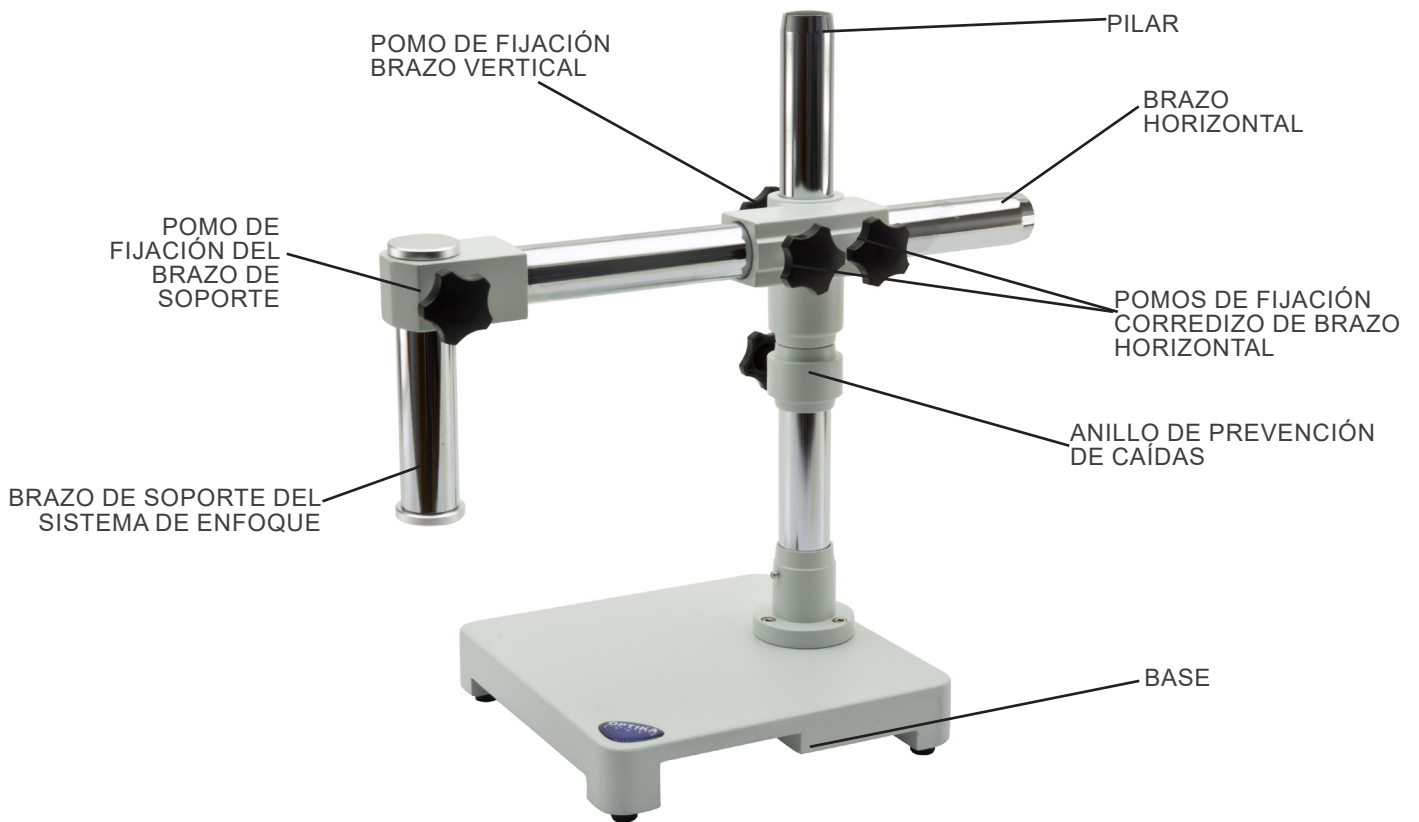


7.13 SZ-STL2

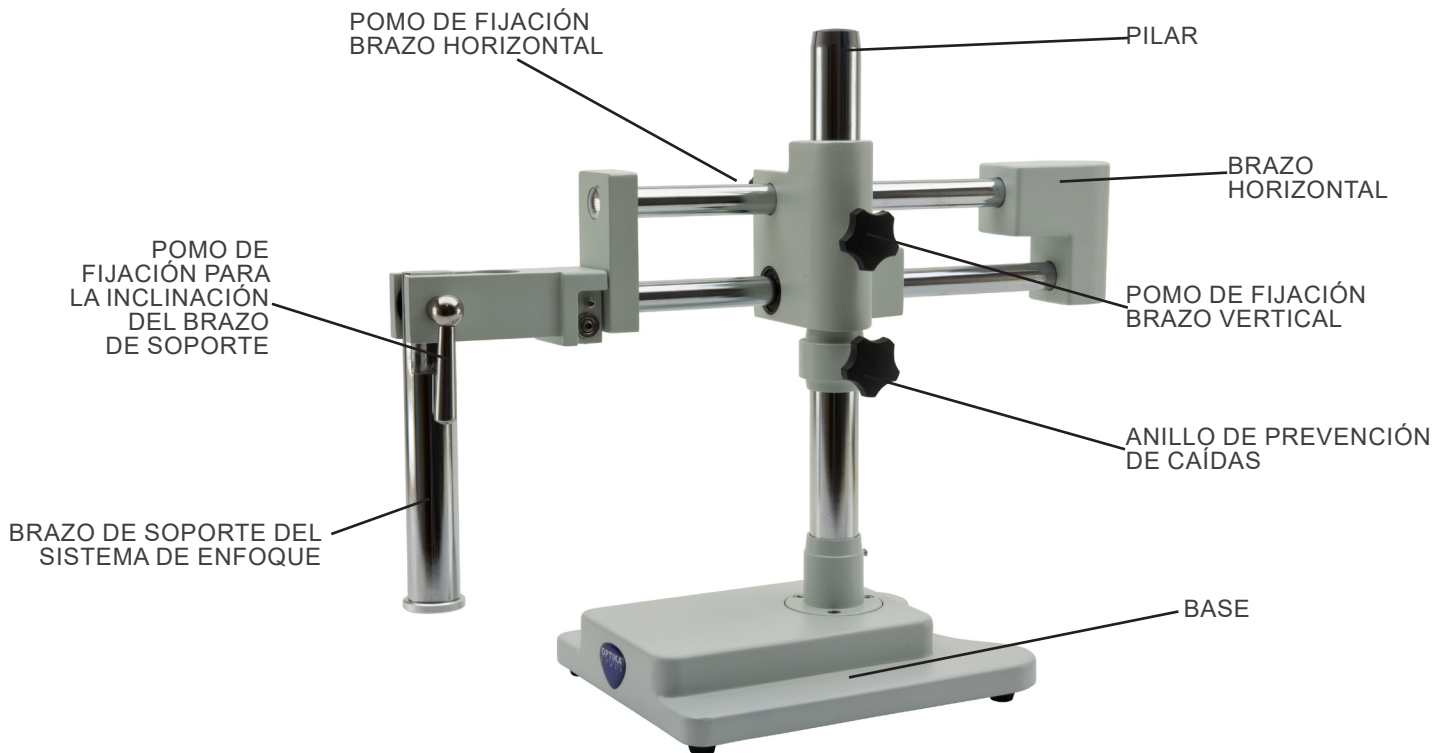


7.14 SZ-STLX

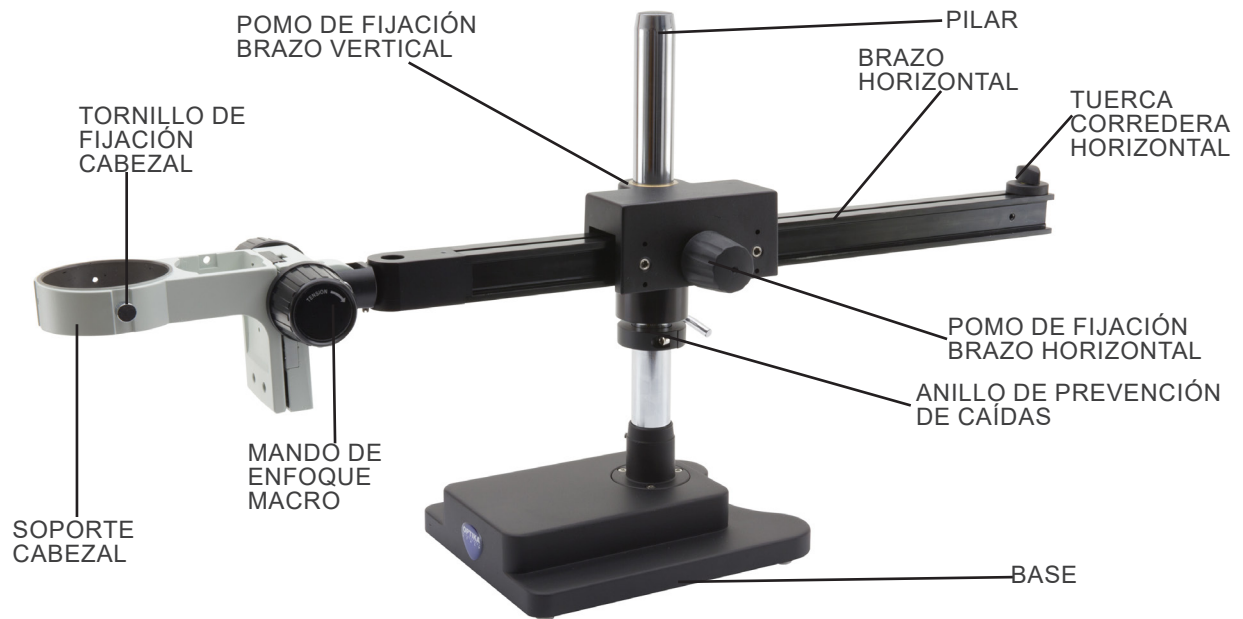

7.15 SZ-STL5

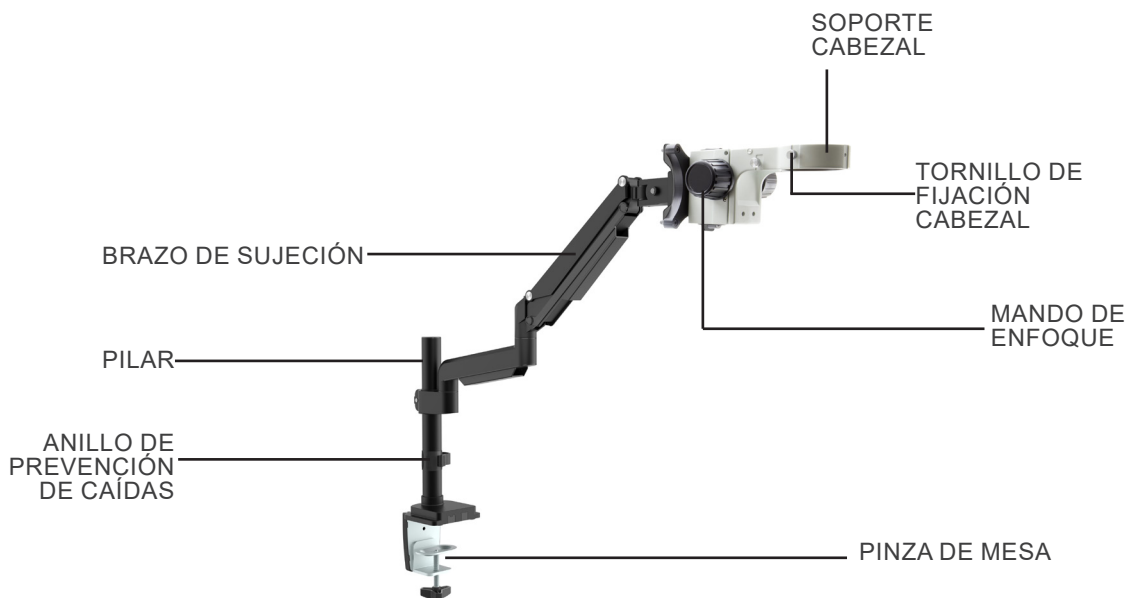


7.16 SZ-STL5LED

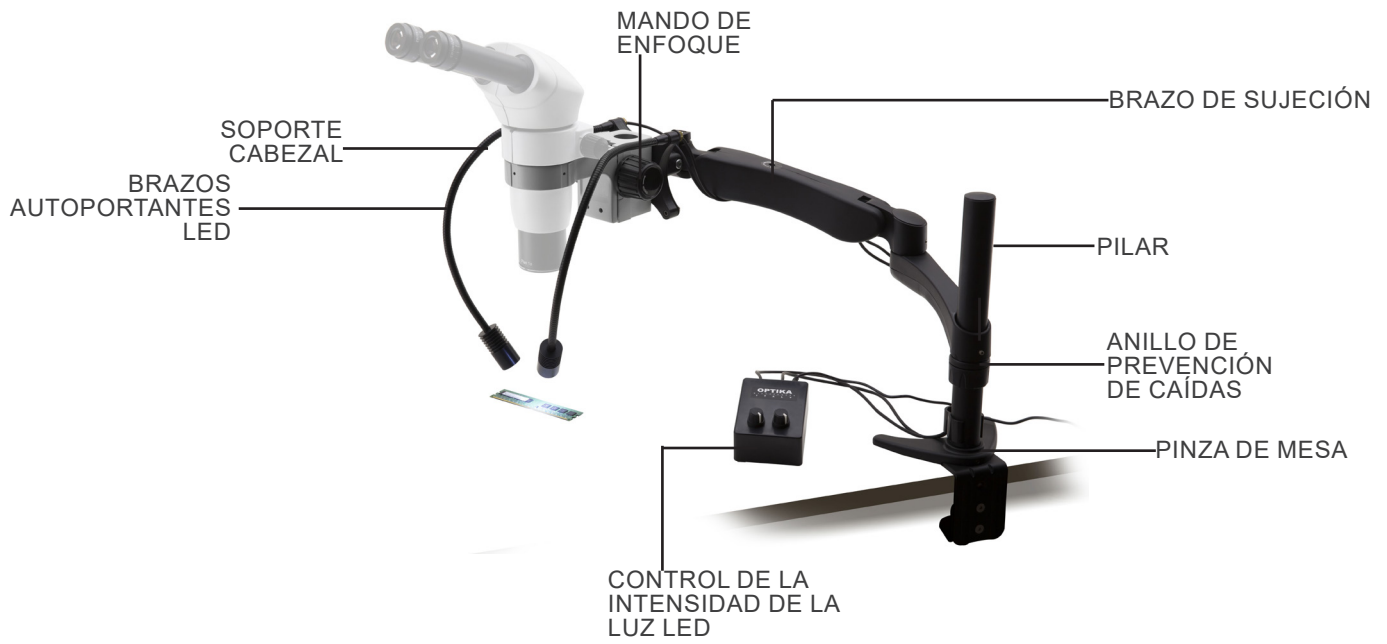

8. Montaje

8.1 SZ-A1 / SZ-A6

- El montaje de los sistemas de enfoque SZ-A1 y SZ-A6 se aplica a todas las bases excepto SZ-STL1, SZ-STL2 y SZ-STLX. Para el montaje en estas bases, consulte la sección específica.
1. Coloque el sistema de enfoque en la columna y, una vez alcanzada la altura deseada, apriete la perilla de bloqueo ① situada en la parte posterior del sistema de enfoque. (Fig. 1)

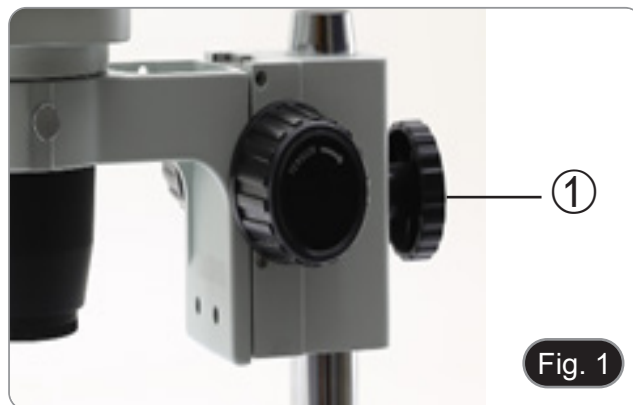

8.2 SZ-ST1 / ST-150

1. Retire la base de su embalaje y colóquela sobre una superficie plana. La base ya viene montada de fábrica y no requiere ningún otro procedimiento de montaje que no sea el de montar el sistema de enfoque.

8.3 ST-152


1. Retire la base de su embalaje y colóquela sobre una superficie plana. La base ya viene montada de fábrica y no requiere ningún otro procedimiento de montaje.

8.4 SZ-ST2 / SZ-ST3

1. Instale el reflector LED para la luz incidente como se muestra en la Fig. 2.
- Aflojando el tornillo de fijación ② se puede cambiar el ángulo de inclinación del foco para optimizar la iluminación de la muestra.



2. Inserte el enchufe del cable en el conector situado en la parte superior del pilar ③. (Fig. 3)

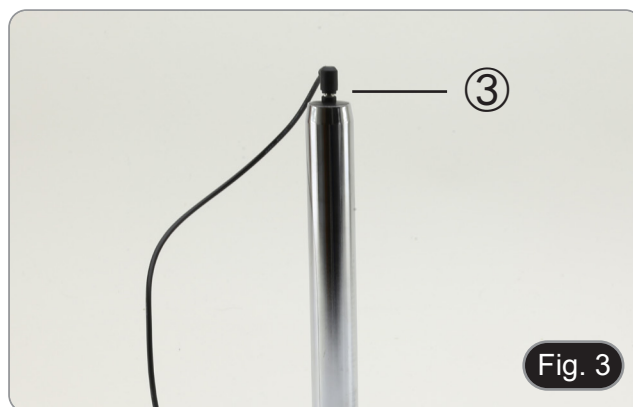

3. Conecte el enchufe de la fuente de alimentación al conector situado en la parte posterior de la base del microscopio. (Fig. 4)



8.5 SZ-ST7 / SZ-ST8 / SZ-OBL

1. Retire la base de su embalaje y colóquela sobre una superficie plana. La base ya viene montada de fábrica y no requiere ningún otro procedimiento de montaje que no sea el de montar el sistema de enfoque.
2. Conecte el enchufe de la fuente de alimentación al conector situado en la parte posterior de la base del microscopio. (Fig. 4)

8.6 SZ-STL1

1. Atornille el pilar a la base. (Fig. 5)




2. Apriete los tornillos para bloquear el pilar. (Fig. 6)



3. Inserte el anillo de prevención de caídas y fíjelo a la altura deseada atornillando el pomo de fijación. (Fig. 7)



4. Insertar el brazo horizontal y fijarlo con el tornillo de fijación ①. (Fig. 8 - 9)

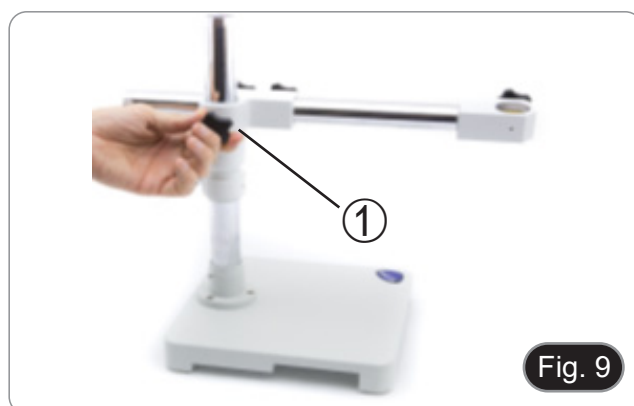

5. Instale el soporte de enfoque. Desenrosque el botón de prevención ② e inserte el brazo de soporte de cabeza ③ desde arriba en el orificio del brazo horizontal. (Fig. 10-11)



6. Una vez insertado completamente, apriete el tornillo de fijación ④ (Fig. 11)



7. Inserte el sistema de enfoque desde abajo, apriete el tornillo de fijación ⑤ y vuelva a apretar la perilla de bloqueo ③ desde abajo. (Fig. 12-13)



8.7 SZ-STL2

1. Atornille el pilar a la base. (Fig. 14)




2. Apriete los tornillos para bloquear el pilar. (Fig. 15)




3. Inserte el anillo de prevención de caídas y fíjelo a la altura deseada atornillando el pomo de fijación. (Fig. 16)




4. Insertar el brazo horizontal y bloquearlo con la perilla de bloqueo ① (Fig. 17).

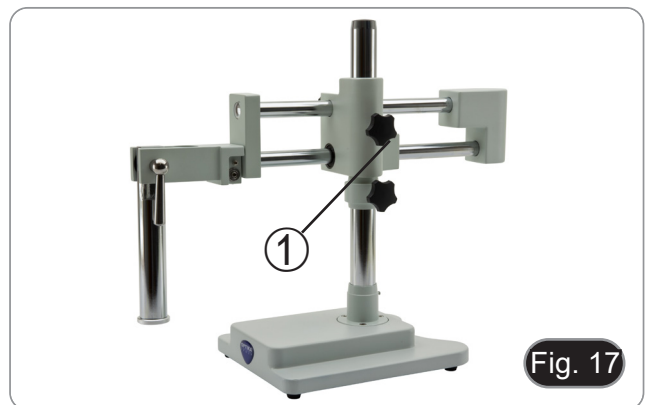

5. Para mayor seguridad, fije el tornillo de fijación ② con la llave Allen suministrada. (Fig. 18)

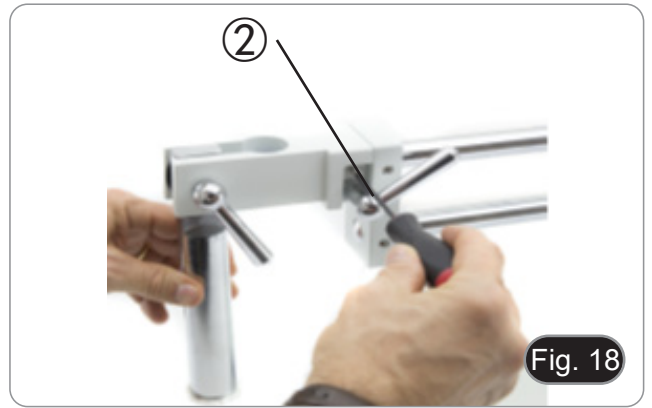

6. Instale el soporte del cabezal. Desenrosque el botón de prevención ③ e inserte el reposacabezas desde abajo en el brazo vertical. Bloquee la perilla de fijación ④. A continuación, vuelva a enroscar el botón de prevención ③. (Fig. 19-20)

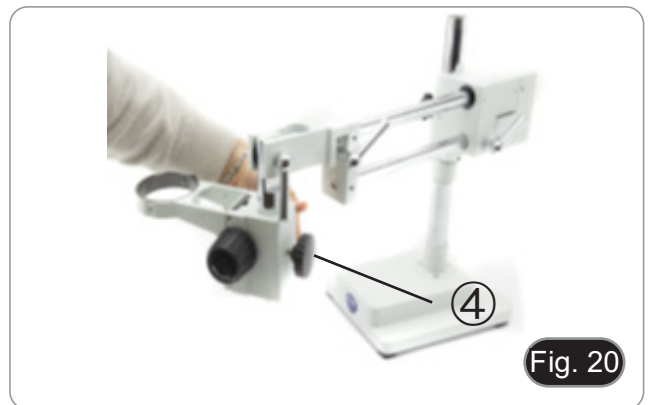

8.8 SZ-STLX

1. Atornille el pilar a la base. (Fig. 21)



2. Apriete los tornillos para bloquear el pilar. (Fig. 22)



3. Inserte el anillo de prevención de caídas y fíjelo a la altura deseada atornillando el pomo de fijación. (Fig. 23)



4. Insertar el brazo horizontal y bloquearlo con la perilla de bloque ①. (Fig. 24)





5. El soporte del cabezal se puede instalar de diferentes maneras dependiendo de las necesidades específicas del usuario.

Modo de instalación n° 1: (Fig. 25-27)

Insertar la parte trasera del soporte de la cabeza (parte redonda negra) ③ (Fig. 25) desde arriba en el orificio del brazo horizontal ④ y atornillar el pomo de prevención ② desde abajo).

- Este modo permite la instalación de cabezales pesados (o con cámaras pesadas instaladas por encima del cabezal).

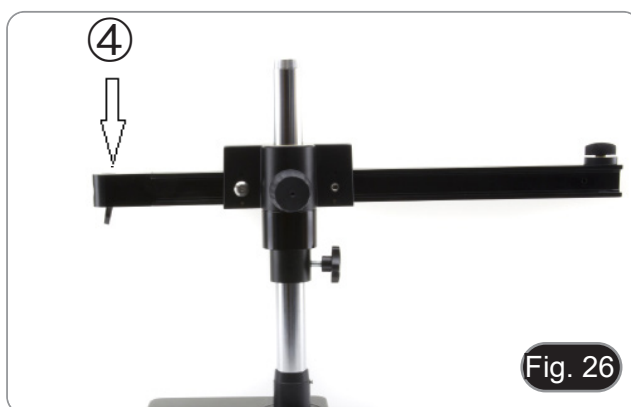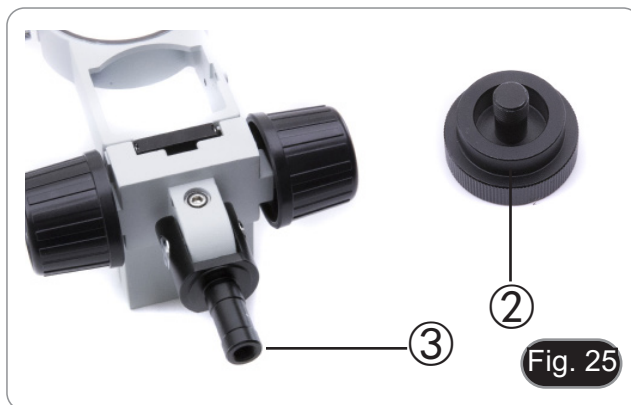

Modo de instalación n° 2: (Fig. 28-29)

Insertar la parte trasera del soporte de la cabeza (parte redonda negra) ③ (Fig. 28) desde abajo en el orificio del brazo horizontal y atornillar el pomo de prevención ② desde arriba.



- Estos dos modos permiten inclinar el cabezal. (Fig. 29)



Modo de instalación n° 3: (Fig. 30)

Insertar la parte trasera del soporte de la cabeza (parte redonda negra) ③ (Fig. 25) en el orificio del extremo del brazo horizontal y apretar el pomo ⑤.




- Este modo le permite inclinar el cabezal. (Fig. 31).



8.9 SZ-STL5 / SZ-STL5LED


1. Ajustar la altura de la pinza de mesa ① en función de la superficie de la mesa. (Fig. 32)

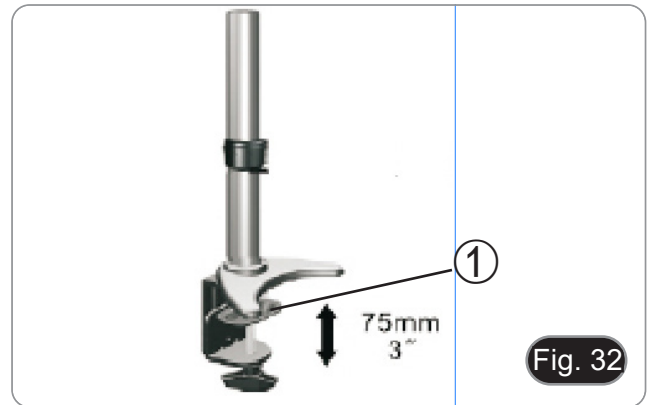


2. Fijar la pinza de mesa ① en el borde de la mesa en la posición deseada y con la abertura de la mordaza hacia el borde de la mesa (Fig. 33). Apriete el pomo ② a mano para asegurarse de que la abrazadera de la mesa está completamente sujeta a la superficie de la mesa y es segura (Fig. 34).



3. Para colocar el anillo de prevención de caída a la altura deseada, es necesario aflojar el anillo de prevención de caída como se muestra en la figura. Apriete con la mano hasta que esté firmemente en su lugar. (Fig. 35)

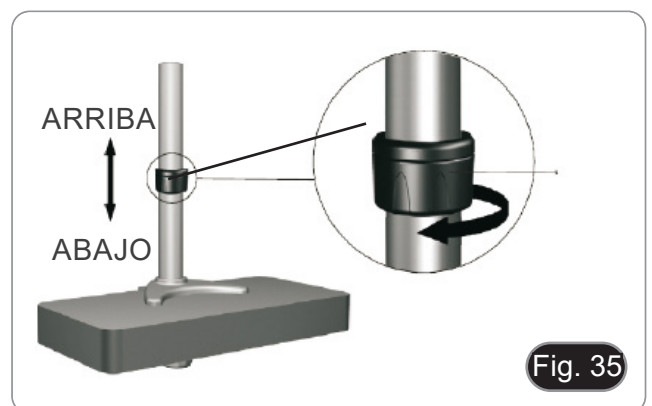

4. Monte el sistema de foco en el brazo, utilizando los tornillos y la llave Allen suministrados. (Fig. 36)

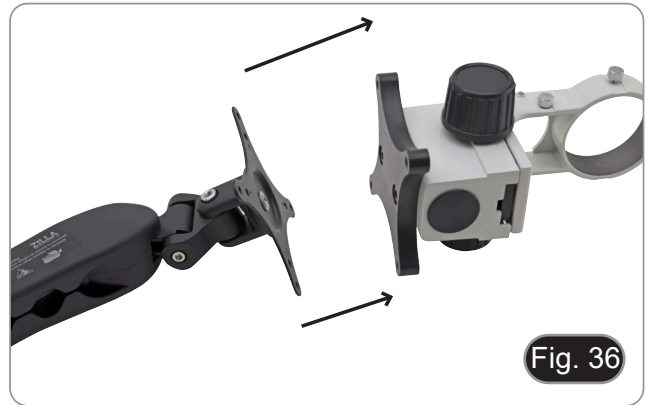

8.10 Instalar el cabezal (todos los modelos)

- Inserte la cabeza y asegure el tornillo de bloqueo. (Fig. 37)




8.11 Instalar los oculares (todos los modelos)

1. Retire las tapas de polvo del ocular e inserte los oculares en los portaoculares vacíos. (Fig. 38)
2. Fije los oculares bloqueando los tornillos de fijación ①.




8.12 Instalación de la salida foto (SZX-T/TA)

1. Afloje los tornillos de fijación ① de la salida de foto suministrada y retire la salida de foto existente. (Fig. 39)

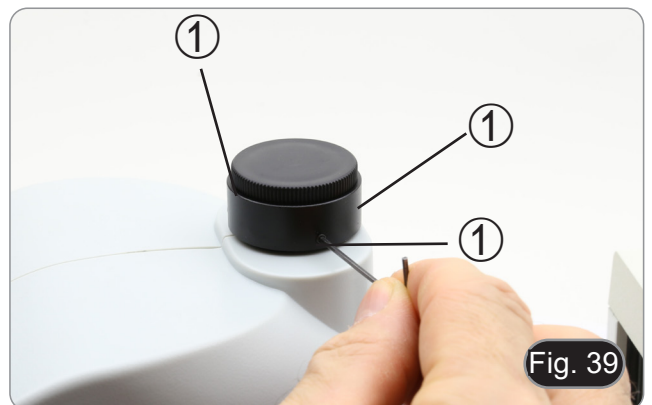


2. Inserte el anillo de la salida de foto ② asegurándose de dejar el tornillo de fijación del adaptador de foto ③ mirando hacia la derecha. (Fig. 40)
3. Apretar los tornillos de fijación ①. (Fig. 39)

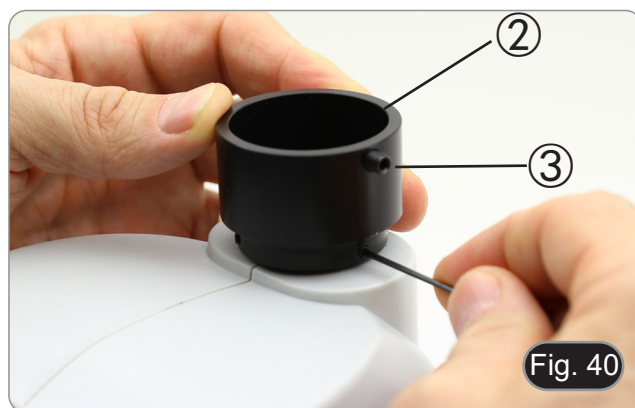

9. Uso del microscopio

9.1 Regulación de la distancia interpupilar

1. Sujete los portaoculares izquierdo y derecho con ambas manos y ajuste la distancia interpupilar moviendo los tubos hasta que sólo se observe una imagen. (Fig. 41)
- Si miras dos imágenes, la distancia es demasiado grande.
 - Si miras dos círculos superpuestos, la distancia es demasiado pequeña.

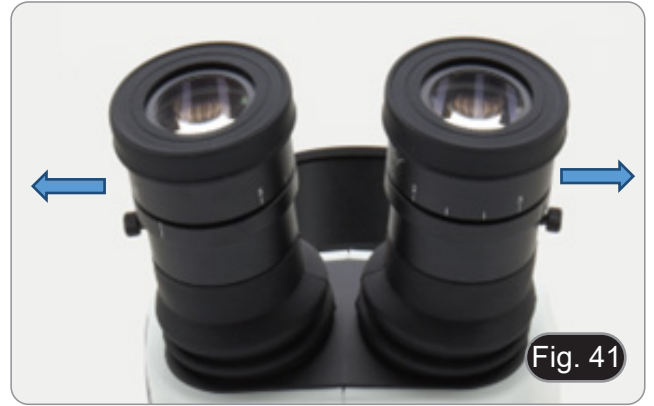

9.2 Enfoque

1. Colocar la muestra a observar en la placa y enfocar con los mandos de enfoque ①.
- Si es necesario, ajuste la altura del cuerpo del microscopio a lo largo de la columna vertical.
 - Bloquee el tornillo de bloqueo ② después de ajustar la altura. (Fig. 42)




9.3 Ajuste de la tensión de los botones de enfoque

- Este ajuste le permite aumentar o disminuir la tensión de las perillas de enfoque, evitando un descenso no deseado del microscopio bajo su propio peso. Ajuste de la tensión justo por encima del punto de estabilidad del enfoque.


9.3.1 SZ-A1

1. Agarre las perillas ③ con ambas manos y, mientras sostiene la perilla izquierda, gire la perilla derecha.
- La tensión aumenta o disminuye en función del sentido de giro del botón derecho. (Fig. 43)

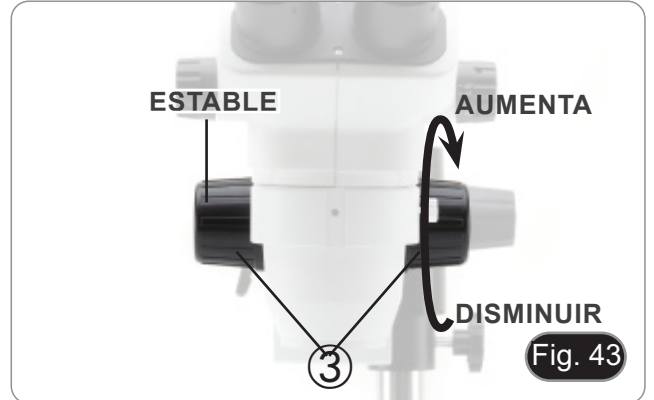


9.3.2 SZ-A6

1. Girar el anillo de ajuste ④ en el sentido de las agujas del reloj hasta que se alcance la tensión deseada.
- Si lo gira en sentido contrario a las agujas del reloj, la tensión caerá, lo que provocará una pérdida de enfoque. (Fig. 44)

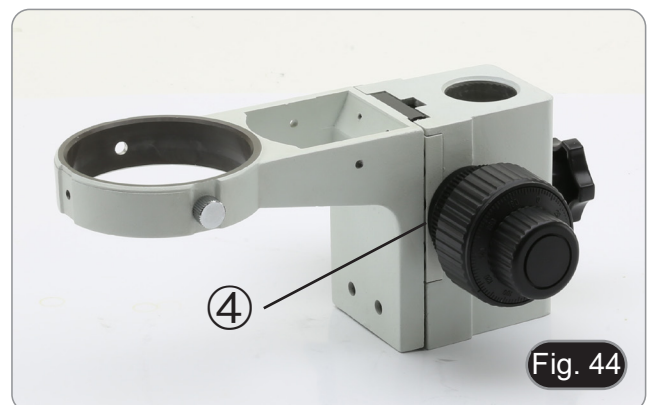

9.4 Palanca de bloqueo del enfoque (SZ-A6)

- La palanca de bloqueo sirve como función de memoria de enfoque.
1. Después de enfocar la muestra, tire de la palanca ① hacia la parte delantera del microscopio y bloquéela. (Fig. 45).
 - Esto define el punto de enfoque superior.
 2. Ahora puede mover el foco del microscopio con el botón macrométrico, reemplazar la muestra y luego llevar el sistema de nuevo al punto superior: la muestra estará aproximadamente enfocada y sólo tendrá que hacer un ajuste fino para obtener el foco óptimo.
 - El movimiento micrométrico no se ve afectado por el bloque de enfoque.
- **Para quitar el bloqueo, mueva la palanca en la dirección opuesta a la utilizada para el bloqueo.**

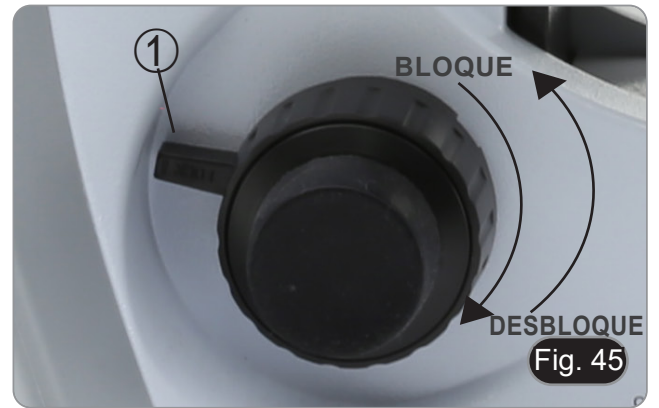

9.5 Compensación dioptrica

- **Esta compensación permite a las personas que llevan gafas ajustar el microscopio a sus ojos y utilizar el microscopio sin gafas.**
1. Ponga el zoom ② en la ampliación más baja y enfoque el espécimen con los mandos de enfoque ③. (Fig. 46)
 2. Ponga el zoom en la ampliación máxima y repita el enfoque.
 3. Volver a la ampliación más baja: el espécimen estará desenfocado.
 4. Ajuste el anillo de compensación de dioptrías del ocular derecho ④ (Fig. 47) hasta que la imagen del ocular derecho sea clara y nítida. Repita el procedimiento para el ocular izquierdo.
 5. A continuación, compruebe el enfoque de la imagen para todo el rango de zoom. Ahora debe ser perfectamente parfocal (el enfoque se mantiene siempre durante el cambio de aumento).



9.6 Aumento

1. Seleccione la ampliación deseada ajustando el mando del zoom ②. (Fig. 48)
- Cambie los oculares y/o añada una lente adicional apropiada si es necesario.
 - **Serie SZO solamente:** El cuerpo del microscopio está equipado con una función de “click stop” que permite un aumento preciso (Fig. 40). El tope de clic puede activarse o desactivarse insertando la llave Allen suministrada en el orificio situado en el lado derecho del microscopio.



9.7 Uso de lentes adicionales

1. Atornille la lente adicional deseada en el cuerpo del microscopio. (Fig. 49)
- Cada lente adicional tiene una distancia de trabajo específica.
 - La carrera del adaptador de enfoque no podía compensar las diferentes distancias de trabajo de los distintos objetivos adicionales.
 - En caso de que el soporte de enfoque no pueda enfocar la muestra, se debe elevar o bajar todo el cuerpo del microscopio.

La ampliación total utilizada se puede calcular como:
Ampliación del ocular * Ampliación del zoom * Ampliación del objetivo.



Serie SZX (0.67x - 4.5x / F.N. 22 mm)

Ocular	10x		15x		20x		25x	
Número de campo (mm)	22		16		12		9	
Objetivo	Aum. Total	Campo visual (mm)	Aum. Total	Campo visual (mm)	Aum. Total	Campo visual (mm)	Aum. Total	Campo visual (mm)
0.3X	2.01X-13.5X	109.45-16.30	3.02X-20.25X	79.60-11.85	4.02X-27X	59.70-8.89	5.03X-33.75X	44.78-6.67
0.5X	3.35X-22.5X	65.67-9.78	5.03X-33.75X	47.76-7.11	6.7X-45X	35.8-5.33	8.38X-56.25X	26.87-4.00
0.75X	5.03X-33.75X	43.78-6.52	7.54X-50.63X	31.84-4.74	10.05X-67.5X	23.88-3.56	12.56X-84.37X	17.91-2.67
1X	6.7X-45X	32.84-4.89	10.05X-67.5X	23.88-3.56	13.4X-90X	17.91-2.67	16.75X-112.5X	13.43-2.00
1.5X	10.05X-67.5X	21.89-3.26	15.08X-101.25X	15.92-2.37	20.1X-135X	11.94-1.78	25.13X-168.75X	8.96-1.33
2X	13.4X-90X	16.42-2.44	20.1X-135X	11.94-1.78	26.8X-180X	8.96-1.33	33.5X-225X	6.72-1.00

Serie SZX-A (0.65x - 5.5x / F.N. 23 mm)

Ocular	10x		15x		20x		25x	
Número de campo (mm)	23		16		12		9	
Objetivo	Aum. Total	Campo visual (mm)	Aum. Total	Campo visual (mm)	Aum. Total	Campo visual (mm)	Aum. Total	Campo visual (mm)
0.3X	1.95X-16.5X	117.95-13.94	2.93X-24.75X	82.05-9.70	3.9X-33X	61.54-7.27	4.88x-41.25x	46.15-5.45
0.5X	3.25X-27.5X	70.77-8.36	4.88X-41.25X	49.23-5.82	6.5X-55X	36.92-4.36	8.13x-68.75X	27.69-3.27
0.75X	4.88X-41.25X	47.18-5.58	7.31X-61.88X	32.82-3.88	9.75X-82.5X	24.62-2.91	12.19x-103.13X	18.46-2.18
1X	6.5X-55X	35.38-4.18	9.75X-82.5X	24.62-2.91	13X-110X	18.46-2.18	16.25X-137.5X	13.85-1.64
1.5X	9.75X-82.5X	23.59-2.79	14.63X-123.75X	16.41-1.94	19.5X-165X	12.31-1.45	24.38X-206.25X	9.23-1.09
2X	13X-110X	17.69-2.09	19.5X-165X	12.31-1.45	26X-220X	9.23-1.09	32.5X-275X	6.92-0.82

Serie SZO (0.67x - 4.5x / F.N. 23 mm)

Ocular	10x		15x		20x		25x	
Número de campo (mm)	23		16		12		9	
Objetivo	Aum. Total	Campo visual (mm)	Aum. Total	Campo visual (mm)	Aum. Total	Campo visual (mm)	Aum. Total	Campo visual (mm)
0.3X	2.01X-13.5X	114.43-17.04	3.02X-20.25X	79.60-11.85	4.02X-27X	59.70-8.89	5.03X-33.75X	44.78-6.67
0.5X	3.35X-22.5X	68.66-10.22	5.03X-33.75X	47.76-7.11	6.7X-45X	35.82-5.33	8.38X-56.25X	26.87-4.00
0.75X	5.03X-33.75X	45.77-6.81	7.54X-50.63X	31.84-4.74	10.05X-67.5X	23.88-3.56	12.56X-84.38X	17.91-2.67
1X	6.7X-45X	34.33-5.11	10.05X-67.5X	23.88-3.56	13.4X-90X	17.91-2.67	16.75X-112.5X	13.43-2.00
1.5X	10.05X-67.5X	22.89-3.41	15.08X-101.25X	15.92-2.37	20.1X-135X	11.94-1.78	25.13X-168.75X	8.96-1.33
2X	13.4X-90X	17.16-2.56	20.1X-135X	11.94-1.78	26.8X-180X	8.96-1.33	33.5X-225X	6.72-1.00

9.8 Uso de lentes adicionales 0.3X-0.5X

Los objetivos adicionales 0.3X y 0.5X tienen una gran distancia de trabajo y, por lo tanto, la carrera total de la columna de enfoque no puede compensarse.

Para que los objetivos adicionales 0.3X y 0.5X funcionen correctamente, proceda de la siguiente manera:

1. Atornille la lente adicional como se describe en el apartado 9.7.
2. Quitar el cuerpo del microscopio del soporte.
3. Instale el espaciador ① en el soporte de cabeza y apriete el tornillo de fijación ②. (Fig. 50)
4. Vuelva a montar el cuerpo del microscopio en el espaciador y apriete el tornillo de fijación ③. (Fig. 51)
5. Empiece a trabajar normalmente.




9.9 Placa blanco/negro (SZ-ST1 / 2 / 3 / 7 / 8)

- Puede utilizar un disco de contraste de blanco/negro para aumentar el contraste de la imagen cuando trabaje con luz incidente.
1. Retire el disco opalino transparente utilizado en la luz transmitida.
 2. Inserte el disco blanco/negro con el lado deseado hacia arriba. (Fig. 52)
- Si se observan muestras claras, coloque el disco con la parte negra hacia arriba.



9.10 Uso de la iluminación (SZ-ST2 / 3 / 7 / 8)

1. Gire la perilla de luz transmitida ② para encender/apagar o para cambiar la intensidad del LED de luz transmitida. (Fig. 53)
 2. Gire la perilla de luz incidente ① para encender/apagar o para cambiar la intensidad del LED de luz incidente.
- Es posible utilizar ambas iluminaciones al mismo tiempo.

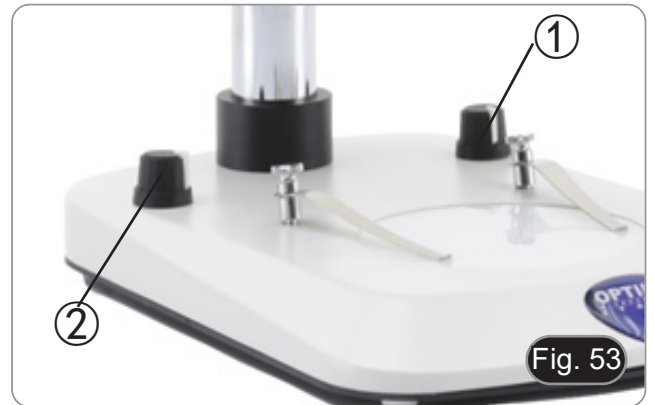

Sólo para SZ-ST7 / SZ-ST8:

- Inclinar y posicionar los brazos autoportantes de la base ③ para iluminar la muestra de forma óptima. (Fig. 54)
- Los brazos se pueden colocar individualmente en la posición deseada.



9.11 Uso de la iluminación (SZ-OBL)

1. Girar la perilla de luz transmitida ① para encender/apagar o para cambiar la intensidad del LED de luz transmitida. (Fig. 55)
 2. Girar el mando de rotación del espejo ② para inclinar el espejo hasta obtener la iluminación oblicua deseada.
- El espejo tiene una superficie lisa y otra moleteada. Las dos superficies permiten optimizar la observación proporcionando un contraste adecuado en función de la muestra a observar.



9.12 Uso de protectores de goma (SZO-B / T)

• Uso con gafas

Doble hacia atrás los protectores oculares de goma con ambas manos. Los protectores oculares plegados evitan arañar las lentes de las gafas. (Fig. 56)



- **Uso sin gafas**

Levante los protectores oculares y observe en el microscopio colocando los ojos lo más cerca posible sobre los oculares, evitando que penetre luz externa. (Fig. 57)



9.13 Uso de bases en voladizo

9.13.1 SZ-STL1

Mover el brazo horizontal

1. Afloje las perillas del lado derecho del brazo horizontal ①. (Fig. 58)
2. El brazo puede ser extendido o acortado de acuerdo a las necesidades específicas. (Fig. 59)




Cambiar el ángulo del cabezal

1. Afloje los tornillos ① y gire la cabeza al ángulo deseado (derecha o izquierda), luego apriete el tornillo de fijación. (Fig. 60)



Girar el brazo horizontal


1. Afloje el tornillo de fijación del brazo horizontal ② y gire el brazo, luego apriete el tornillo de fijación. (Fig. 61)
- **NOTA:** Girar el microscopio 180° desde la base puede causar que todo el sistema se vuelque.

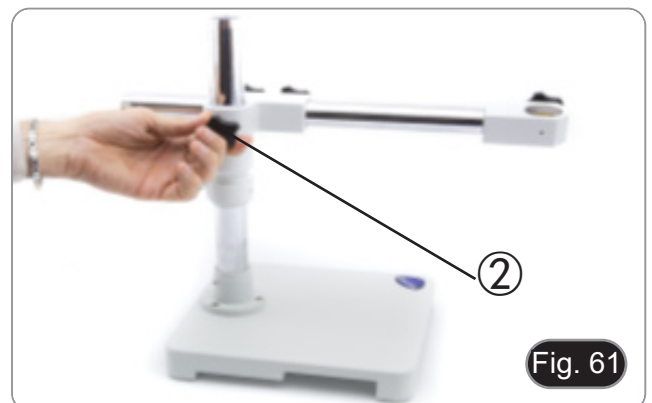

9.13.2 SZ-STL2

Mover el brazo horizontal

1. Afloje la perilla del lado izquierdo del brazo horizontal ①. (Fig. 62)

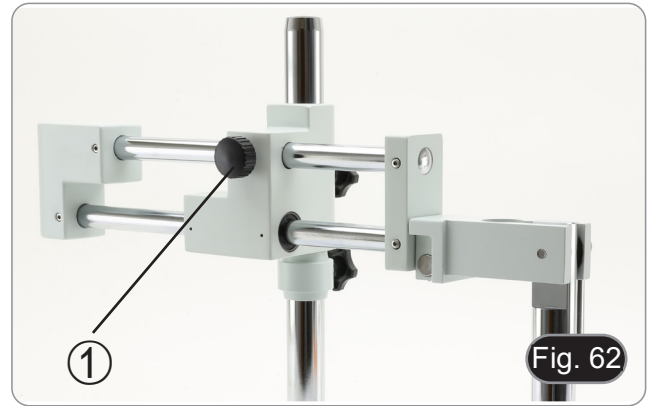

2. El brazo puede ser extendido o acortado de acuerdo a las necesidades específica. (Fig. 63)




Inclinar el soporte de la cabeza

1. Aflojar el botón ② (Fig. 64) en el lado derecho del soporte. El brazo basculante vertical se puede mover. Una vez alcanzado el ángulo deseado, apriete el mando.



Cambiar el ángulo del cabezal

1. Afloje el tornillo de fijación ③ y gire la cabeza al ángulo deseado (derecha o izquierda), luego apriete el tornillo de fijación. (Fig. 65-66)

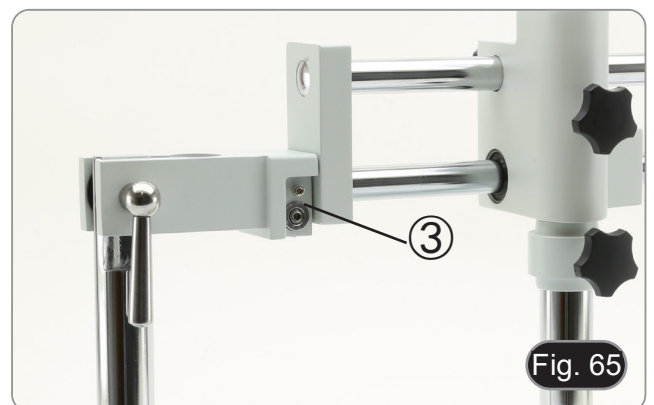



Girar el brazo horizontal


1. Afloje el tornillo de fijación del brazo horizontal ④ y gire el brazo, luego apriete el tornillo de fijación. (Fig. 67)
- **NOTA:** Girar el microscopio 180° desde la base puede causar que todo el sistema se vuelque.



9.13.3 SZ-STLX

Mover el brazo horizontal

1. Afloje las perillas del lado derecho del brazo horizontal ①. (Fig. 68)

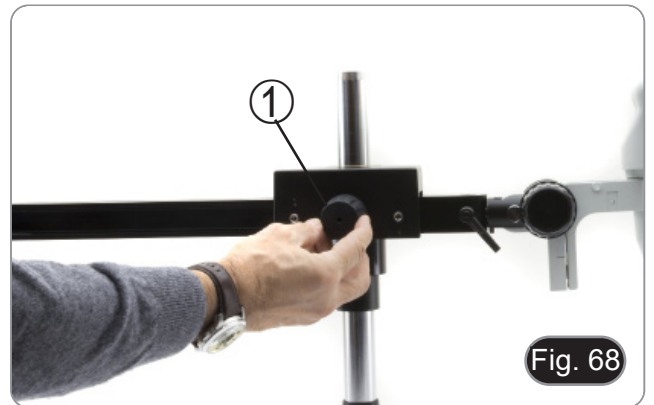


2. El brazo puede ser extendido o acortado de acuerdo a las necesidades específica. (Fig. 69)



Ajuste del bloque horizontal

1. Desbloquee la perilla de fijación de la cerradura ② y muévala a una posición adecuada para las necesidades del usuario. (Fig. 70)
2. Bloquear el pomo de fijación para ajustar el límite de movimiento.

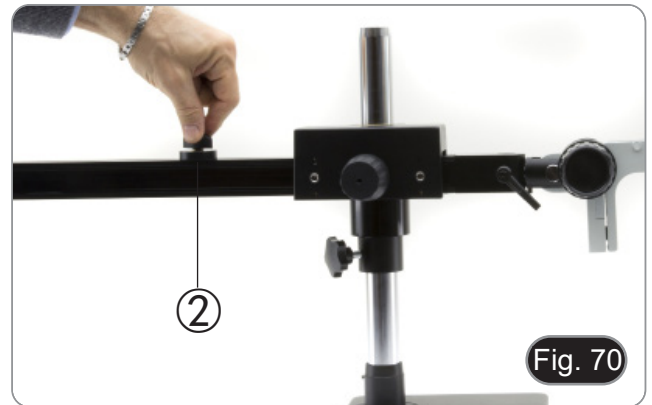

Inclinar el soporte de la cabeza

1. Aflojar el tornillo de cabeza cilíndrica ③ (Fig. 71) en la parte superior del soporte de cabeza.
2. La parte negra se puede mover. Una vez alcanzado el ángulo deseado, vuelva a apretar el tornillo.



Cambiar el ángulo del cabezal

1. Desbloquee el pomo de fijación ④ y gire el cabezal hasta el ángulo de giro deseado (izquierda o derecha), luego vuelva a apretar el pomo. (Fig. 72-73)



Girar el brazo horizontal


1. Afloje la perilla de fijación del brazo horizontal ⑤ y gire el brazo, luego vuelva a apretar la perilla. (Fig. 74)
- **NOTA:** Girar el microscopio 180° desde la base puede causar que todo el sistema se vuelque.




9.13.4 SZ-STL5 / SZ-STL5LED

Ajuste de la tensión del brazo



- Este instrumento ha sido desarrollado para poder ajustar la resistencia a la inclinación del brazo tanto lateralmente como de arriba hacia abajo, con una amplitud máxima de movimiento de 90 grados en ambas direcciones. Es posible controlar el nivel de resistencia de la articulación del brazo.
1. Si la junta del soporte de pared tiende a caer automáticamente, es posible que tenga que ajustar su tensión para que el microscopio vuelva a la posición deseada aprovechando la oscilación hacia arriba o hacia abajo. Esto se puede hacer usando la llave Allen de 6 mm para aumentar la resistencia de la junta y fijar la posición, ajustar el tornillo de tensión con la cabeza hexagonal M5x15mm colocada en los lados de la junta usando la llave Allen de 6 mm. (Fig. 75)

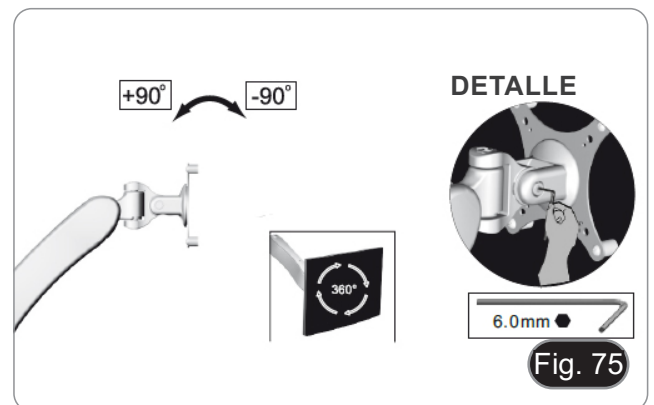

2. Para aumentar o disminuir la resistencia de la articulación giratoria y permitir que el microscopio gire lateralmente, ajuste el tornillo de tensión hexagonal situado en la parte delantera de la articulación del brazo para asegurar la posición. (Fig. 76)
3. Para aumentar la resistencia, apriete el tornillo de tensión hexagonal M5x15mm con la llave hexagonal de 4 mm en sentido horario. Para disminuir la resistencia, afloje el tornillo de tensión con la llave de vaso hexagonal suministrada, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

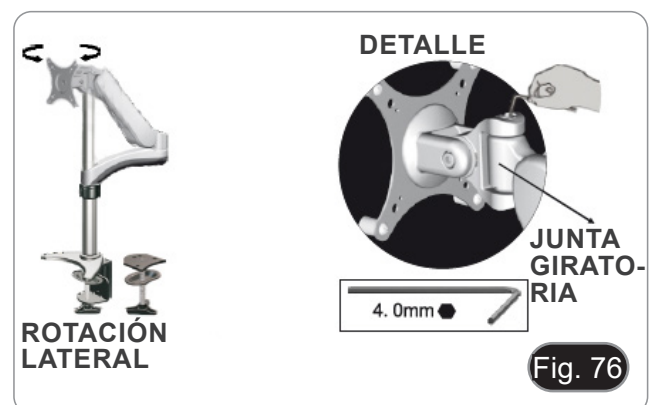

4. El instrumento puede subir o bajar como se muestra. (Fig. 77).
- Si automáticamente tiende a moverse lateralmente, es posible que deba ajustar la tensión de la articulación del brazo para permitir que el microscopio gire lateralmente. Esto es posible utilizando la llave Allen de 2,5 mm suministrada. (Fig. 78)

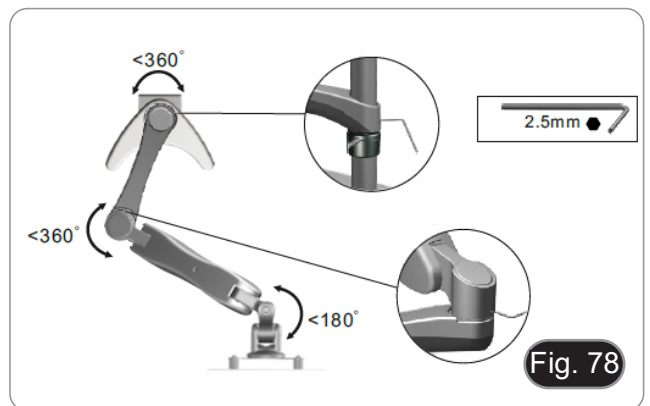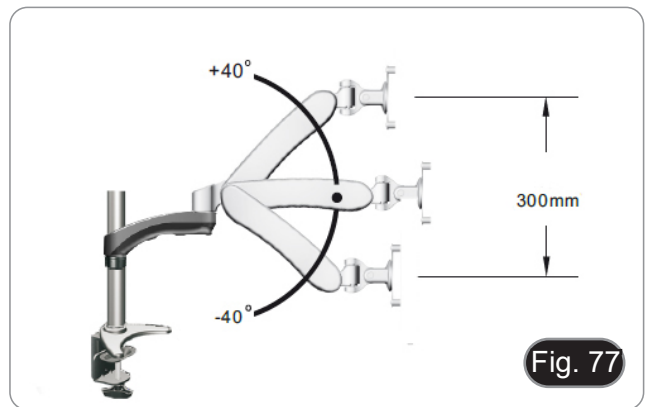

Ajuste del brillo


Gire los mandos de ajuste de la intensidad de la luz ① para encender/apagar y para aumentar/disminuir la intensidad de la luz de cada brazo LED individual. (Fig. 79)



10. Microfotografía

10.1 Uso de cámaras de paso "C"

1. Aflojar el tornillo ① del tubo trinocular y quitar la tapa negra ②. (Fig. 80)

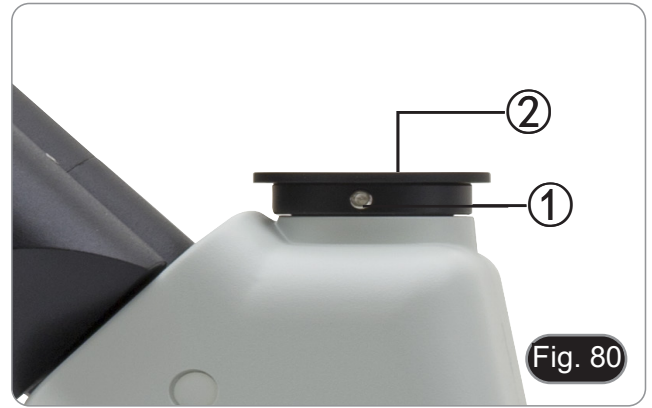

2. Colocar el adaptador paso C a la cámara ④ e insertar el conjunto sobre el puerto trinocular, luego sujetarlo con el tornillo para que no se caiga ①. (Fig. 81)



10.2 Uso de cámara Reflex

1. Insertar el adaptador de la cámara Reflex ① al tubo del microscopio ②.
2. Atornillar el aro "T2" ③ (no lo suministrada) al cuerpo de la cámara Reflex.
3. Conectar la cámara al aro "T2" ④ (Fig. 82).
4. Montar el extremo del tubo de conexión ② en el orificio vacío del tubo trinocular y apretar el tornillo de apriete. (Fig. 80)
 - El aro "T2" no se suministra con el microscopio pero se encuentra fácilmente en una tienda de fotografía.
 - Mientras toma muestras oscuras, tapar los oculares y el visor con un paño oscuro para minimizar la luz difusa.
 - Para calcular la ampliación de la cámara: aumento objetivo * aumento de la cámara * aumento de la lente.
 - **Si usa una cámara SLR, el movimiento al apretar el botón para tomar una foto puede hacer que la cámara vibre.**
 - **Sugerimos utilizar la opción de extensión del tiempo de exposición y un cable remoto.**



11. Mantenimiento

Ambiente de trabajo

Se aconseja utilizar este microscopio en un ambiente limpio y seco; también se deben evitar los impactos. La temperatura de trabajo recomendada es de 0-40°C y la humedad relativa máxima es de 85 % (en ausencia de condensación). Si es necesario, utilizar un deshumidificador.

Consejos antes y después de la utilización del microscopio



- Durante los desplazamientos, mantener el microscopio en posición vertical y prestar mucha atención para evitar que se caigan los accesorios móviles, por ejemplo, los oculares.
- Manejar con cuidado el microscopio evitando usar una fuerza mayor de la necesaria.
- Evitar reparar el microscopio por su cuenta.
- Apagar la luz inmediatamente después de haber utilizado el microscopio, cubrirlo con su correspondiente funda antipolvo y mantenerlo en un ambiente limpio y seco.

Precauciones de seguridad relativas al sistema eléctrico



- Antes de conectar el microscopio a la toma de corriente, asegurarse que la tensión de entrada del lugar donde se usa coincide con la tensión de utilización del microscopio y que el interruptor del iluminador esté en la posición off.
- El usuario debe consultar las normas de seguridad de su país.
- El instrumento está dotado de una etiqueta de seguridad CE. No obstante estas pautas, el usuario debería utilizar el microscopio en función de sus necesidades pero con un mínimo de responsabilidad y seguridad.

Limpieza de la ópticas

- Si es necesario limpiar los componentes ópticos utilizar, en primer lugar, aire comprimido.
- Si no es suficiente, limpiar las ópticas con un paño, que no esté deshilachado, humedecido en agua y detergente neutro.
- Si todavía no es suficiente, humedecer un paño con una mezcla de 3 partes de etanol y 7 partes de éter.
- **Importante: el etanol y el éter son líquidos altamente inflamables. No se deben utilizar cercanos a una fuente de calor, chispas o instrumentación eléctrica. Utilizar en un ambiente bien aireado.**
- No frotar la superficie de ningún componente óptico con la manos. Las huellas digitales pueden dañar las ópticas.
- No desmontar los objetivos o los oculares para intentar limpiarlos.

Para obtener mejores resultados, utilice el kit de limpieza OPTIKA (véase el catálogo).

Si fuera necesario, enviar el microscopio a la empresa Optika para su mantenimiento se ruega utilizar el embalaje original.

12. Guía de solución de problemas

Revisar la información en la tabla a continuación para solucionar problemas de funcionamiento.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
I. Sección Óptica:		
El iluminador está encendido, pero el campo visible está oscuro	El enchufe no está conectado al sistema de iluminación	Conectar
	La luminosidad es demasiado baja	Regular la luminosidad
El borde del campo visible se ha difuminado o a luminosidad es asimétrica	El iluminador de luz incidente no está orientado correctamente	Cambiar el ángulo del iluminador incidente
En el campo visible se ve polvo y manchas	Hay polvo y/o manchas en la preparación	Limpiar el preparado
	Hay polvo y/o manchas en el ocular	Limpiar el ocular
La calidad de las imágenes es insuficiente: <ul style="list-style-type: none"> • La imagen no es nítida; • No hay un buen contraste; • Los detalles no son nítidos • Reflejos en la imagen 	Los lentes (objetivos, oculares) están sucios	Limpiar todos los componentes ópticos a fondo
Un lado de la imagen no está enfocado	El preparado no está en la posición correcta (ej. inclinado)	Situar el preparado horizontal al plano
II. Sección Mecánica:		
El mando macrométrico gira con dificultad	El anillo de regulación de la tensión está demasiado cerrado	Aflojar el anillo de regulación de la tensión
El enfoque es inestable	El anillo de regulación de la tensión está demasiado flojo	Apretar el anillo de regulación de la tensión
III. Sección Eléctrica:		
El LED no se enciende	El instrumento no tiene alimentación	Verificar la conexión del cable de alimentación
La luminosidad es insuficiente	La luminosidad posee una baja regulación	Ajuste el brillo
La luz parpadea	El cable de alimentación no está conectado correctamente	Verificar la conexión del cable
IV. Montaje de los oculares:		
El campo visible es diverso en cada ojo	La distancia interpupilar no es correcta	Regular la distancia interpupilar
	La compensación dioptrica no es correcta	Regular la compensación dioptrica
	La técnica de observación no es correcta y el usuario está forzando la vista.	Cuando se mira en el objetivo, no fijar el preparado pero mirar todo el campo visible. A intervalos regulares alejar los ojos del objetivo y mirar desde lejos para relajar la vista
V. Microfotografía y adquisición de videos:		
El borde de la imagen no está enfocado	En un cierto grado esto es innato a la naturaleza de los objetivos acromáticos	Para reducir el problema al mínimo, regular el diafragma de apertura en la posición correcta
En la imagen aparecen manchas claras	En el microscopio entra luz difusa a través de los oculares o a través de la mira de la cámara fotográfica/telecámara	Cubrir los oculares y la mira con un paño oscuro

Medidas ecológicas y reciclaje

De conformidad con el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 151, de 25 de julio de 2005. "Aplicación de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE sobre la reducción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y la eliminación de residuos.



El símbolo del envase en el aparato o en su embalaje indica que el producto debe ser recogido separadamente de otros residuos al final de su vida útil. La recogida selectiva de estos equipos al final de su vida útil es organizada y gestionada por el fabricante. Por lo tanto, el usuario que desee deshacerse de este equipo debe ponerse en contacto con el fabricante y seguir el sistema que ha adoptado para permitir la recogida selectiva del equipo al final de su vida útil. La recogida selectiva adecuada para el posterior reciclado, tratamiento y eliminación de los equipos desechados de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y promueve la reutilización y/o el reciclado de los materiales que componen el equipo. La eliminación ilegal del producto por parte del propietario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas previstas en la legislación vigente.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain

spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA

usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China

china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® India

india@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Central America

camerica@optikamicroscopes.com

Série SZ

MANUEL D'UTILISATION

Modèle	
SZ-A1	SZ-A6
SZX-B	SZX-T
SZX-BA	SZX-TA
SZO-B	SZO-T
SZ-ST1	SZ-ST2
SZ-ST3	SZ-ST7
SZ-ST8	SZ-OBL
ST-150	ST-152
SZ-STL1	SZ-STL2
SZ-STLX	SZ-STL5
SZ-STL5LED	

Ver. 2.3 2022



Sommaire

1.	Avertissement	160
2.	Précautions	160
3.	Contenu de l'emballage	161
3.1	SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA	161
3.2	SZO-B / SZO-T	162
3.3	SZ-A1	162
3.4	SZ-A6	163
3.5	ST-150	163
3.6	ST-152	164
3.7	SZ-ST1	164
3.8	SZ-ST2 / SZ-ST3	165
3.9	SZ-ST7 / SZ-ST8	165
3.10	SZ-OBL	166
3.11	SZ-STL1	166
3.12	SZ-STL2	167
3.13	SZ-STLX	167
3.14	SZ-STL5	168
3.15	SZ-STL5LED	169
4.	Déballage	170
5.	Emploi prévu	170
6.	Symboles	170
7.	Description de l'instrument	171
7.1	Diagramme de Système	171
7.2	SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA	172
7.3	SZO-B / SZO-T	172
7.4	SZ-A1	173
7.5	SZ-A6	173
7.6	ST-150	174
7.7	ST-152	174
7.8	SZ-ST1	175
7.9	SZ-ST2 / SZ-ST3	175
7.10	SZ-ST7 / SZ-ST8	176
7.11	SZ-OBL	176
7.12	SZ-STL1	177
7.13	SZ-STL2	177
7.14	SZ-STLX	178
7.15	SZ-STL5	178
7.16	SZ-STL5LED	179
8.	Assemblage	180
8.1	SZ-A1 / SZ-A6	180
8.2	SZ-ST1 / ST-150	180
8.3	ST-152	180
8.4	SZ-ST2 / SZ-ST3	180
8.5	SZ-ST7 / SZ-ST8 / SZ-OBL	181
8.6	SZ-STL1	181
8.7	SZ-STL2	184
8.8	SZ-STLX	186
8.9	SZ-STL5 / SZ-STL5LED	189
8.10	Installer la tête (tous les modèles)	190
8.11	Installer les oculaires (tous les modèles)	190
8.12	Installer la sortie photo (SZX-T / TA)	190
9.	Utilisation du microscope	192
9.1	Ajuster la distance interpupillaire	192
9.2	Mise au point	192
9.3	Réglage de la tension des boutons de mise au point	192
9.3.1	SZ-A1	192
9.3.2	SZ-A6	192
9.4	Levier de verrouillage de la mise au point (SZ-A6)	193
9.5	Compensation dioptrique	193
9.6	Grossissement	194
9.7	Utilisation d'un objectif supplémentaire	194
9.8	Utilisation d'un objectif supplémentaire 0.3X-0.5X	195

9.9	Plaque noir/blanc (SZ-ST1 / 2 / 3 / 7 / 8)	195
9.10	Utilisation de l'illumination (SZ-ST2 / 3 / 7 / 8)	196
9.11	Utilisation de l'illumination (SZ-OBL)	196
9.12	Utilisation des Œillères en caoutchouc (SZO-B / T)	196
9.12	Utilisation d'une base en surplomb	198
9.12.1	SZ-STL1	198
9.12.2	SZ-STL2	199
9.12.3	SZ-STLX	200
9.12.4	SZ-STL5 / SZ-STL5LED	202
10.	Microphotographie	204
10.1	Utilisation des caméras avec monture "C"	204
10.2	Utilisation des caméras Reflex	204
11.	Réparation et entretien	205
12.	Guide résolution des problèmes	206
	Ramassage	207

1. Avertissement

Le présent microscope est un appareil scientifique de précision créé pour offrir une durée de vie de plusieurs années avec un niveau d'entretien minimum. Les meilleurs composants optiques et mécaniques ont été utilisés pour sa conception ce qui fond de lui un appareil idéal pour une utilisation journalière.

Ce guide contient des informations importantes sur la sécurité et l'entretien du produit et par conséquent il doit être accessible à tous ceux qui utilisent cet instrument.

Nous déclinons toute responsabilité quant à des utilisations de l'instrument non conformes au présent manuel.

2. Précautions



Éviter choc électrique

Avant de connecter le câble d'alimentation au réseau électrique assurez vous que la tension d'entrée soit compatible avec celle de l'appareil et que l'interrupteur de l'éclairage soit en position arrêt. L'utilisateur devra consulter les normes de sécurité de son pays. L'appareil inclut une étiquette de sécurité C.E. Dans tous les cas, l'utilisateur assume toute responsabilité relative à l'utilisation sûre de l'appareil. Suivre les directives ci-dessous et lire ce manuel dans son intégralité pour un fonctionnement sûr de l'instrument.

3. Contenu de l'emballage

3.1 SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA



① Corps du microscope

• SZX-B/BA Binoculaire / SZX-T/TA Trinoculaire

② Oculaires

③ Clés Allen (seulement SZX-T/TA)

④ Housse de protection

⑤ Bague de sortie photo (seulement SZX-T/TA)

3.2 SZO-B / SZO-T



① Corps du microscope


• SZO-B Binoculaire / SZO-T Trinoculaire

② Oculaires

③ Clés Allen (seulement SZX-T/TA)


④ Housse de protection

3.3 SZ-A1

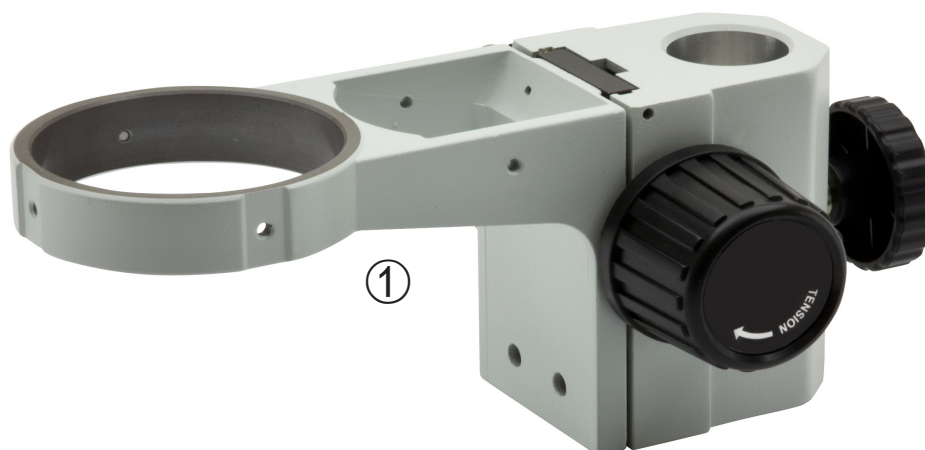


① Mise au point macro

3.4 SZ-A6

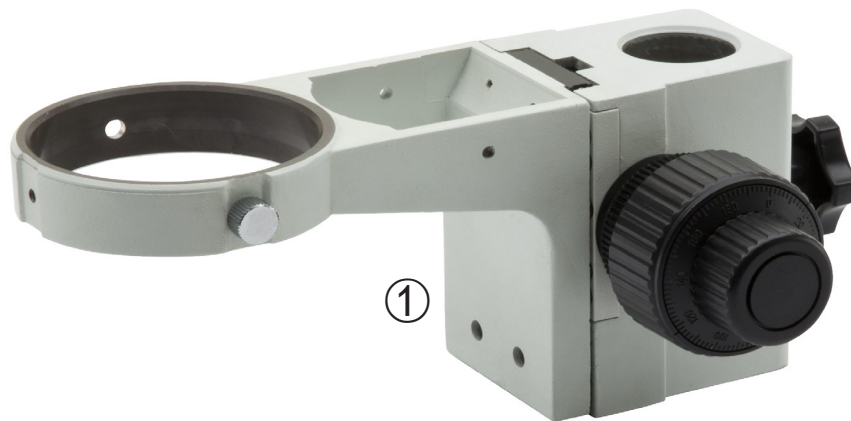

① Mise au point macro/micro

3.5 ST-150

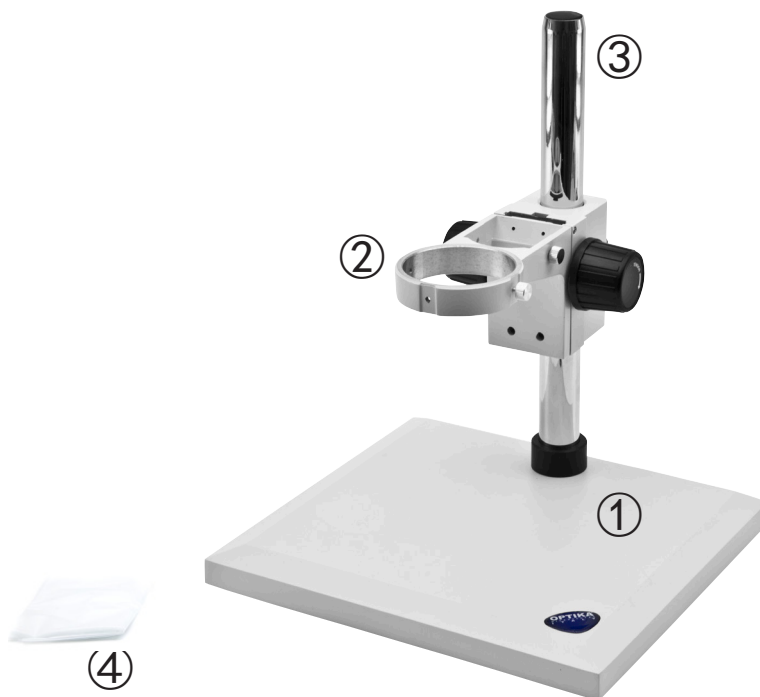


① Base

② Support de tête / système de mise au point

③ Pilier

④ Housse de protection

3.6 ST-152

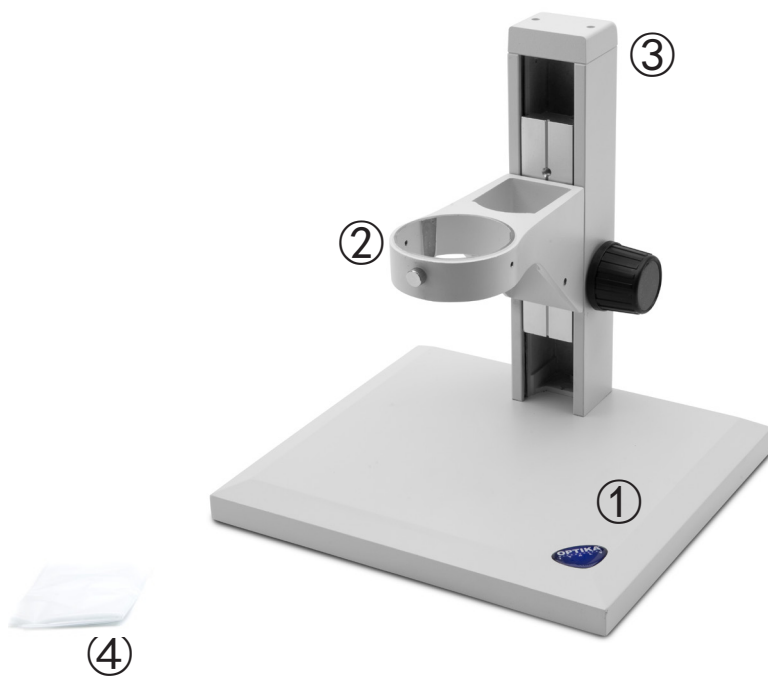

- ① Base
- ② Support de tête / système de mise au point
- ③ Pilier
- ④ Housse de protection

3.7 SZ-ST1



- ① Base
- ② Clips de échantillon (un couple)
- ③ Disque blanc / noir

3.8 SZ-ST2 / SZ-ST3



- ① Base
- ② Disque opaline
- ③ Clips de échantillon (un couple)
- ④ Illuminateur de lumière incidente
- ⑤ Disque blanc / noir
- ⑥ Alimentation électrique

3.9 SZ-ST7 / SZ-ST8




- ① Base
- ② Disque opaline
- ③ Clips de échantillon (un couple)
- ④ Disque blanc / noir
- ⑤ Alimentation électrique

3.10 SZ-OBL




- ① Base
- ② Pilier
- ③ Plaque en verre
- ④ Alimentation
- ⑤ Housse de protection

3.11 SZ-STL1

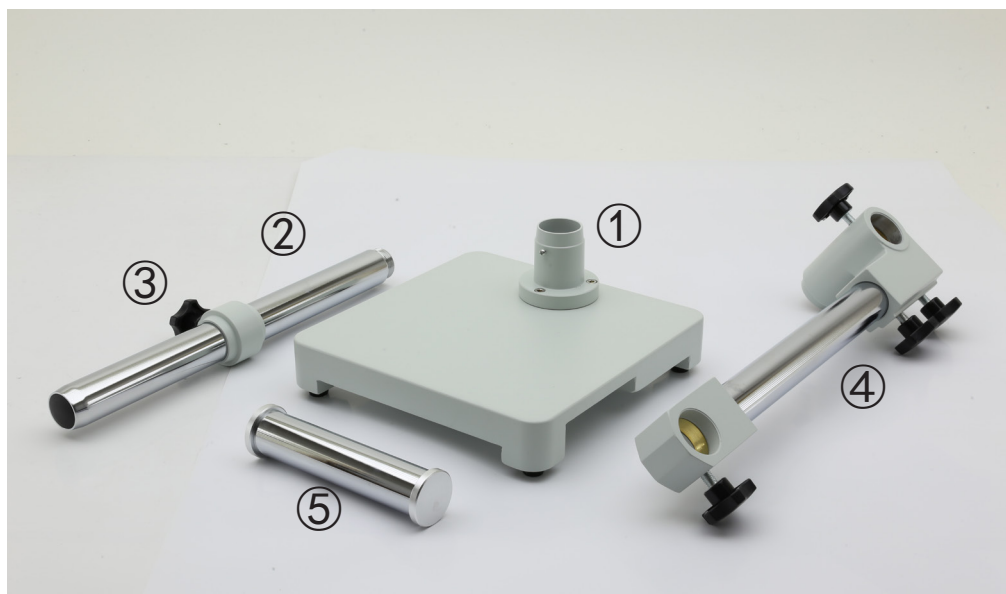

- ① Base
- ② Pilier
- ③ Anneau de prévention de descente
- ④ Bras horizontal
- ⑤ Bras de support du mise au point

3.12 SZ-STL2

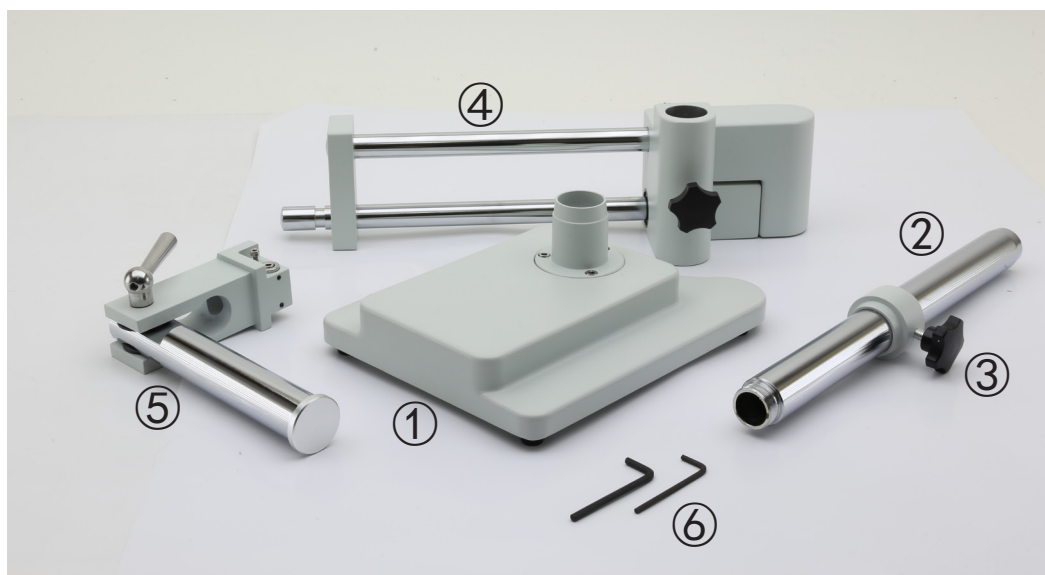


- ① Base
- ② Pilier
- ③ Anneau de prévention de descente
- ④ Bras horizontal
- ⑤ Bras de support du mise au point
- ⑥ Clés Allen

3.13 SZ-STLX





- ① Base
- ② Pilier
- ③ Bras horizontal
- ④ Anneau de prévention de descente
- ⑤ Mise au point
- ⑥ Clés Allen

3.14 SZ-STL5

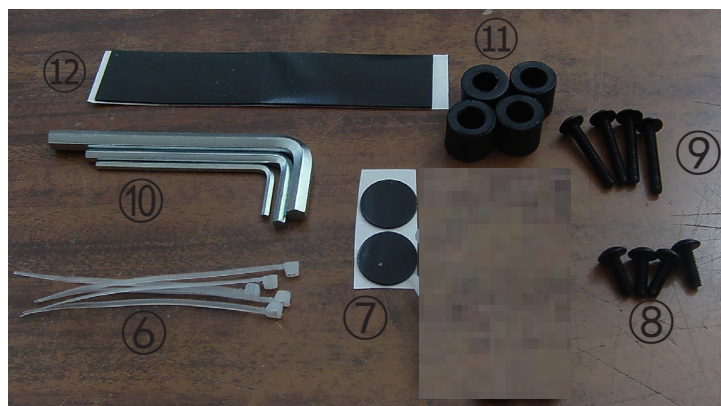

- ① Pince de table
- ② Pilier
- ③ Bague anti-chute
- ④ Bras horizontal
- ⑤ Support de tête / système de mise au point
- ⑥ Serre-câbles
- ⑦ Joint rond
- ⑧ Vis courtes M4x12 mm (4 pièces)
- ⑨ Vis longues M4x25 mm (4 pièces)
- ⑩ Clés Allen
- ⑪ Pieds en caoutchouc (4 pièces)
- ⑫ Joint rectangulaire
- ⑬ Pince de table pour grandes épaisseurs

3.15 SZ-STL5LED

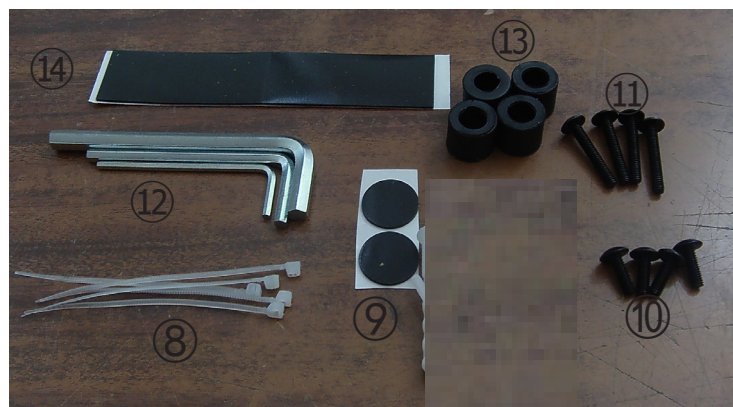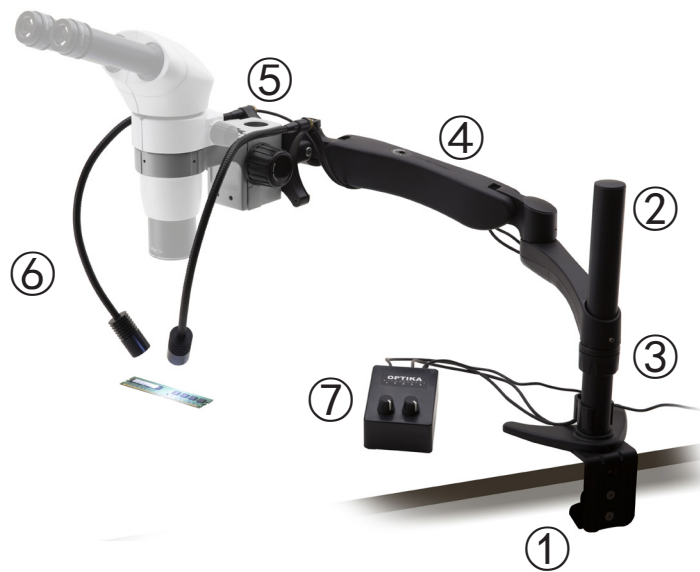

- | | |
|---|--|
| ① Pince de table | ⑧ Serre-câbles |
| ② Pilier | ⑨ Joint rond |
| ③ Bague anti-chute | ⑩ Vis courtes M4x12 mm (4 pièces) |
| ④ Bras horizontal | ⑪ Vis longues M4x25 mm (4 pièces) |
| ⑤ Support de tête / système de mise au point | ⑫ Clés Allen |
| ⑥ Bras autoportants à LEDs | ⑬ Pieds en caoutchouc (4 pièces) |
| ⑦ Boîtier de commande de l'éclairage avec alimentation électrique | ⑭ Joint rectangulaire |
| | ⑮ Pince de table pour grandes épaisseurs |

4. Déballage

Le microscope est emballé dans du polystyrène expansé. Enlever le ruban adhésif et retirer la partie supérieure de l'emballage. Retirer soigneusement le microscope et ses composants de l'emballage, utiliser les deux mains pour éviter de faire tomber et de casser les accessoires qu'il contient. L'appareil doit toujours être posé sur une surface stable, lisse et horizontale.



Éviter de toucher les éléments optiques; salir ou laisser des traces de doigts, de l'huile, de graisse ou d'autres résidus sur les objectifs, les filtres, les verres diminuent généralement la clarté d'image.

5. Emploi prévu

Modèles standard

Réservé à la recherche et à l'enseignement. Ne pas utiliser à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, animales ou humaines.

Modèles de DIV

Également à usage diagnostique, visant à obtenir des informations sur la situation physiologique ou pathologique du sujet.

6. Symboles

Le tableau suivant est un glossaire illustré des symboles qui sont utilisés dans ce manuel.



ATTENTION

Ce symbole indique un risque potentiel et vous avertit de procéder avec prudence.



CHOC ÉLECTRIQUE

Ce symbole indique un risque de choc électrique.

7. Description de l'instrument

7.1 Diagramme de Système



7.2 SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA




7.3 SZO-B / SZO-T




7.4 SZ-A1




7.5 SZ-A6

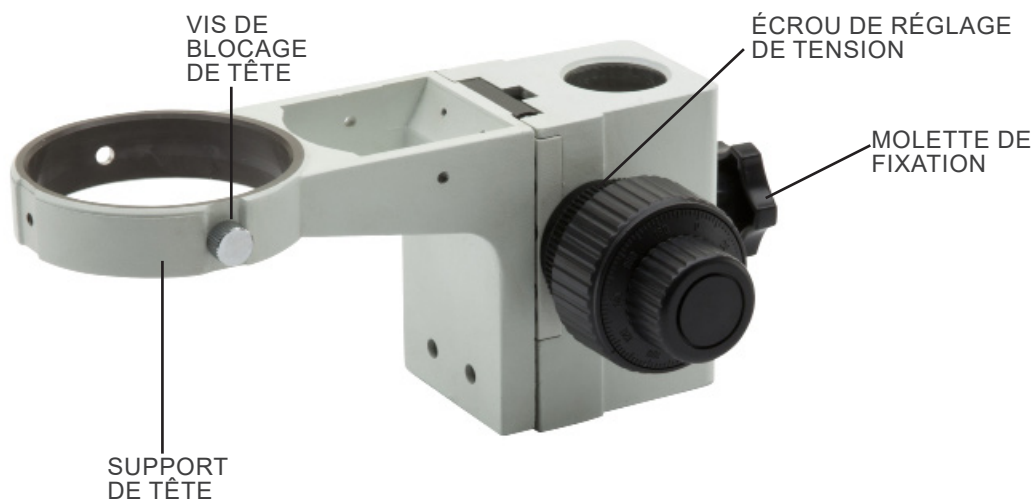


7.6 ST-150

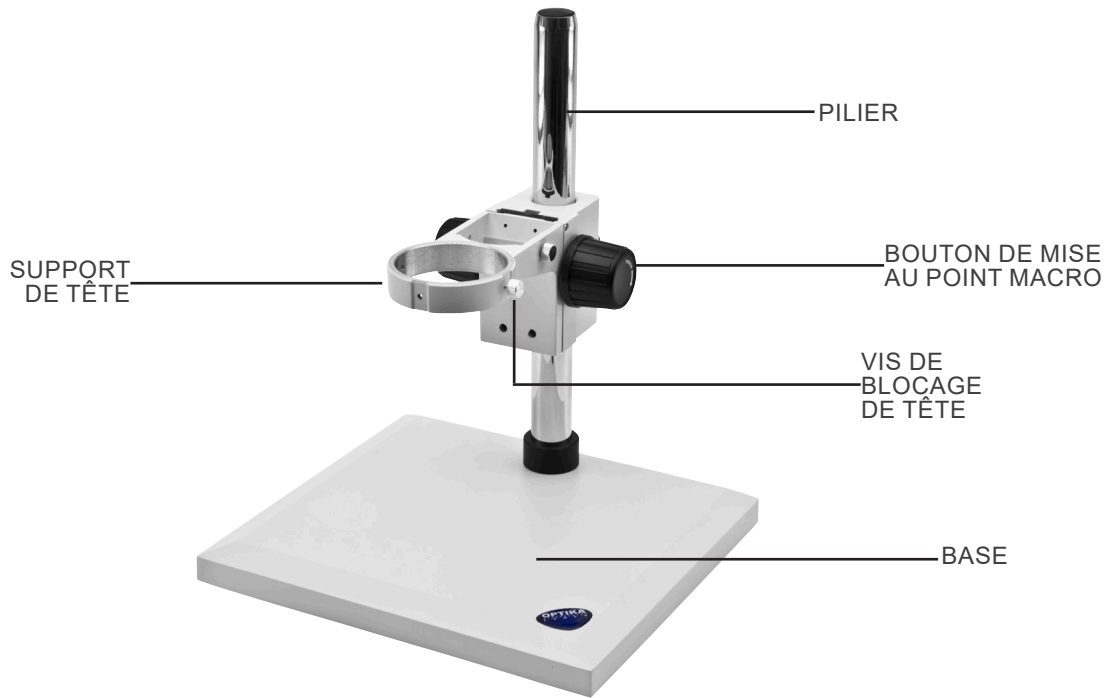


7.7 ST-152

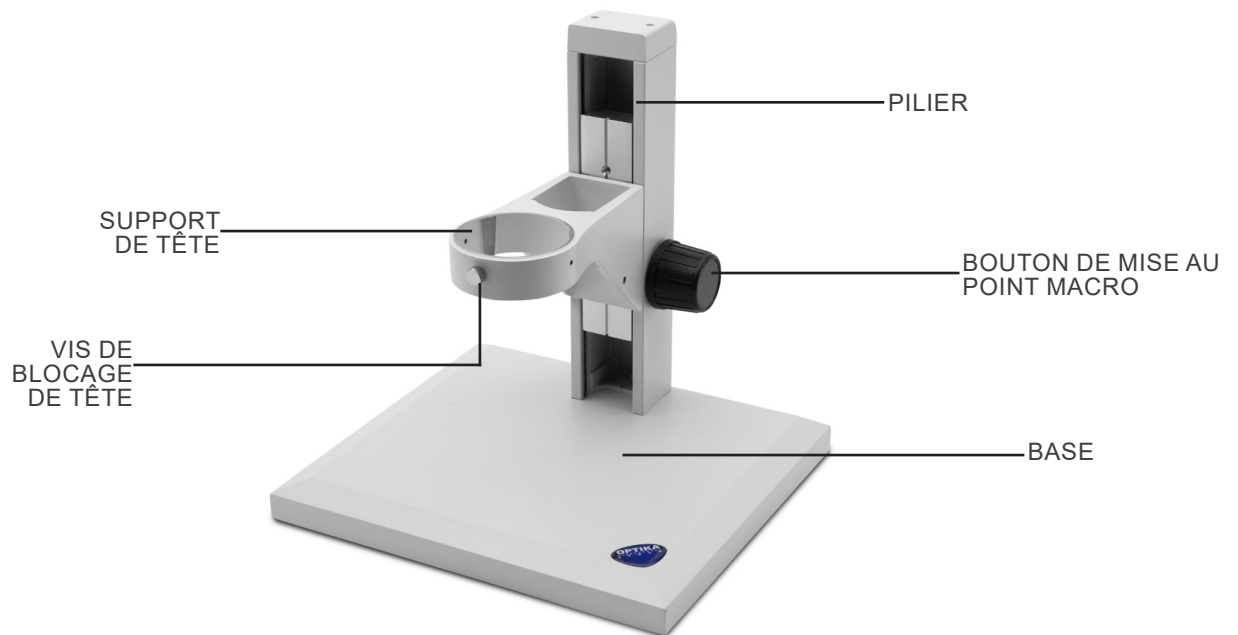


7.8 SZ-ST1

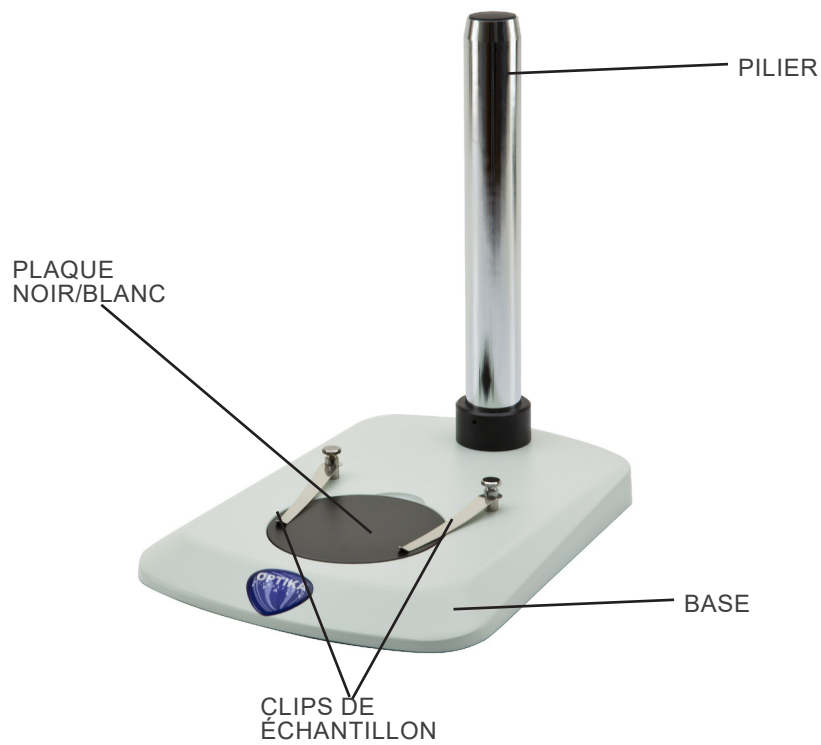


7.9 SZ-ST2 / SZ-ST3

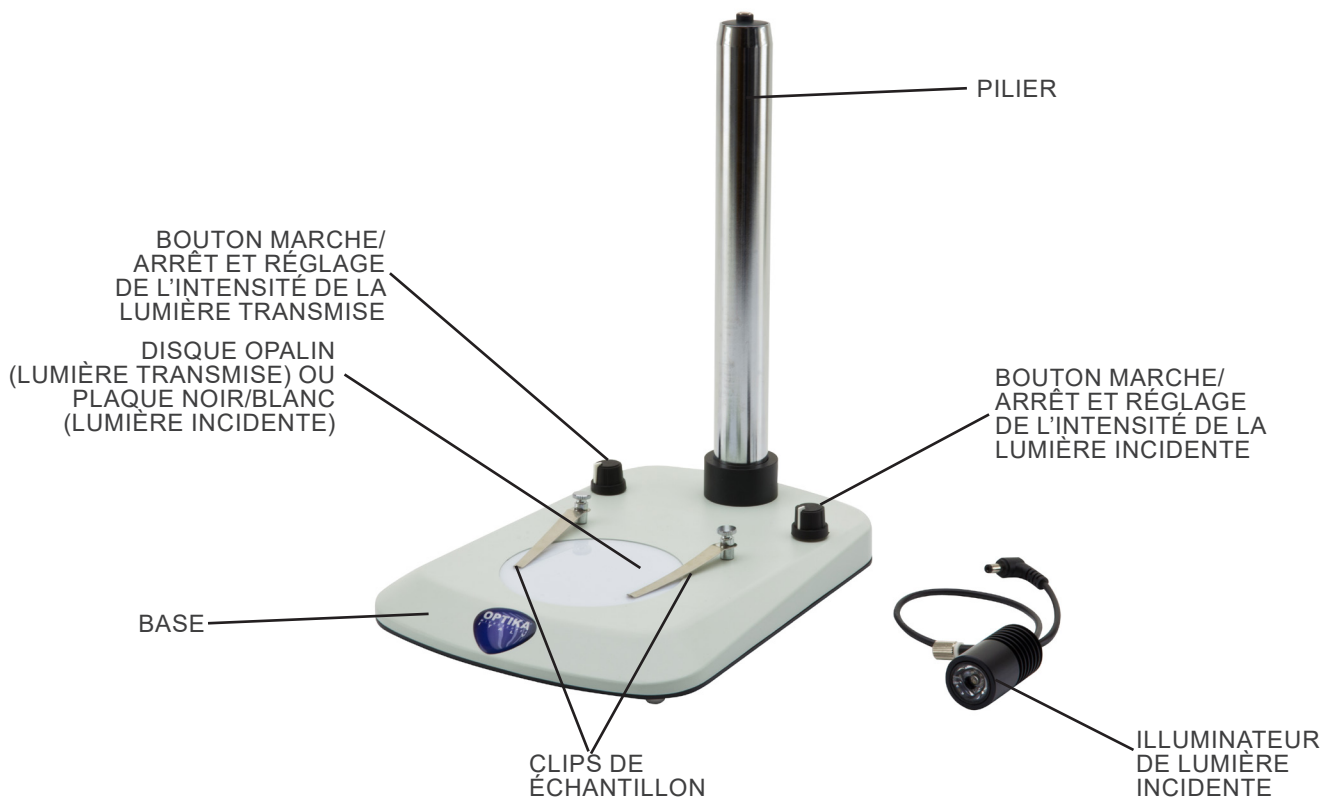


7.10 SZ-ST7 / SZ-ST8

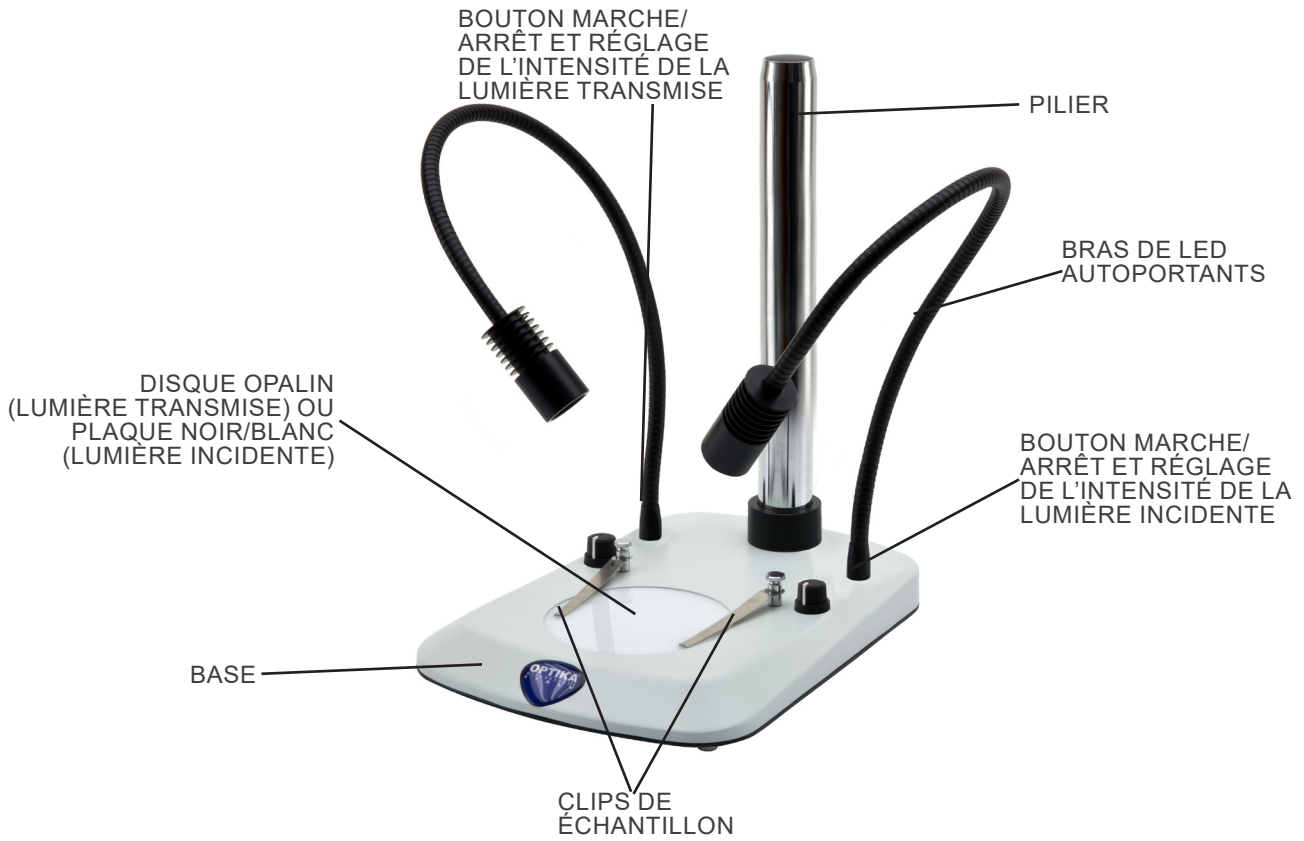


7.11 SZ-OBL

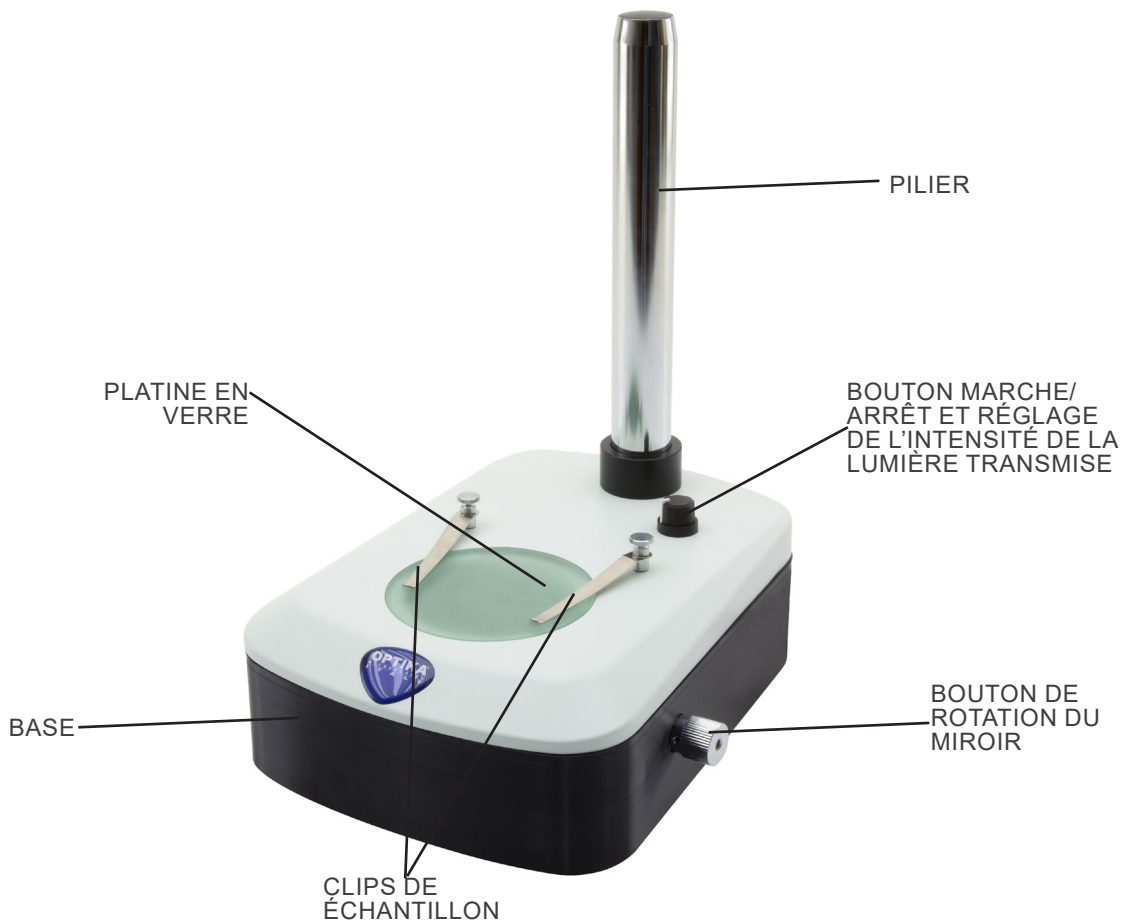


7.12 SZ-STL1

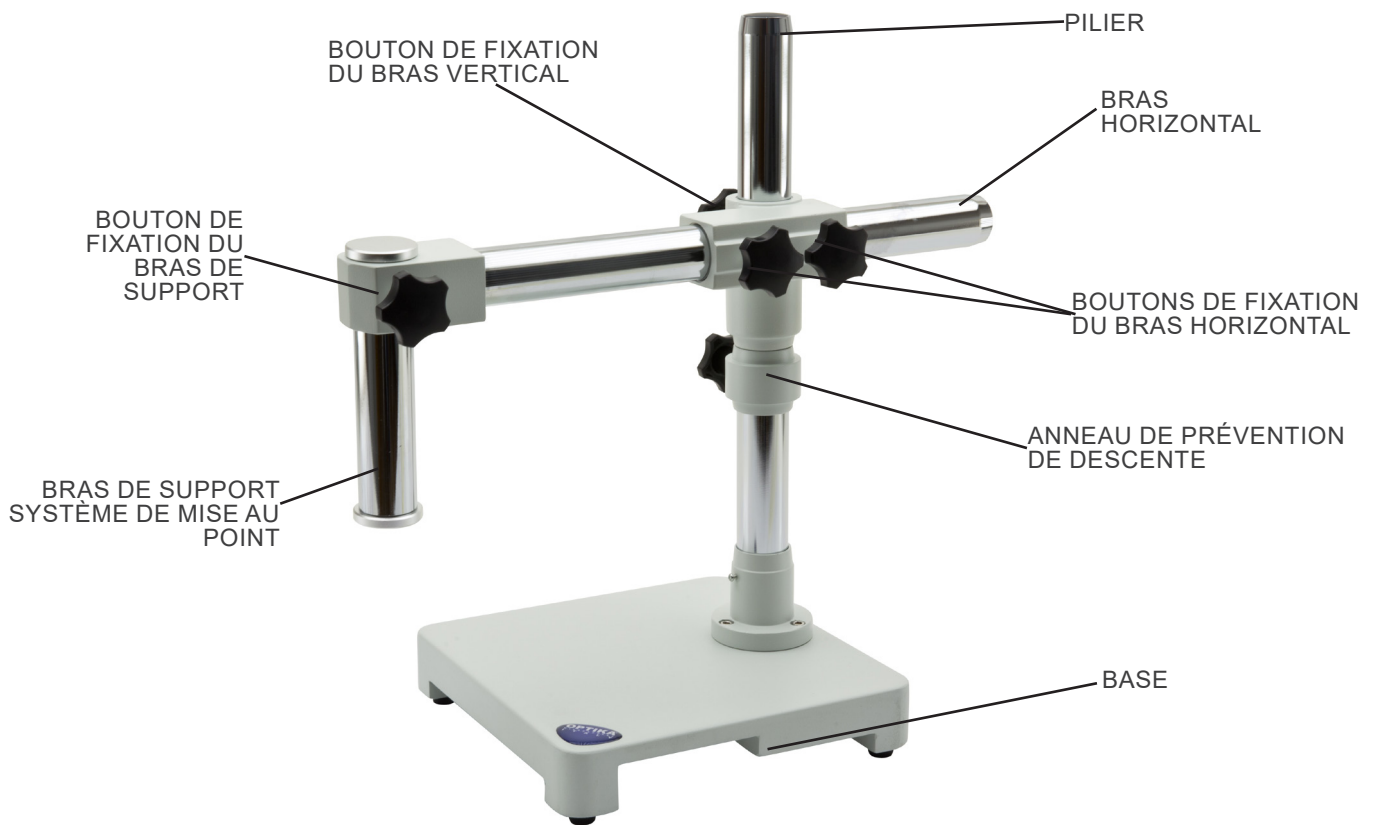


7.13 SZ-STL2

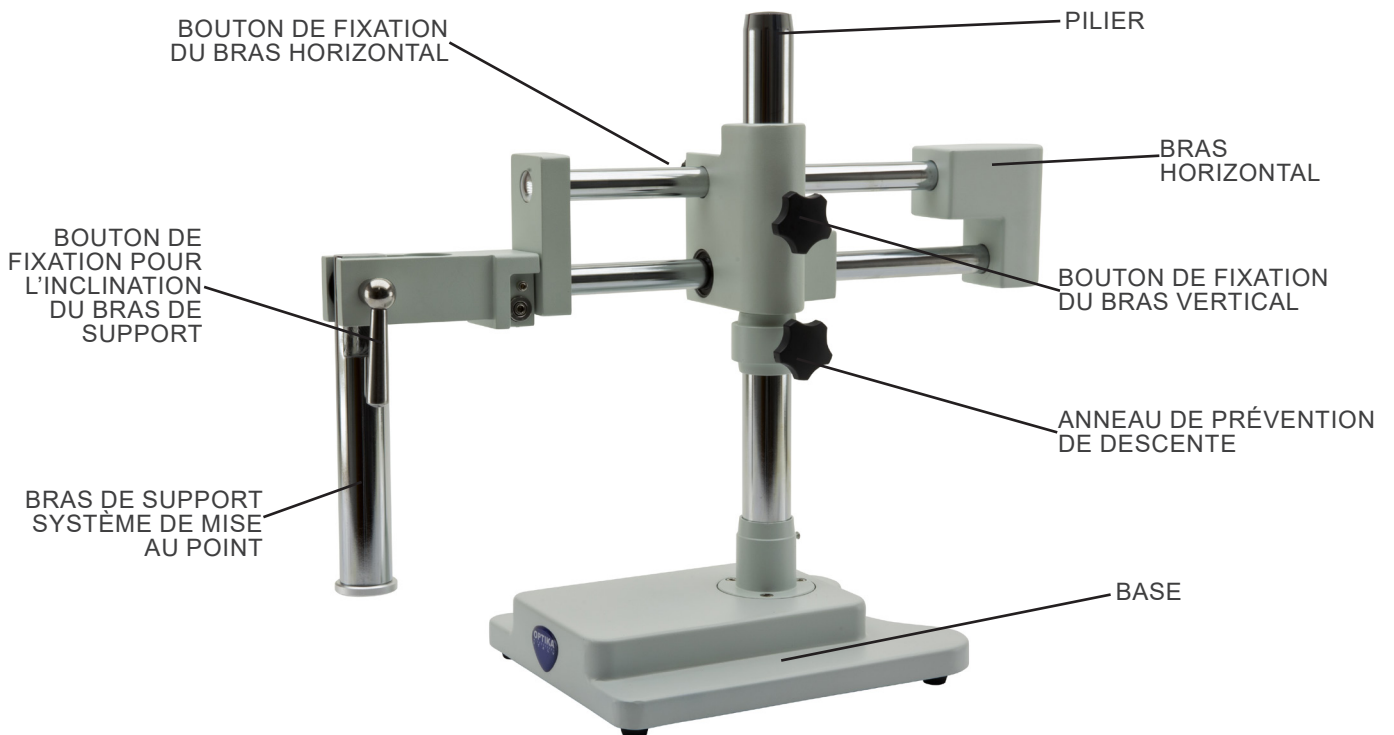


7.14 SZ-STLX

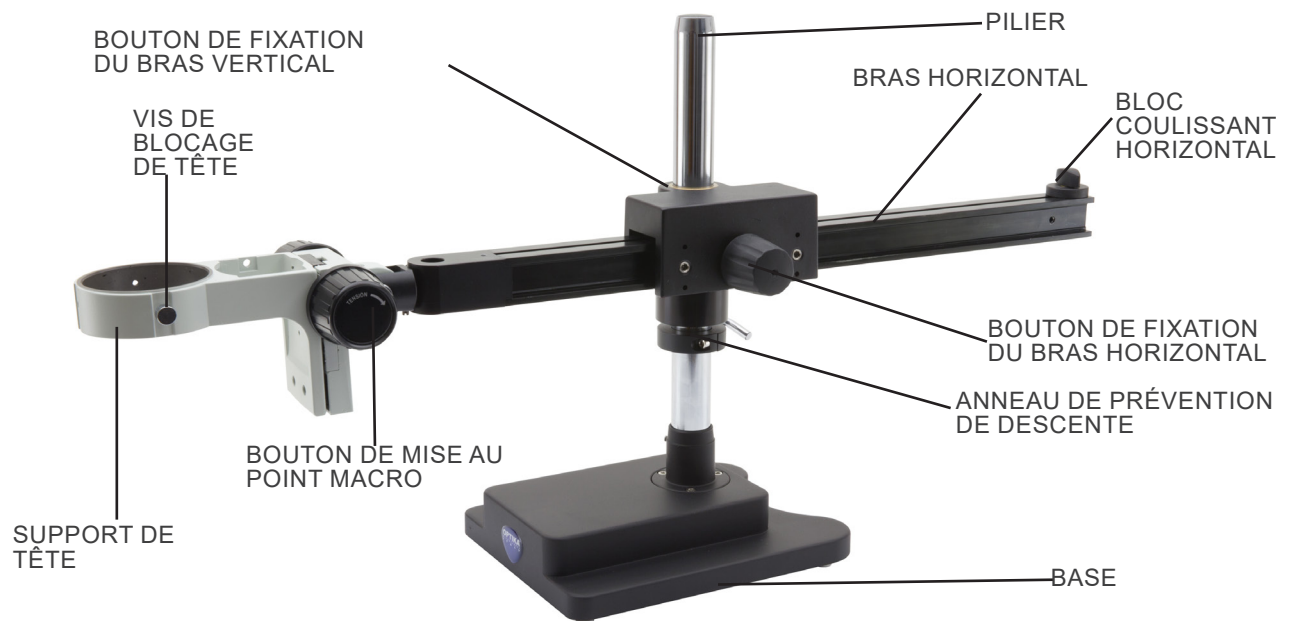

7.15 SZ-STL5

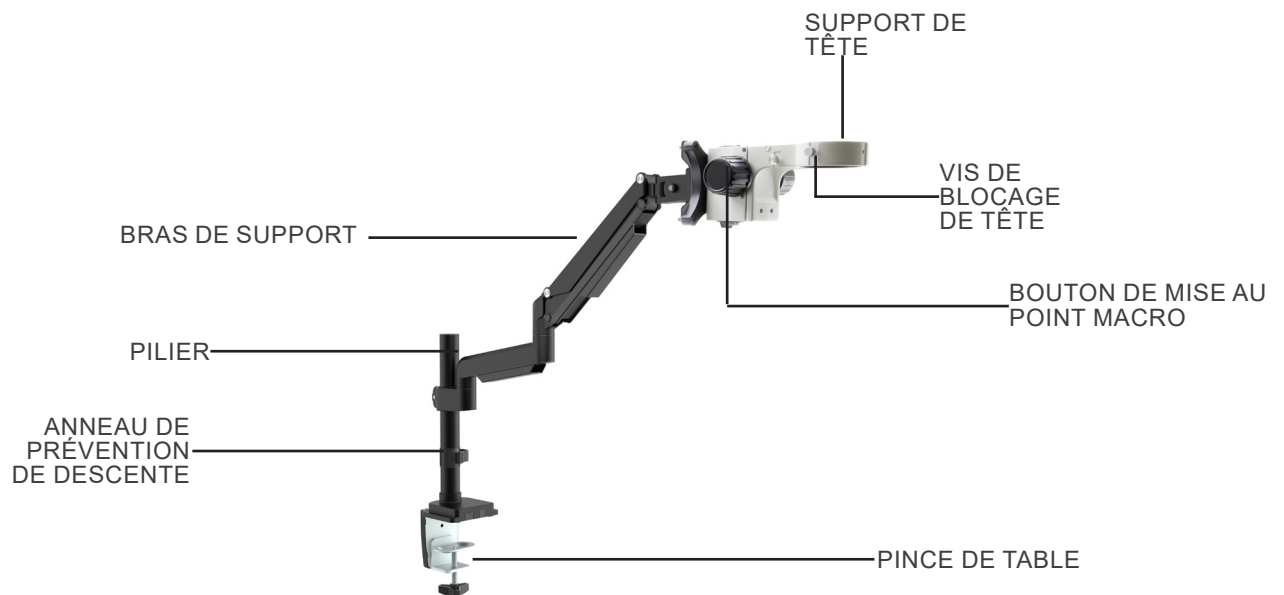


7.16 SZ-STL5LED

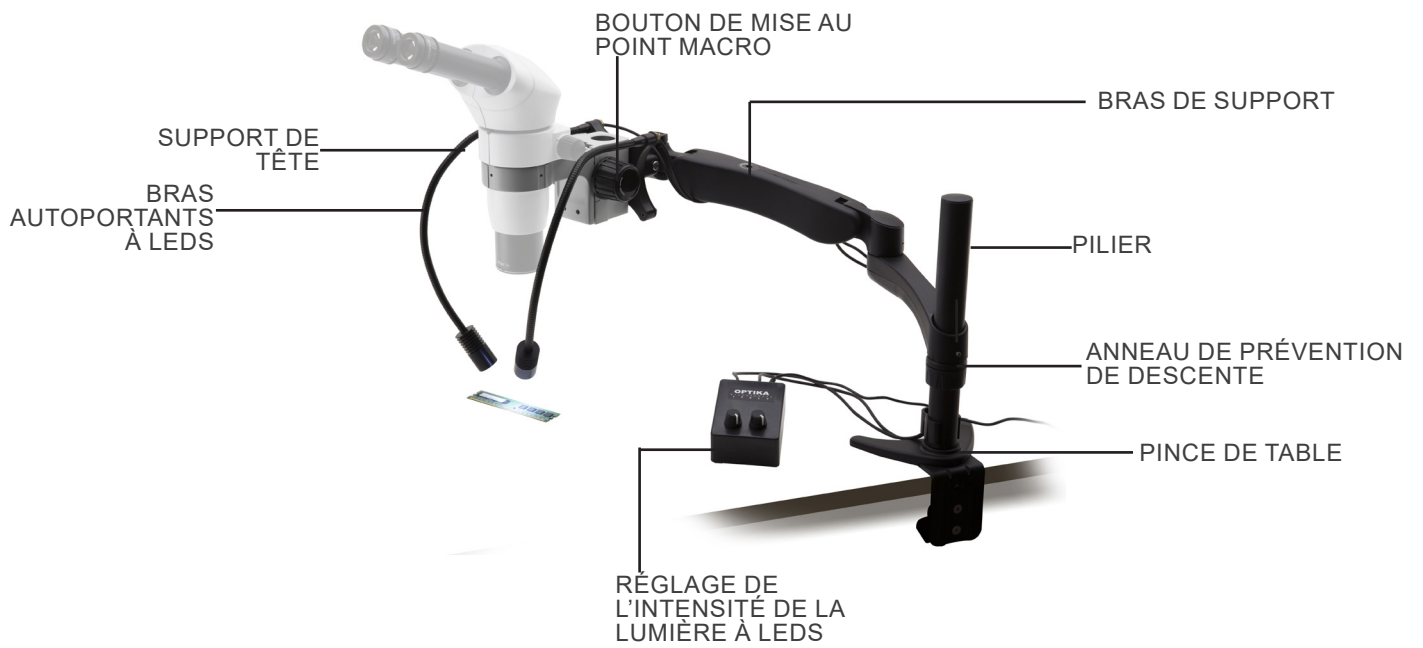

8. Assemblage

8.1 SZ-A1 / SZ-A6

- Le montage des systèmes de mise au point SZ-A1 et SZ-A6 s'applique à toutes les bases sauf ST-152, SZ-STL1, SZ-STL2, SZ-STLX et SZ-STL5. Pour le montage sur ces bases, veuillez vous référer à la section spécifique.
- Placez le système de mise au point sur la colonne et, une fois la hauteur souhaitée atteinte, serrez le bouton de verrouillage ① situé à l'arrière du système de mise au point. (Fig. 1)

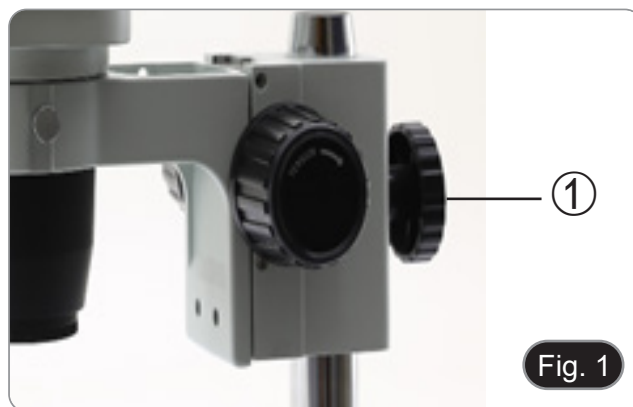

8.2 SZ-ST1 / ST-150

- Retirez la base de son emballage et placez-la sur une surface plane. Le socle est déjà monté en usine et ne nécessite pas d'autre procédure de montage que celle du montage du système de mise au point.

8.3 ST-152


- Retirez la base de son emballage et placez-la sur une surface plane. Le socle est déjà monté en usine et ne nécessite pas d'autre procédure de montage.

8.4 SZ-ST2 / SZ-ST3

- Installer le projecteur à LED pour la lumière incidente d'après la Fig. 2.
- En desserrant la vis de fixation ②, vous pouvez modifier l'angle d'inclinaison du projecteur pour optimiser l'éclairage de l'échantillon.



- Insérez le connecteur du câble dans le connecteur en haut du pilier ③. (Fig. 3)

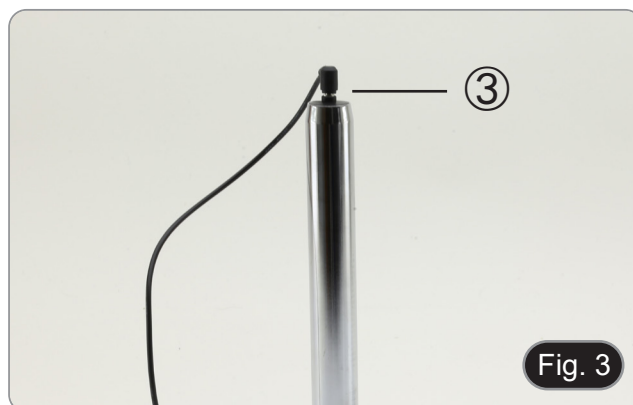

3. Brancher le jack de l'alimentation à la prise située à l'arrière de la base du microscope. (Fig. 4)



8.5 SZ-ST7 / SZ-ST8 / SZ-OBL


1. Retirez la base de son emballage et placez-la sur une surface plane. Le socle est déjà monté en usine et ne nécessite pas d'autre procédure de montage que celle du montage du système de mise au point.
2. Brancher le jack de l'alimentation à la prise située à l'arrière de la base du microscope. (Fig. 4)

8.6 SZ-STL1

1. Visser le pilier à la base. (Fig. 5)




2. Serrer les vis pour bloquer le pilier. (Fig. 6)

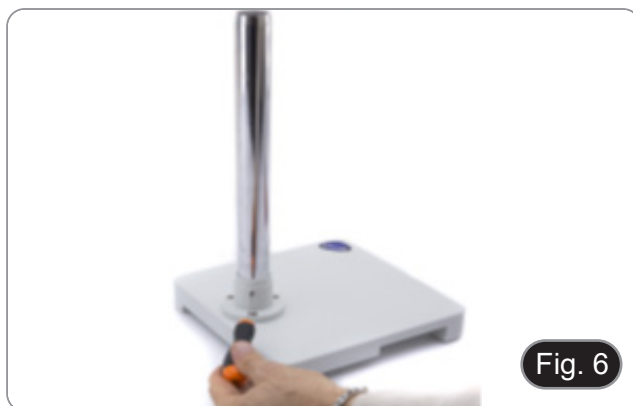

3. Insérez la bague de prévention de descente et fixez-la à la hauteur désirée en vissant le bouton de fixation. (Fig. 7)



4. Insérer le bras horizontal et le fixer à l'aide de la vis de fixation ①. (Fig. 8 - 9)

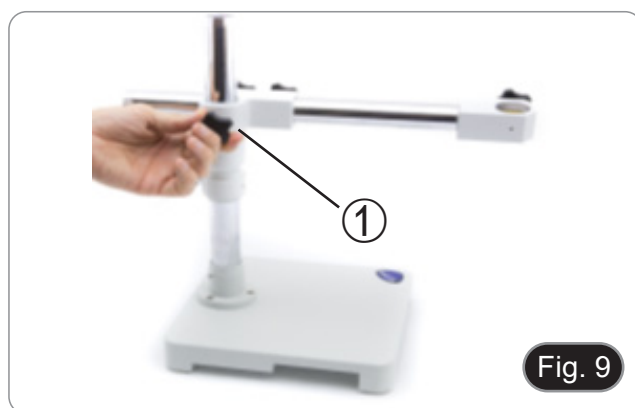

5. Installez le support de tête. Dévissez le bouton de verrouillage ③ et insérez le bras pour le support de mise au point par le haut ② dans le trou du bras horizontal. (Fig. 10)



6. Une fois complètement inséré, serrer la vis de fixation ④ (Fig. 11)



7. Insérer le système de mise au point par le bas, serrer la vis de fixation ⑤ et resserrer le bouton de verrouillage ③ par le bas. (Fig. 12-13)



8.7 SZ-STL2

1. Visser le pilier à la base. (Fig. 14)



2. Serrer les vis pour bloquer le pilier. (Fig. 15)




3. Insérez la bague de prévention de descente et fixez-la à la hauteur désirée en vissant le bouton de fixation. (Fig. 16)




4. Insérer le bras horizontal et le fixer à l'aide de la vis de fixation ① (Fig. 17).



5. Pour plus de sécurité, serrez la vis de fixation ② avec la clé Allen fournie ②. (Fig. 18)

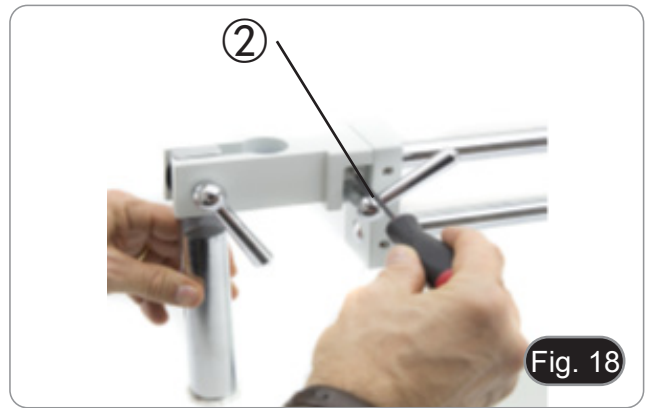

6. Installez le système de mise au point. Dévisser le bouton de verrouillage ③ et insérer le support ④ par le bas dans le pilier. Ensuite, revissez le bouton de verrouillage ③. (Fig. 19-20)

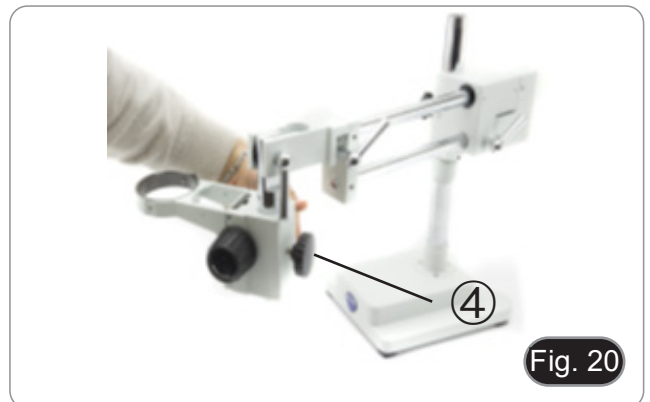

8.8 SZ-STLX

1. Visser le pilier à la base. (Fig. 21)



2. Serrer les vis pour bloquer le pilier. (Fig. 22)



3. Insérez la bague de prévention de descente et fixez-la à la hauteur désirée en vissant le bouton de fixation. (Fig. 23)



4. Insérer le bras horizontal et le fixer à l'aide de la vis de fixation ①. (Fig. 24)





5. Le support de tête peut être installé de différentes manières selon les besoins spécifiques de l'utilisateur.

Mode d'installation n° 1: (Fig. 25-27)

Insérez la partie arrière de l'appui-tête (partie ronde noire) ③ (Fig. 25) par le haut dans le trou du bras horizontal ④ et vissez le bouton de prévention ② par le bas.

- Ce mode permet l'installation de têtes lourdes (ou avec des caméras lourdes installées au-dessus de la tête).

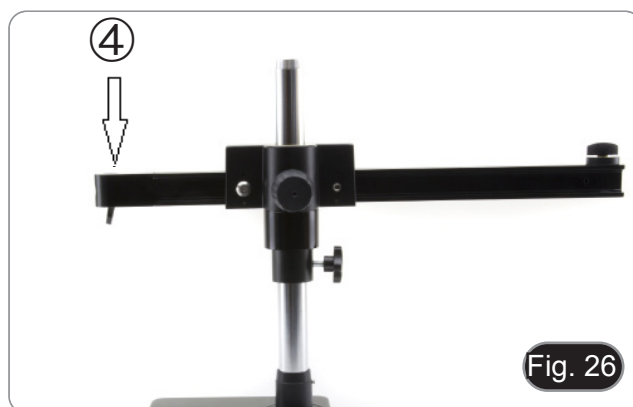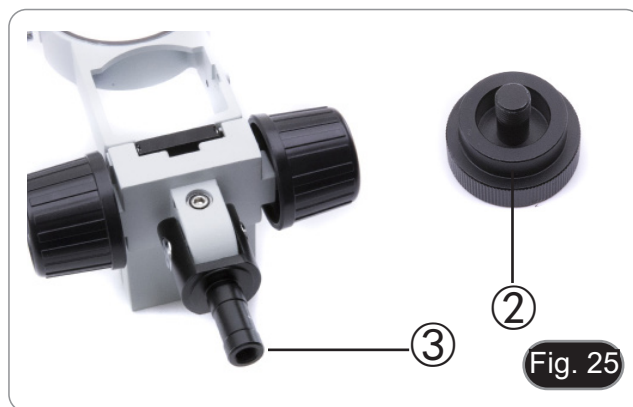

Mode d'installation n° 2: (Fig. 28-29)

Insérez la partie arrière de l'appui-tête (partie noire ronde) ③ (Fig. 28) par le bas dans le trou du bras horizontal et vissez le bouton de prévention ② par le haut.



- Ces deux modes permettent d'incliner la tête. (Fig. 29)



Mode d'installation n° 3: (Fig. 30)

Insérer la partie arrière de l'appui-tête (partie ronde noire) ③ (Fig. 25) dans le trou à l'extrémité du bras horizontal et serrer le bouton ⑤.




- Ce mode vous permet d'incliner la tête. (Fig. 31).



8.9 SZ-STL5 / SZ-STL5LED


1. Réglez la hauteur de la pince de table ① en fonction de la surface du table. (Fig. 32)

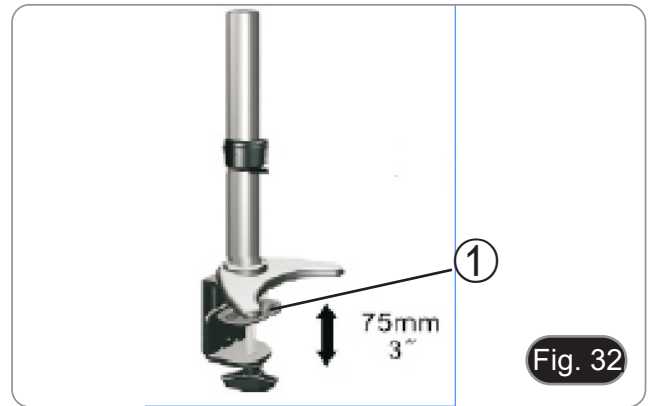


2. Fixez la pince de table ① sur le bord du table dans la position souhaitée et avec l'ouverture de la pince tournée vers le bord du table (Fig. 33). Serrez à la main le bouton ② pour vous assurer que la pince de table se fixe complètement à la surface du table et est sécurisée. (Fig. 34).



3. Pour positionner le collier à la hauteur souhaitée, vous devez le desserrer comme indiqué. Serrez à la main jusqu'à ce que le collier soit fermement en place. (Fig. 35)

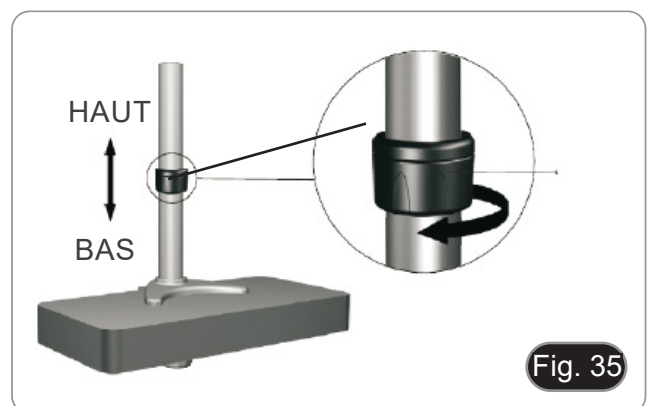

4. Montez le système de mise au point sur le bras, en utilisant les vis et la clé Allen fournie. (Fig. 36)

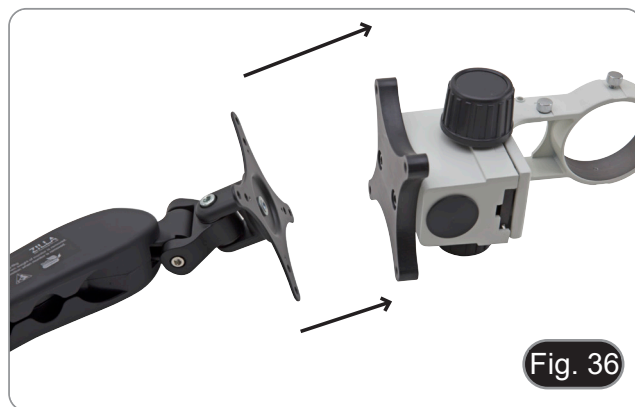

8.10 Installer la tête (tous les modèles)

Insérer la tête et fixer la vis de blocage. (Fig. 37)



8.11 Installer les oculaires (tous les modèles)

1. Retirez les capuchons anti-poussière des porte-oculaires et insérez les oculaires. (Fig. 38)
2. Verrouiller les oculaires en serrant la vis de verrouillage ①.




8.12 Installer la sortie photo (SZX-T / TA)

1. Desserrez les vis de fixation ① de la sortie photo fournie et retirez la sortie photo existante. (Fig. 39)



2. Insérez la bague de la sortie photo ② en veillant à laisser la vis de fixation de l'adaptateur photo ③ face à droite. (Fig. 40)
3. Serrer les vis de fixation ①. (Fig. 39)

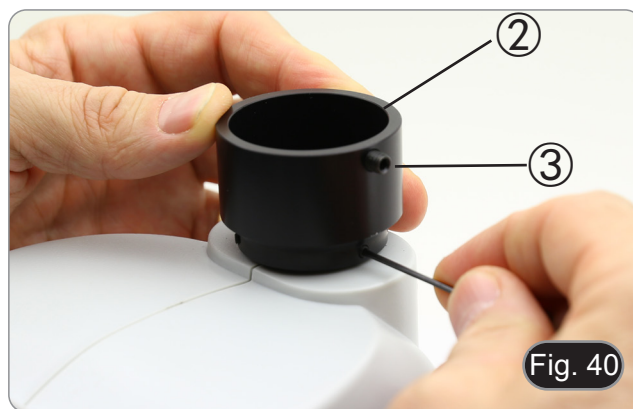

9. Utilisation du microscope


9.1 Ajuster la distance interpupillaire

1. Tenez le tube oculaire droit et gauche avec les deux mains et réglez la distance interpupillaire en déplaçant les deux parties jusqu'à ce qu'un cercle lumineux soit visible.
- Si deux cercles apparaissent, la distance interpupillaire est trop grande.
- Si deux cercles se chevauchent, la distance interpupillaire est trop petite (Fig. 41)



9.2 Mise au point

1. Placez l'échantillon à observer sur la plaque et faites la mise au point à l'aide des boutons de mise au point ①.
- Si nécessaire, ajuster la hauteur du corps du microscope le long de la colonne verticale.
- Verrouillez la vis de blocage ② après avoir réglé la hauteur. (Fig. 42)

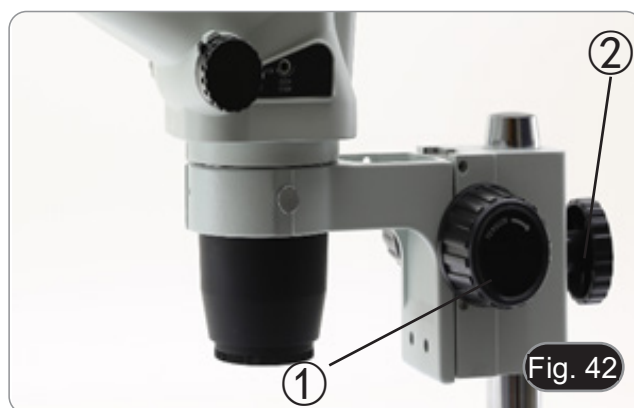


9.3 Réglage de la tension des boutons de mise au point

- Ce réglage permet d'augmenter ou de diminuer la tension du bouton en évitant une descente involontaire du corps du microscope sous son propre poids. Ajustez la tension juste au-dessus du point où la mise au point est stable.

9.3.1 SZ-A1

1. Saisissez les boutons ③ des deux mains et, tout en tenant le bouton gauche, tournez le bouton droit.
- La tension augmente ou diminue en fonction du sens de rotation du bouton droit. (Fig. 43)

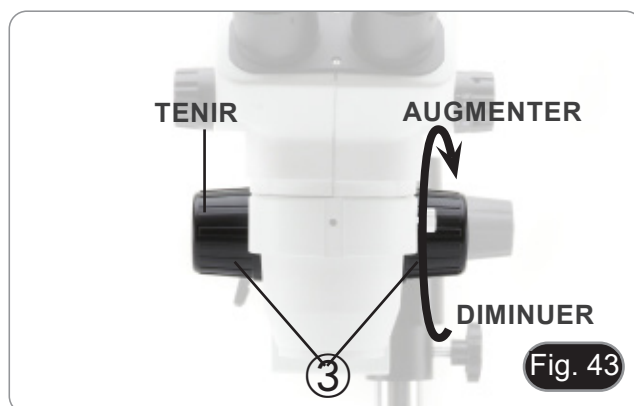


9.3.2 SZ-A6

1. Tourner la bague de réglage ④ dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tension souhaitée soit atteinte.
- Si vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la tension chute, ce qui entraîne une perte de mise au point. (Fig. 44)



9.4 Levier de verrouillage de la mise au point (SZ-A6)

- Le levier de verrouillage sert de fonction mémoire de mise au point.
- Après la mise au point de l'échantillon, tirez le levier ① vers l'avant du microscope et verrouillez-le (Fig. 45).
 - Ceci définit le point focal supérieur.
 - Vous pouvez maintenant déplacer la mise au point du microscope à l'aide du bouton macrométrique, remplacer l'échantillon et ramener le système au point supérieur: l'échantillon sera approximativement au point et vous n'aurez qu'à faire un réglage fin pour obtenir la mise au point optimale.
- Le mouvement du micromètre n'est pas affecté par le bloc de mise au point.
- Pour retirer la serrure, déplacez le levier dans la direction opposée à celle utilisée pour la serrure.**

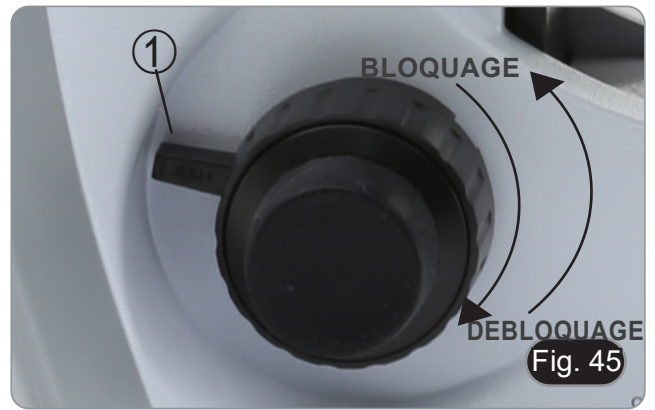

9.5 Compensation dioptrique

- Cette compensation permet aux personnes portant des lunettes d'ajuster le microscope à leurs yeux et d'utiliser le microscope sans lunettes.**
- Mettez le zoom ② vers le bas jusqu'au grossissement le plus faible et faites la mise au point sur l'objet à l'aide des boutons de mise au point ③. (Fig. 46)
 - Mettez le zoom au grossissement maximum et répétez la mise au point.
 - Retour au grossissement le plus faible: l'échantillon sera flou.
 - Régler la bague de compensation dioptrique de l'oculaire droit ④ (Fig. 47) jusqu'à ce que l'image de l'oculaire droit soit nette. Répétez la procédure pour l'oculaire gauche.
 - Ensuite, vérifiez la mise au point de l'image pour toute la plage de zoom. Il doit maintenant être parfaitement parfocal (la mise au point est toujours maintenue pendant le changement de grossissement).



9.6 Grossissement

1. Sélectionner l'agrandissement désiré en ajustant le bouton de zoom ②. (Fig. 48)
- Changer les oculaires et/ou ajouter une lentille supplémentaire appropriée si nécessaire.
 - **Uniquement pour la série SZO:** Le corps du microscope est équipé d'une fonction "bloc du grossissement" qui permet d'obtenir un réglage précis de l'agrandissement souhaité (Fig. 40). Le clic d'arrêt peut être activé ou désactivé en insérant la clé Allen fournie dans le trou situé sur le côté droit du microscope.



9.7 Utilisation d'un objectif supplémentaire

1. Visser la lentille supplémentaire souhaitée sur le corps du microscope. (Fig. 44)
- Chaque lentille supplémentaire a une distance de travail spécifique.
 - La course de l'adaptateur de mise au point ne pouvait pas compenser les différentes distances de travail des différents objectifs supplémentaires.
 - Si le support de mise au point ne parvient pas à focaliser l'échantillon, le corps entier du microscope doit être soulevé ou abaissé.

Le grossissement total utilisé peut être calculé comme suit:
grossissement de l'oculaire * grossissement du zoom * grossissement de l'objectif.



Série SZX (0.67x - 4.5x / F.N. 22 mm)

Oculaire	10x		15x		20x		25x	
Indice de champ (mm)	22		16		12		9	
Objectif	Gross. Totale	Champ visuel (mm)	Gross. Totale	Champ visuel (mm)	Gross. Totale	Champ visuel (mm)	Gross. Totale	Champ visuel (mm)
0.3X	2.01X-13.5X	109.45-16.30	3.02X-20.25X	79.60-11.85	4.02X-27X	59.70-8.89	5.03X-33.75X	44.78-6.67
0.5X	3.35X-22.5X	65.67-9.78	5.03X-33.75X	47.76-7.11	6.7X-45X	35.8-5.33	8.38X-56.25X	26.87-4.00
0.75X	5.03X-33.75X	43.78-6.52	7.54X-50.63X	31.84-4.74	10.05X-67.5X	23.88-3.56	12.56X-84.37X	17.91-2.67
1X	6.7X-45X	32.84-4.89	10.05X-67.5X	23.88-3.56	13.4X-90X	17.91-2.67	16.75X-112.5X	13.43-2.00
1.5X	10.05X-67.5X	21.89-3.26	15.08X-101.25X	15.92-2.37	20.1X-135X	11.94-1.78	25.13X-168.75X	8.96-1.33
2X	13.4X-90X	16.42-2.44	20.1X-135X	11.94-1.78	26.8X-180X	8.96-1.33	33.5X-225X	6.72-1.00

Série SZX-A (0.65x - 5.5x / F.N. 23 mm)

Oculaire	10x		15x		20x		25x	
Indice de champ (mm)	23		16		12		9	
Objectif	Gross. Totale	Champ visuel (mm)	Gross. Totale	Champ visuel (mm)	Gross. Totale	Champ visuel (mm)	Gross. Totale	Champ visuel (mm)
0.3X	1.95X-16.5X	117.95-13.94	2.93X-24.75X	82.05-9.70	3.9X-33X	61.54-7.27	4.88x-41.25x	46.15-5.45
0.5X	3.25X-27.5X	70.77-8.36	4.88X-41.25X	49.23-5.82	6.5X-55X	36.92-4.36	8.13x-68.75X	27.69-3.27
0.75X	4.88X-41.25X	47.18-5.58	7.31X- 61.88X	32.82-3.88	9.75X-82.5X	24.62-2.91	12.19x-103.13X	18.46-2.18
1X	6.5X-55X	35.38-4.18	9.75X-82.5X	24.62-2.91	13X-110X	18.46-2.18	16.25X-137.5X	13.85-1.64
1.5X	9.75X-82.5X	23.59-2.79	14.63X-123.75X	16.41-1.94	19.5X-165X	12.31-1.45	24.38X-206.25X	9.23-1.09
2X	13X-110X	17.69-2.09	19.5X-165X	12.31-1.45	26X-220X	9.23-1.09	32.5X-275X	6.92-0.82

Série SZO (0.67x - 4.5x / F.N. 23 mm)


Oculaire	10x		15x		20x		25x	
Indice de champ (mm)	23		16		12		9	
Objectif	Gross. Totale	Champ visuel (mm)	Gross. Totale	Champ visuel (mm)	Gross. Totale	Champ visuel (mm)	Gross. Totale	Champ visuel (mm)
0.3X	2.01X-13.5X	114.43-17.04	3.02X-20.25X	79.60-11.85	4.02X-27X	59.70 -8.89	5.03X-33.75X	44.78-6.67
0.5X	3.35X-22.5X	68.66-10.22	5.03X-33.75X	47.76-7.11	6.7X-45X	35.82-5.33	8.38X-56.25X	26.87-4.00
0.75X	5.03X-33.75X	45.77-6.81	7.54X- 50.63X	31.84-4.74	10.05X-67.5X	23.88-3.56	12.56X-84.38X	17.91-2.67
1X	6.7X-45X	34.33-5.11	10.05X-67.5X	23.88-3.56	13.4X-90X	17.91-2.67	16.75X-112.5X	13.43-2.00
1.5X	10.05X-67.5X	22.89-3.41	15.08X-101.25X	15.92-2.37	20.1X-135X	11.94-1.78	25.13X-168.75X	8.96-1.33
2X	13.4X-90X	17.16-2.56	20.1X-135X	11.94-1.78	26.8X-180X	8.96-1.33	33.5X-225X	6.72-1.00

9.8 Utilisation d'un objectif supplémentaire 0.3X-0.5X

Les objectifs supplémentaires 0.3X et 0.5X ont une longue distance de travail et la course totale de la colonne de mise au point ne peut donc pas compenser.

Pour que les objectifs supplémentaires 0,3X et 0,5X fonctionnent correctement, procédez comme suit:

1. Vissez la lentille supplémentaire comme décrit dans la section 9.7.
2. Retirez le corps du microscope de son support.
3. Installez l'entretoise ① dans le support de tête et vissez le bouton de fixation ②. (Fig. 50)
4. Réinstallez le corps du microscope sur l'entretoise et vissez le bouton de fixation ③. (Fig. 51)
5. Commencez à travailler normalement.

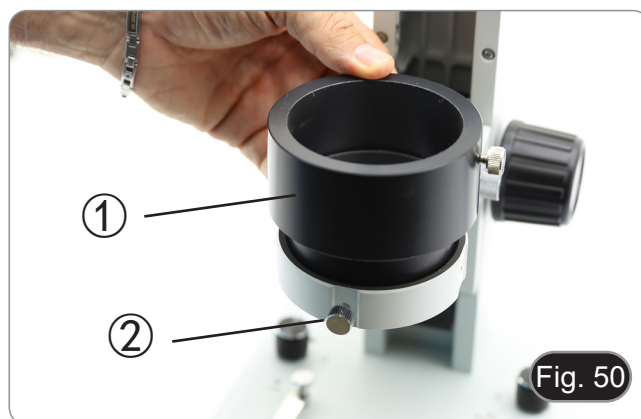


9.9 Plaque noir/blanc (SZ-ST1 / 2 / 3 / 7 / 8)

- Vous pouvez utiliser un disque de contraste noir/blanc pour augmenter le contraste de l'image lorsque vous travaillez en lumière incidente.
1. Retirez le disque opale transparent utilisé en lumière transmise.
 2. Insérez le disque noir/blanc avec la face souhaitée vers le haut. (Fig. 52)
- Si vous regardez des échantillons clairs, placez le disque avec la partie noire vers le haut.



9.10 Utilisation de l'illumination (SZ-ST2 / 3 / 7 / 8)

1. Tournez le bouton de la lumière transmise ② pour allumer/éteindre ou pour changer l'intensité de la LED de la lumière transmise. (Fig. 53)
 2. Tournez le bouton de la lumière incidente ① pour allumer/éteindre ou pour changer l'intensité de la LED de la lumière incidente.
- Il est possible d'utiliser les deux éclairages en même temps.

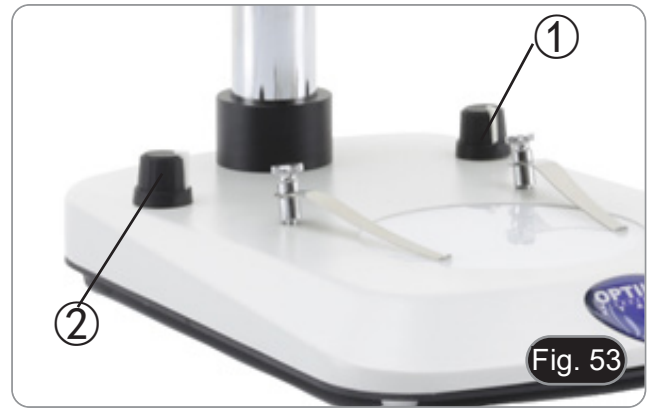

Seulement pour SZ-ST7 / SZ-ST8:

- Inclinez et positionnez les bras auto portants de la base ③ pour un éclairage optimal de l'échantillon. (Fig. 54)
- Les bras peuvent être placés individuellement dans la position souhaitée.



9.11 Utilisation de l'illumination (SZ-OBL)

1. Tournez le bouton de la lumière transmise ① pour allumer/éteindre ou pour changer l'intensité de la LED de la lumière incidente. (Fig. 55)
 2. Tourner le bouton de rotation du miroir ② pour incliner le miroir jusqu'à obtenir l'éclairage oblique souhaité.
- Le miroir présente une surface lisse et une surface moletée. Ces deux surfaces permettent d'optimiser l'observation en offrant un contraste adéquat en fonction de l'échantillon à observer.



9.12 Utilisation des Œillères en caoutchouc (SZO-B / T)

- Pour un utilisateur portant des lunettes

Utiliser les œillères dans leur position normale repliée. Cela évitera de rayer les lunettes. (Fig. 56)



- **Pour un utilisateur ne portant pas de lunette**

Déployer les œillères repliables qui constituent un écran qui empêchera toute lumière extérieure de passer entre les oculaires et les yeux. (Fig. 57)



9.12 Utilisation d'une base en surplomb

9.12.1 SZ-STL1

Déplacer le bras horizontal

1. Desserrez les boutons du côté droit du bras horizontal ①. (Fig. 58)



2. Le bras peut être allongé ou raccourci selon les besoins spécifiques. (Fig. 59)




Changer l'angle de la tête

1. Desserrez les boutons ① et tournez la tête à l'angle désiré (droite ou gauche), puis serrez la vis de fixation. (Fig. 60)



Tourner le bras horizontal


1. Desserrez la vis de fixation du bras horizontal ② et tournez le bras, puis serrez la vis de fixation. (Fig. 61)
- **REMARQUE** : Une rotation du microscope de 180° par rapport à la base peut faire basculer l'ensemble du système.

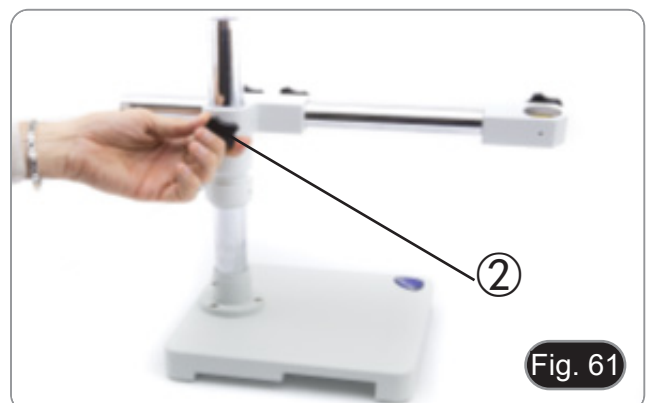

9.12.2 SZ-STL2

Déplacer le bras horizontal

1. Desserrez le bouton sur le côté gauche du bras horizontal ①. (Fig. 62)

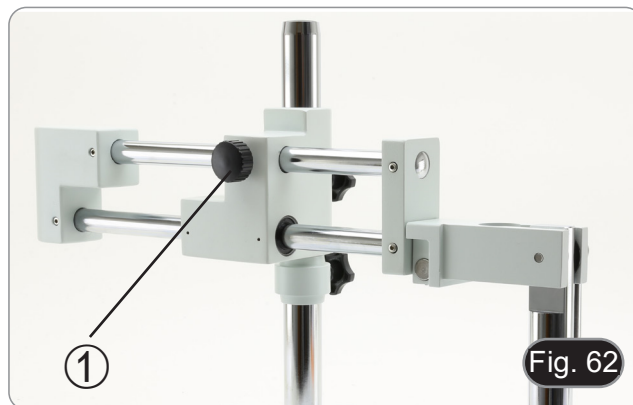


2. Le bras peut être allongé ou raccourci selon les besoins spécifiques. (Fig. 63)



Incliner le support de tête

1. Desserrez le bouton ② (Fig. 64) sur le côté droit du support. Le bras basculant vertical peut être déplacé. Une fois l'angle désiré atteint, serrez le bouton ②.

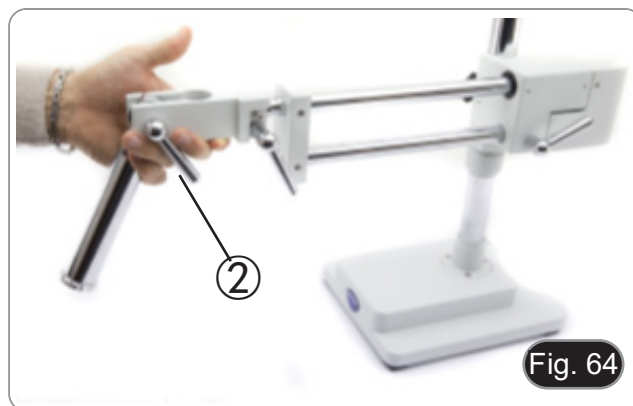

Changer l'angle de la tête

1. Desserrez la vis de fixation ③ et tournez la tête à l'angle souhaité (à droite ou à gauche), puis serrez la vis de fixation. (Fig. 65-66)

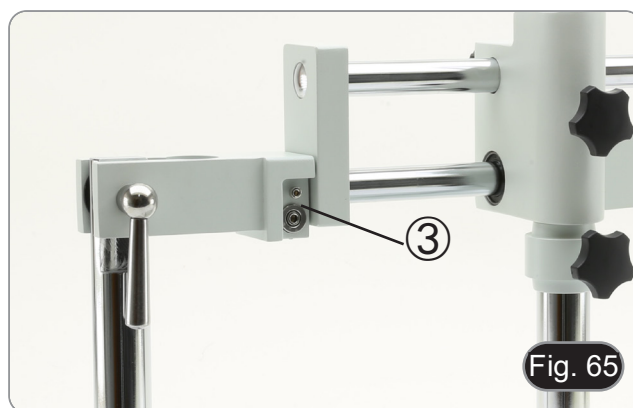




Fig. 66

Tourner le bras horizontal

1. Desserrer la vis de fixation du bras horizontal ④ et tourner le bras, puis serrer la vis de fixation. (Fig. 67)
- **REMARQUE** : Une rotation du microscope de 180° par rapport à la base peut faire basculer l'ensemble du système.



Fig. 67

9.12.3 SZ-STLX

Déplacer le bras horizontal

1. Desserrez les boutons du côté droit du bras horizontal①. (Fig. 68)



Fig. 68


2. Le bras peut être allongé ou raccourci selon les besoins spécifiques. (Fig. 69)



Fig. 69

Réglage du bloc horizontal

1. Déverrouiller le bouton de fixation du verrou ② et le placer dans une position adaptée aux besoins de l'utilisateur. (Fig. 70)
2. Verrouiller le bouton de fixation pour régler la limite de mouvement.

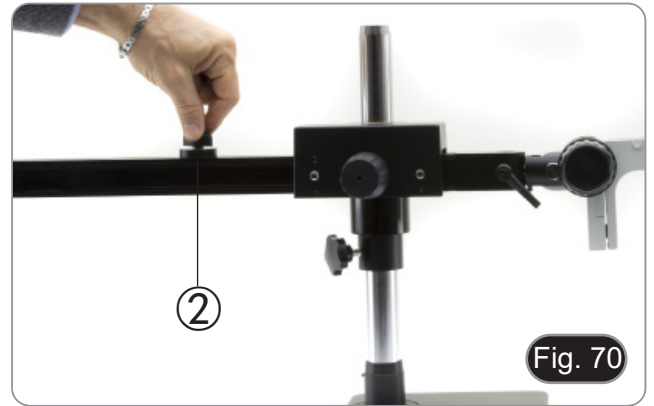

Incliner le support de tête

1. Desserrez la vis à six pans creux ③ (Fig. 71) sur la partie supérieure de l'appui-tête.
2. La partie noire peut être déplacée. Une fois l'angle désiré atteint, resserrer la vis.



Changer l'angle de la tête

1. Déverrouiller le bouton de fixation ④ et tourner la tête à l'angle de rotation désiré (gauche ou droite), puis resserrer le bouton. (Fig. 72-73)



Tourner le bras horizontal


1. Desserrer le bouton de fixation du bras horizontal ⑤ et tourner le bras, puis resserrer à nouveau le bouton. (Fig. 74)
- **REMARQUE** : Une rotation du microscope de 180° par rapport à la base peut faire basculer l'ensemble du système.




9.12.4 SZ-STL5 / SZ-STL5LED

Réglage de la tension du bras



- Cet instrument a été développé pour pouvoir régler la résistance à l'inclinaison du bras à la fois latéralement et de haut en bas, avec une amplitude de mouvement maximale de 90 degrés dans les deux directions. Il est possible de contrôler le niveau de résistance de l'articulation du bras
1. Si l'articulation du support mural a tendance à s'abaisser automatiquement, vous devrez peut-être régler sa tension pour remettre votre microscope dans la position souhaitée en utilisant l'orientation vers le haut ou vers le bas. Pour ce faire, utiliser la clé hexagonale de 6 mm pour augmenter la résistance de l'articulation et fixer la position, régler la vis de tension à tête hexagonale M5x15 mm positionnée sur les côtés de l'articulation à l'aide de la clé hexagonale de 6 mm. (Fig. 75)

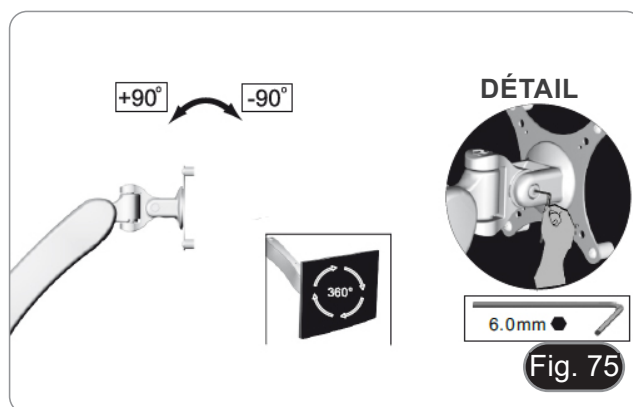

2. Pour augmenter ou diminuer la résistance de l'articulation rotative et permettre au microscope de pivoter latéralement, réglez la vis de tension hexagonale située à l'avant de l'articulation du bras pour définir la position. (Fig. 76)
3. Pour augmenter la résistance, serrez la vis de tension hexagonale M5x15mm à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour diminuer la résistance, desserrez la vis de tension à l'aide de la clé hexagonale fournie en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

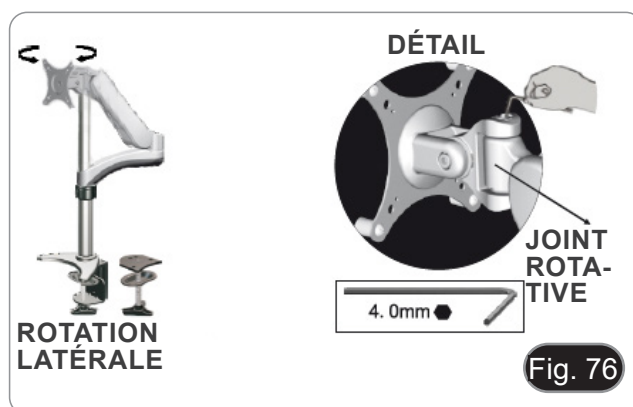

4. L'instrument peut monter ou descendre comme indiqué. (Fig. 77)
- S'il a tendance à se déplacer automatiquement sur le côté, vous devrez peut-être ajuster la tension de l'articulation du bras pour permettre à votre microscope de tourner sur le côté. Ceci est possible en utilisant la clé Allen de 2,5 mm fournie. (Fig. 78)

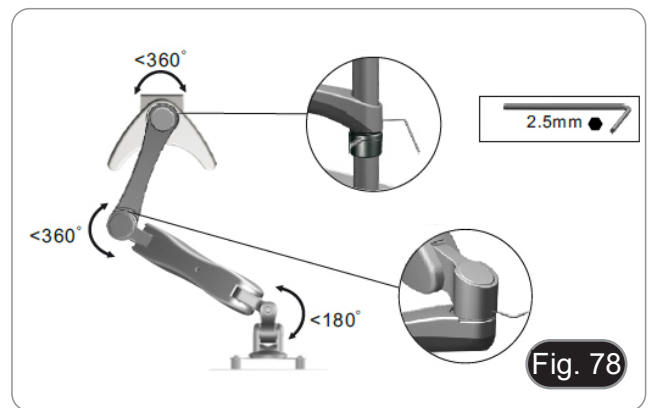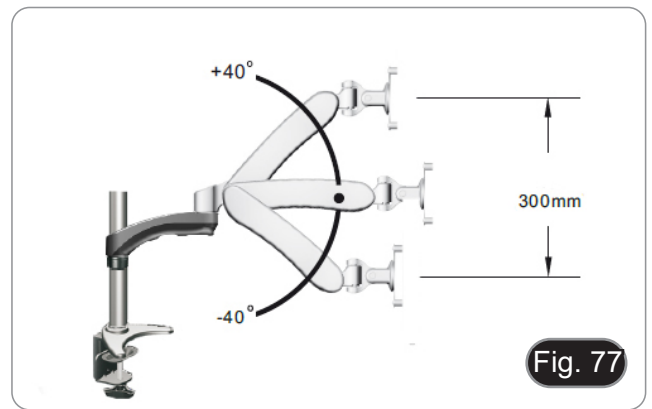

Réglage de la luminosité


Tournez les boutons de réglage ① pour allumer/éteindre et augmenter/diminuer l'intensité lumineuse de chaque bras LED individuel. (Fig. 79)



10. Microphotographie

10.1 Utilisation des caméras avec monture "C"

1. Desserrer la vis de fixation ① à la jointure du tube et enlever le couvercle de protection noir ②. (Fig. 80)

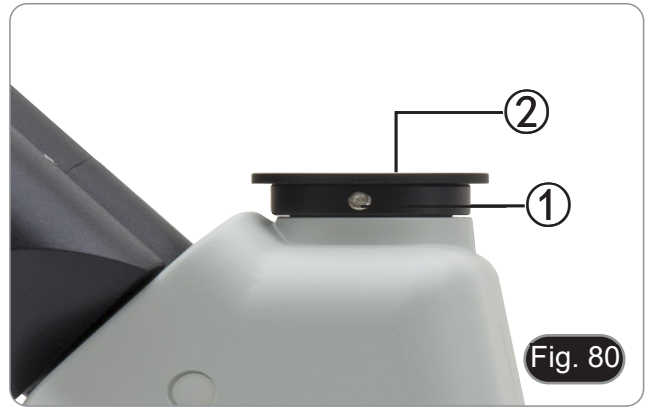

2. Visser l'adaptateur de monture C ③ sur la caméra ④ et insérer le support rond du montage C dans le tube trinoculaire (Fig. 81), puis resserrer la vis de fixation ①.



10.2 Utilisation des caméras Reflex

1. Insérer l'adaptateur Reflex ① dans le tube de connexion ②.
2. Visser l'anneau "T2" ③ (non fournie) sur l'adaptateur reflex.
3. Unir l'appareil photo Reflex ④ à l'anneau "T2" juste assemblé. (Fig. 82).
4. Monter l'extrémité du tube de connexion ② dans le trou vide du tube trinoculaire, puis serrer la vis de serrage. (Fig. 80)
 - L'anneau "T2" n'est pas fourni avec le microscope, mais est disponible dans le commerce.
 - Pour photographier des préparations sombres, assombrissez les oculaires et le viseur avec un chiffon foncé pour limiter la lumière diffusée.
 - Pour calculer le grossissement de l'appareil photographique il faut: grossissement de l'objectif * grossissement de l'appareil * grossissement de la lentille.
 - **Si vous utilisez un appareil reflex, le mouvement du miroir peut faire vibrer l'appareil.**
 - **Il est conseillé de soulever le miroir, et d'utiliser une télécommande en pose longue.**



11. Réparation et entretien

Environnement de travail

Il est conseillé d'utiliser le microscope dans un environnement propre et sec, protégé des impacts, à une température comprise entre 0°C y 40°C et avec une humidité relative maximale de 85% (en absence de condensation). Il est conseillé d'utiliser un déshumidificateur si nécessaire.

Conseils avant et après l'utilisation du microscope



- Maintenir le microscope toujours en position verticale lorsque vous le déplacez.
- Assurez vous que les pièces mobiles (oculaires) ne tombent pas.
- Manipulez avec attention le microscope en évitant de le forcer.
- Ne réparez pas le microscope vous même.
- Éteindre immédiatement la lumière après avoir utilisé le microscope, couvrez le avec la housse prévue à cet effet et conservez le dans un endroit propre et sec.

Précaution de sécurité sur le système électrique



- Avant de connecter le câble d'alimentation sur le réseau électrique assurez vous que la tension d'entrée soit compatible avec celle de l'appareil et que l'interrupteur de l'éclairage soit en position arrêt.
- L'utilisateur devra consulter les normes de sécurités de son pays.
- L'appareil inclût une étiquette de sécurité C.E. Dans tous les cas, l'utilisateur assume toute responsabilité relative à l'utilisation sûre de l'appareil.

Nettoyage des optiques

- Si vous souhaitez nettoyer les optiques, utilisez dans un premier temps de l'air comprimé.
- Si cela n'est pas suffisant, utilisez alors un chiffon non effiloché, humidifié avec un peu d'eau et avec un détergent délicat.
- Comme dernière option, il est possible d'utiliser un chiffon humide avec une solution de 3:7 d'éthanol et d'éther.
- **Attention: l'éthanol et l'éther sont des substances hautement inflammables. Ne les utilisez pas près d'une source de chaleur, d'étincelles ou d'appareils électriques. Les substances chimiques doivent être utilisées dans un environnement aéré.**
- Ne pas frotter la superficie d'aucun des composants optiques avec les mains.
- Les empreintes digitales peuvent endommager les parties optiques.

Pour les meilleurs résultats, utiliser le kit de nettoyage OPTIKA (voir le catalogue).

Conserver l'emballage d'origine dans le cas où il serait nécessaire de retourner le microscope au fournisseur pour un entretien ou une réparation.

12. Guide résolution des problèmes

Passer en revue les informations dans le tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes opérationnels.

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
I. Section Optique:		
La lampe est allumée mais le champ visuel est sombre.	Les câbles d'alimentation ne sont pas branchés correctement. Les connecteurs ne sont pas bien raccordés	Brancher les correctement
	L'intensité lumineuse est trop faible	Procéder au réglage
Les bords du champ de vision sont vignettés ou la luminosité est asymétrique	L'illuminateur de lumière incidente n'est pas correctement orienté	Modification de l'angle de l'illuminateur d'incident
Des saletés ou des poussières sont présentes dans le champ visuel lorsque vous regarder dans l'oculaire.	L'échantillon est sale	Nettoyer l'échantillon
	L'oculaire est sale	Nettoyer l'oculaire
Mauvaise qualité d'image <ul style="list-style-type: none"> • L'image n'est pas nette. • Le contraste est faible. • Les détails sont indistincts. • Réflexions dans l'image 	Les lentilles (lentilles supplémentaires, oculaires) sont sales.	Nettoyer les composants optiques.
La mise au point n'est pas homogène	L'échantillon n'est pas dans la bonne position (par ex. inclinée).	Déplacer l'échantillon jusqu'à trouver la position idéale
II. Section Mécanique:		
Commande macrométrique dur à tourner.	Le col de réglage de la tension est trop serré	Desserrer le col de réglage de la tension
Mise au point instable	Le col de réglage de la tension est trop desserré	Serrer le col de réglage de la tension
III. Section Électrique		
La lampe n'allumera pas	Pas d'alimentation électrique	Vérifier la connexion du câble d'alimentation
L'éclairage n'est pas assez.	L'intensité lumineuse est faible	Ajuster l'éclairage
Éclairs de lumière.	Connexion incorrecte du câble	Contrôler câble d'alimentation
IV. Tube d'observation		
Champ visuel différent d'un oeil à l'autre.	Distance interpupillaire incorrecte	Réglage distance interpupillaire
	Correction dioptrique incorrecte	Réglage correction dioptrique
	Observation technique incorrecte, efforts visuels de l'opérateur	Observation à travers l'objectif, ne pas fixer l'échantillon mais observer tout le champ visuel. De temps en temps éloigner les yeux, regarder un objet distant, et retourner à l'objectif
V. Microphotographie et vidéo:		
Les bords de l'image sont flous	Relatif en substance à la nature des objectifs achromatiques généralement	Minimiser le problème par un réglage correcte du diaphragme d'ouverture
Rais lumineux sur l'image.	Entrée de lumière diffuse dans le microscope à travers les oculaires et le viseur de la caméra	Couvrir les oculaires et le viseur avec un pan de tissu obscur

Ramassage

Conformément à l'Article 13 du D.L du 25 Juillet 2005 n°151

Action des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans l'appareil électrique et électronique et à l'élimination des résidus.



Le Symbole du conteneur qui figure sur l'appareil électrique ou sur son emballage indique que le produit devra être, à la fin de sa vie utile, séparé du reste des résidus. La gestion du ramassage sélectif du présent instrument sera effectuée par le fabricant. Par conséquent, l'utilisateur qui souhaite éliminer l'appareil devra se mettre en contact avec le fabricant et suivre le système que celui-ci a adopté pour permettre le ramassage sélectif de l'appareil. Le ramassage sélectif correct de l'appareil pour son recyclage, traitement et élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise sa réutilisation et/ou recyclage des composants de l'appareil. L'élimination du produit de manière abusive de la part de l'utilisateur entraînera l'application de sanctions administratives sur la norme en vigueur.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain
spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA
usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China
china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® India
india@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Central America
camerica@optikamicroscopes.com

SZ-Serie

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell	
SZ-A1	SZ-A6
SZX-B	SZX-T
SZX-BA	SZX-TA
SZO-B	SZO-T
SZ-ST1	SZ-ST2
SZ-ST3	SZ-ST7
SZ-ST8	SZ-OBL
ST-150	ST-152
SZ-STL1	SZ-STL2
SZ-STLX	SZ-STL5
SZ-STL5LED	

Ver. 2.3 2022



Inhalt

1.	Hinweis	212
2.	Sicherheitsinformationen	212
3.	Verpackungsinhalt	213
3.1	SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA	213
3.2	SZO-B / SZO-T	214
3.3	SZ-A1	214
3.4	SZ-A6	215
3.5	ST-150	215
3.6	ST-152	216
3.7	SZ-ST1	216
3.8	SZ-ST2 / SZ-ST3	217
3.9	SZ-ST7 / SZ-ST8	217
3.10	SZ-OBL	218
3.11	SZ-STL1	218
3.12	SZ-STL2	219
3.13	SZ-STLX	219
3.14	SZ-STL5	220
3.15	SZ-STL5LED	221
4.	Auspacken	222
5.	Verwendung	222
6.	Wartung- und Gefahrzeichen	222
7.	Beschreibung des Instruments	223
7.1	Systemdiagramm	223
7.2	SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA	224
7.3	SZO-B / SZO-T	224
7.4	SZ-A1	225
7.5	SZ-A6	225
7.6	ST-150	226
7.7	ST-152	226
7.8	SZ-ST1	227
7.9	SZ-ST2 / SZ-ST3	227
7.10	SZ-ST7 / SZ-ST8	228
7.11	SZ-OBL	228
7.12	SZ-STL1	229
7.13	SZ-STL2	229
7.14	SZ-STLX	230
7.15	SZ-STL5	230
7.16	SZ-STL5LED	231
8.	Montage	232
8.1	SZ-A1 / SZ-A6	232
8.2	SZ-ST1 / ST-150	232
8.3	ST-152	232
8.4	SZ-ST2 / SZ-ST3	232
8.5	SZ-ST7 / SZ-ST8 / SZ-OBL	233
8.6	SZ-STL1	233
8.7	SZ-STL2	236
8.8	SZ-STLX	238
8.9	SZ-STL5 / SZ-STL5LED	241
8.10	Kopf montieren (alle Modelle)	242
8.11	Okulare montieren (alle Modelle)	242
8.12	Installieren den Foto-Ausgang (SZX-T/TA)	242
9.	Verwendung des mikroskops	244
9.1	Einstellen des Augenabstandes	244
9.2	Fokussierung	244
9.3	Einstellen der Fokusspannung	244
9.3.1	SZ-A1	244
9.3.2	SZ-A6	244
9.4	Fokussperre Hebel (SZ-A6)	245
9.5	Dioptrienkompensation	245
9.6	Vergrößerung	246
9.7	Verwendung zusätzlicher Objektive	246
9.8	Verwendung zusätzlicher Objektive 0.3X-0.5X	247

9.9	Schwarz/weiß Platte (SZ-ST1 / 2 / 3 / 7 / 8)	247
9.10	Verwendung der Beleuchtung (SZ-ST2 / 3 / 7 / 8)	248
9.11	Verwendung der Beleuchtung (SZ-OBL)	248
9.12	Verwendung von Augenschirmen (SZO-B / T)	248
9.13	Verwendung von Kragarmstützen	250
9.13.1	SZ-STL1	250
9.13.2	SZ-STL2	251
9.13.3	SZ-STLX	252
9.13.4	SZ-STL5 / SZ-STL5LED	254
10.	Mikrofotografie	256
10.1	Verwendung von C-Mount Kameras	256
10.2	Verwendung von Spiegelreflexkameras	256
11.	Wartung	257
12.	Probleme und Lösungen	258
	Wiederverwertung	259

1. Hinweis

Dieses Mikroskop ist ein wissenschaftliches Präzisionsgerät, es wurde entwickelt für eine jahrelange Verwendung bei einer minimalen Wartung. Dieses Gerät wurde nach den höchsten optischen und mechanischen Standards und zum täglichen Gebrauch hergestellt. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur korrekten und sicheren Benutzung des Geräts. Diese Anleitung soll allen Benutzern zur Verfügung stehen.

Wir lehnen jede Verantwortung für eine fehlerhafte, in dieser Bedienungsanleitung nicht gezeigten Verwendung Ihrer Produkte ab.

2. Sicherheitsinformationen



Elektrische Entladung verhindern

Bevor Sie das Netzkabel anstecken, vergewissern Sie sich, dass die Spannung für das Mikroskop geeignet ist und dass der Beleuchtungsschalter sich in Position OFF befindet.

Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften des Arbeitsplatzes, an dem Sie mit dem Mikroskop arbeiten. Das Gerät entspricht den CE-Normen. Die Benutzer tragen während der Nutzung des Geräts die volle Verantwortung dafür.

3. Verpackungsinhalt

3.1 SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA



① Körpermikroskop

• SZX-B/BA Binokular / SZX-T/TA Trinokular

② Okulare

③ Inbusschrauben (nur für SZX-T/TA)

④ Staubschutzhaube

⑤ Foto-Ausgabering (nur für SZX-T/TA)


3.2 SZO-B / SZO-T



- ① Körpermikroskop
- SZO-B Binokular / SZO-T Trinokular
- ② Okulare


- ③ Inbusschrauben (nur für SZO-T)
- ④ Staubschutzhaube
- ⑤ Foto-Tubus (nur für SZO-T)

3.3 SZ-A1

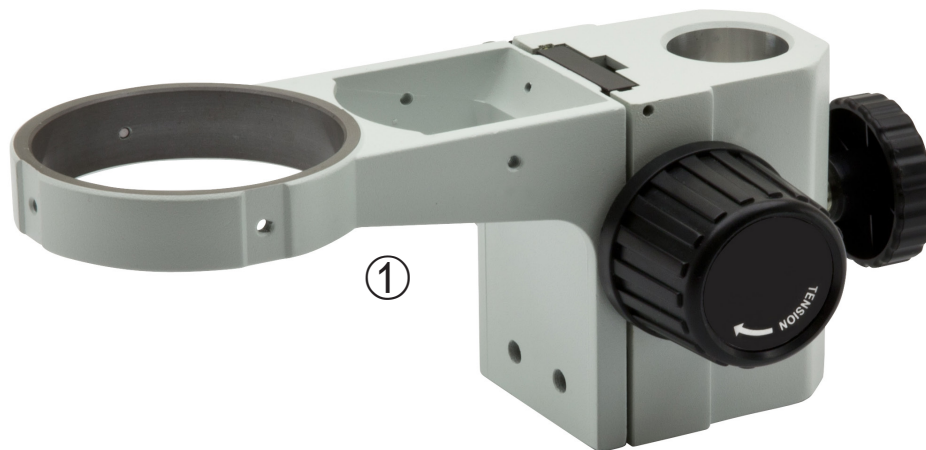

- ① Makro-Fokus

3.4 SZ-A6

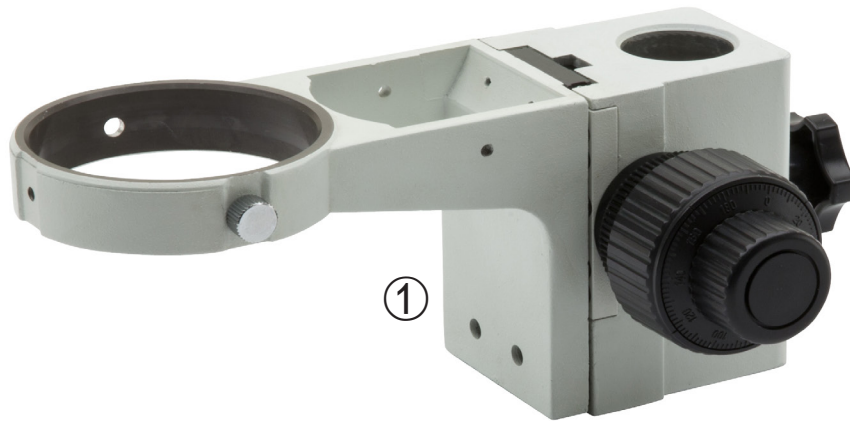

① Macro-micro Fokus

3.5 ST-150




① Base

② Kopfhaltung / Fokussystem

③ Stütze

④ Staubschutzhaube

3.6 ST-152

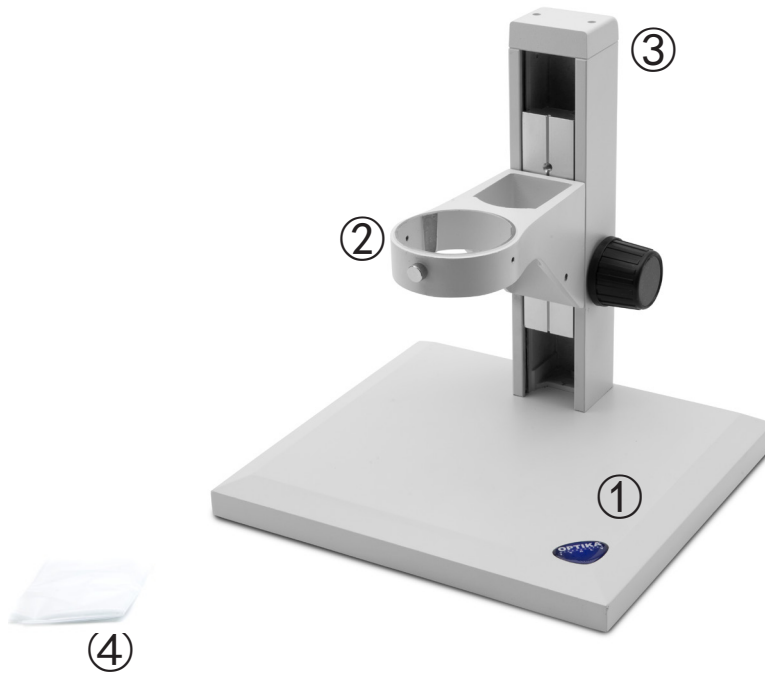

① Base

② Kopfhaltung / Fokussystem

③ Stütze

④ Staubschutzhaube

3.7 SZ-ST1



① Base

② Muster-Clips (ein Paar)

③ Weiß / schwarze Scheibe

3.8 SZ-ST2 / SZ-ST3



- ① Base
- ② Opale Scheibe
- ③ Muster-Clips (ein Paar)

- ④ Aufsichtbeleuchtung
- ⑤ Weiß / schwarze Scheibe
- ⑥ Netzteile

3.9 SZ-ST7 / SZ-ST8



- ① Base
- ② Opale Scheibe
- ③ Bühnenclips (ein Paar)

- ④ Weiß / schwarze Scheibe
- ⑤ Netzteile


3.10 SZ-OBL



- ① Base
- ② Stütze
- ③ Glasplatte

- ④ Netzteile
- ⑤ Staubschutzhülle


3.11 SZ-STL1

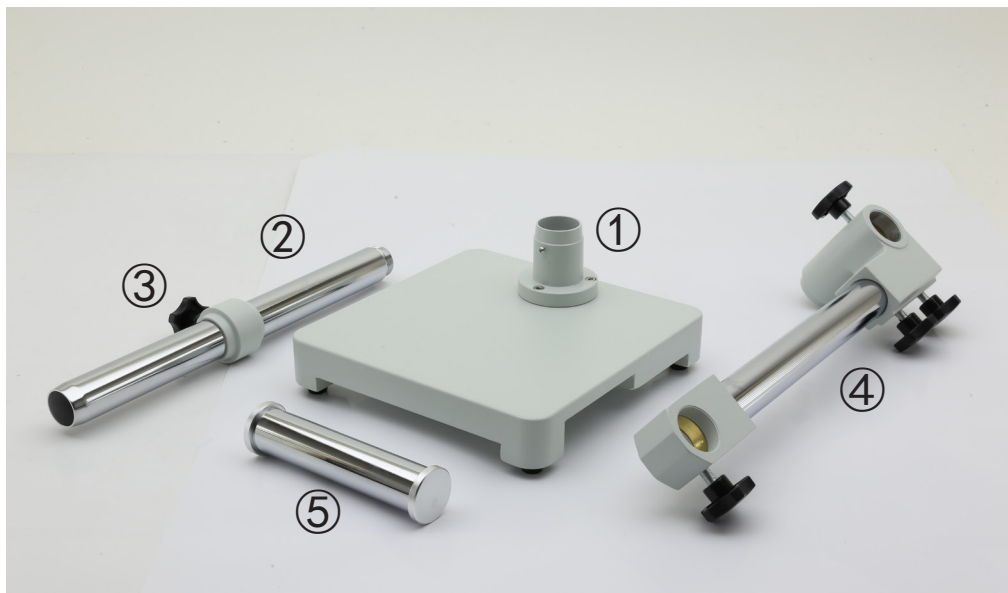

- ① Base
- ② Vertikaler Arm
- ③ Absturzsicherungsring

- ④ Horizontaler Arm
- ⑤ Stützarm-Fokussiersystem

3.12 SZ-STL2

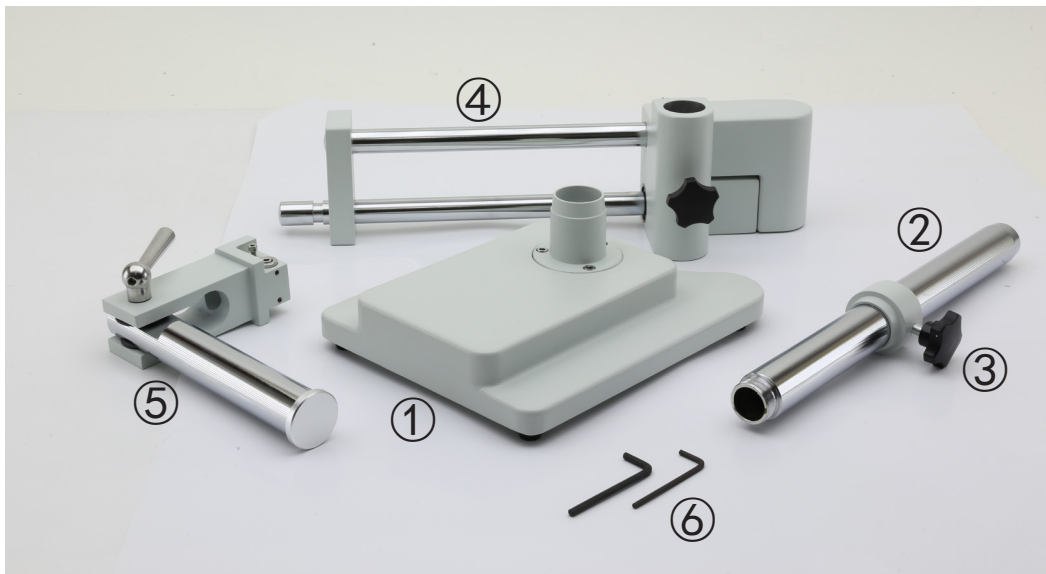



- ① Base
- ② Vertikaler Arm
- ③ Absturzsicherungsring
- ④ Horizontaler Arm
- ⑤ Stützarm-Fokussiersystem
- ⑥ Inbusschrauben

3.13 SZ-STLX



- ① Base
- ② Vertikaler Arm
- ③ Horizontaler Arm
- ④ Absturzsicherungsring
- ⑤ Fokussiersystem
- ⑥ Inbusschrauben

3.14 SZ-STL5

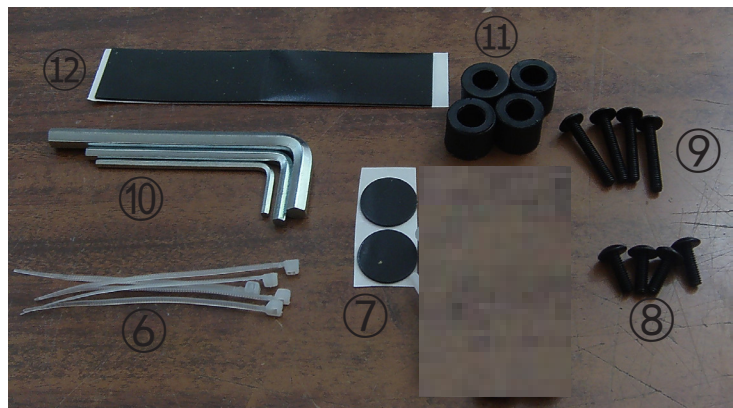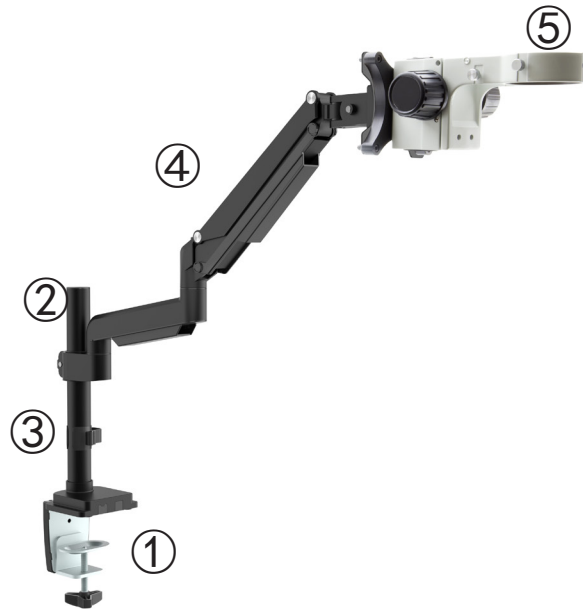

- ① Tischklemme
- ② Stütze
- ③ Absturzsicherungsring
- ④ Horizontaler Arm
- ⑤ Kopfhalterung / Fokussystem
- ⑥ Kabelklemmen
- ⑦ Runde Dichtung

- ⑧ Kurze Schrauben M4x12 mm (4 Stück)
- ⑨ Lange Schrauben M4x25 mm (4 Stück)
- ⑩ Inbusschrauben
- ⑪ GummifüÙe (4 Stück)
- ⑫ Rechteckige Dichtung
- ⑬ Tischklemme für große Dicken

3.15 SZ-STL5LED



- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① Tischklemme | ⑨ Runde Dichtung |
| ② Stütze | ⑩ Kurze Schrauben M4x12 mm (4 Stück) |
| ③ Absturzsicherungsring | ⑪ Lange Schrauben M4x25 mm (4 Stück) |
| ④ Horizontaler Arm | ⑫ Inbuschrauben |
| ⑤ Kopfhaltung / Fokussystem | ⑬ GummifüÙe (4 Stück) |
| ⑥ LED-Selbsttragende Arme | ⑭ Rechteckige Dichtung |
| ⑦ Beleuchtungssteuergerät mit Stromversorgung | ⑮ Tischklemme für große Dicken |
| ⑧ Kabelklemmen | |

4. Auspacken

Das Mikroskop ist in einer Schachtel aus Styroporschicht enthalten. Entfernen Sie das Klebeband von der Schachtel und öffnen Sie mit Vorsicht den oberen Teil, ohne Objektive und Okulare zu beschädigen. Mit beiden Händen (eine um dem Stativ und eine um der Basis) ziehen Sie das Mikroskop aus der Schachtel heraus und stellen Sie es auf eine stabile Oberfläche.



Berühren Sie optische Oberflächen wie Linsen, Filter oder Glas nicht mit bloßen Händen. Spuren von Fett oder anderen Rückständen können die endgültige Bildqualität beeinträchtigen und die Optikoberfläche in kurzer Zeit angreifen.

5. Verwendung

Standardmodelle

Nur für Forschung und Lehre verwenden. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Tieren oder Menschen bestimmt.

IVD-Modelle

Auch für diagnostische Zwecke, um Informationen über die physiologische oder pathologische Situation des Patienten zu erhalten.

6. Wartung- und Gefahrzeichen

Die folgende Tabelle zeigt die Symbole, die in dieser Anleitung verwendet werden.



VORSICHT

Dieses Symbol zeigt eine potentielle Gefahr und warnt, mit Vorsicht zu verfahren.



ELEKTRISCHE ENTLADUNG

Dieses Symbol weist auf eine Gefahr von Stromschlägen.

7. Beschreibung des Instruments

7.1 Systemdiagramm



7.2 SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA




7.3 SZO-B / SZO-T




7.4 SZ-A1




7.5 SZ-A6

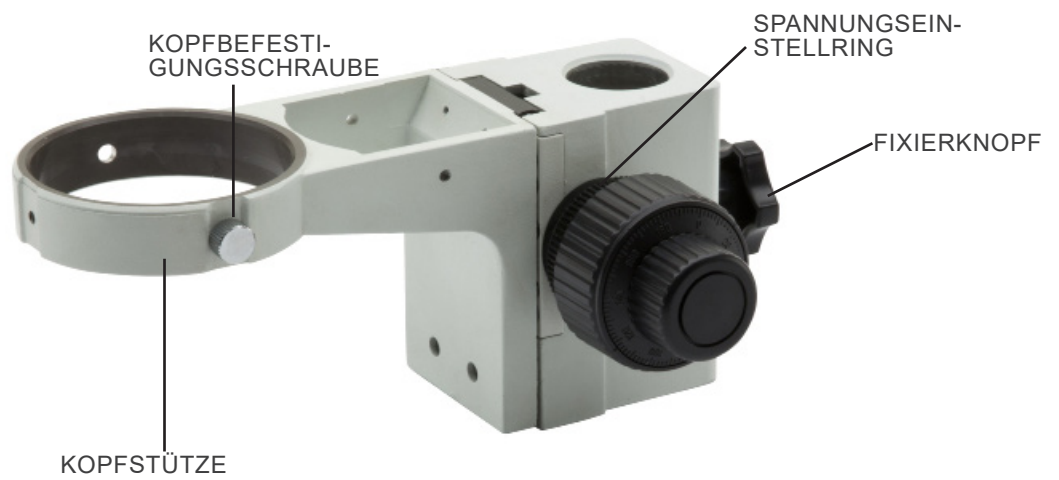


7.6 ST-150

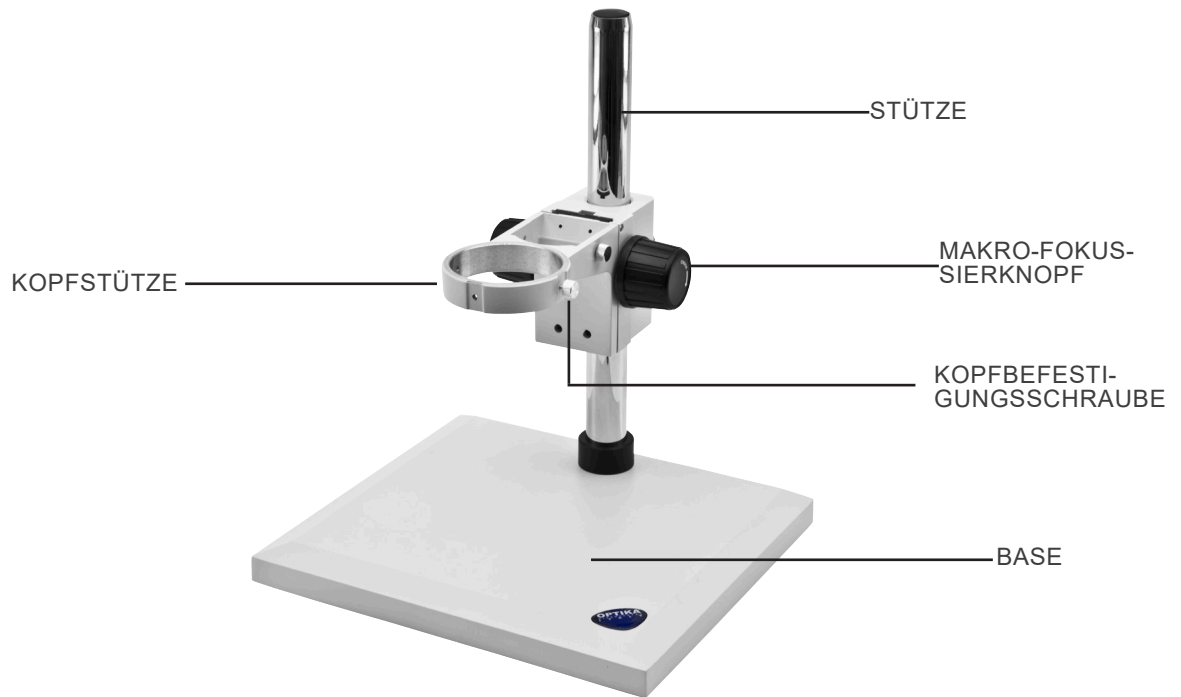

7.7 ST-152

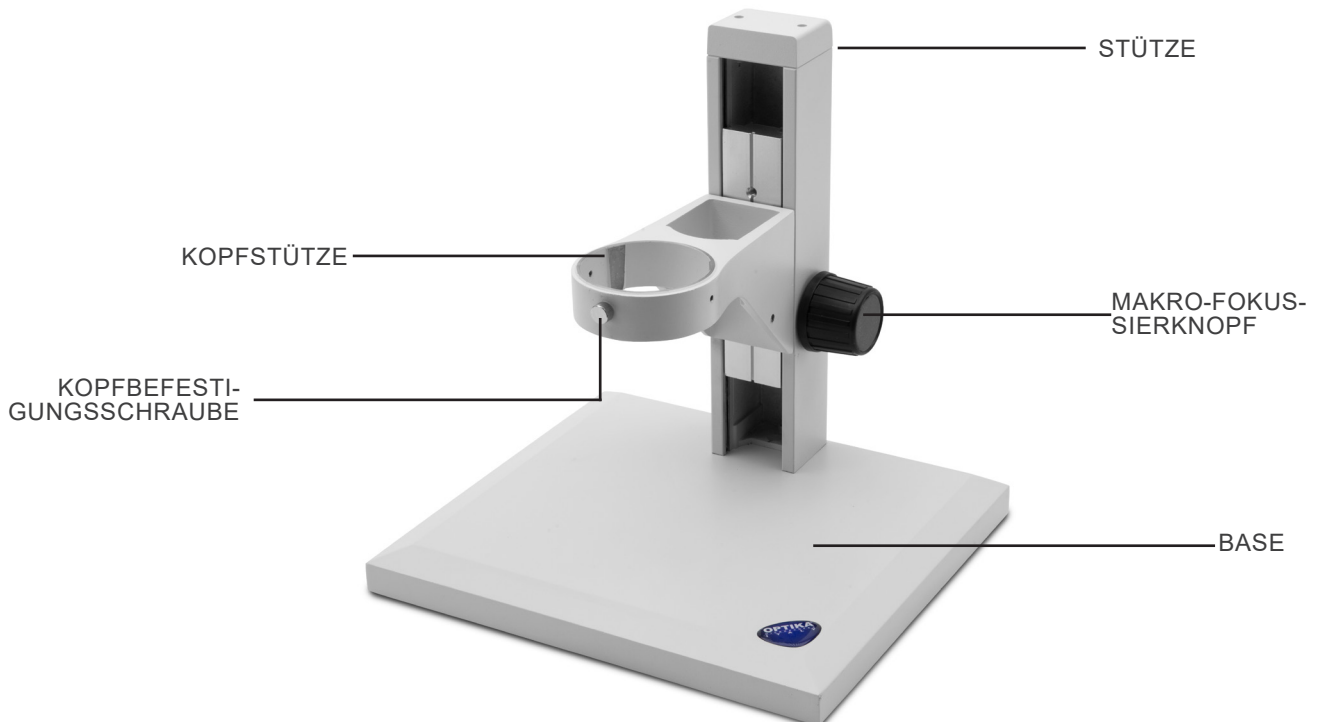


7.8 SZ-ST1

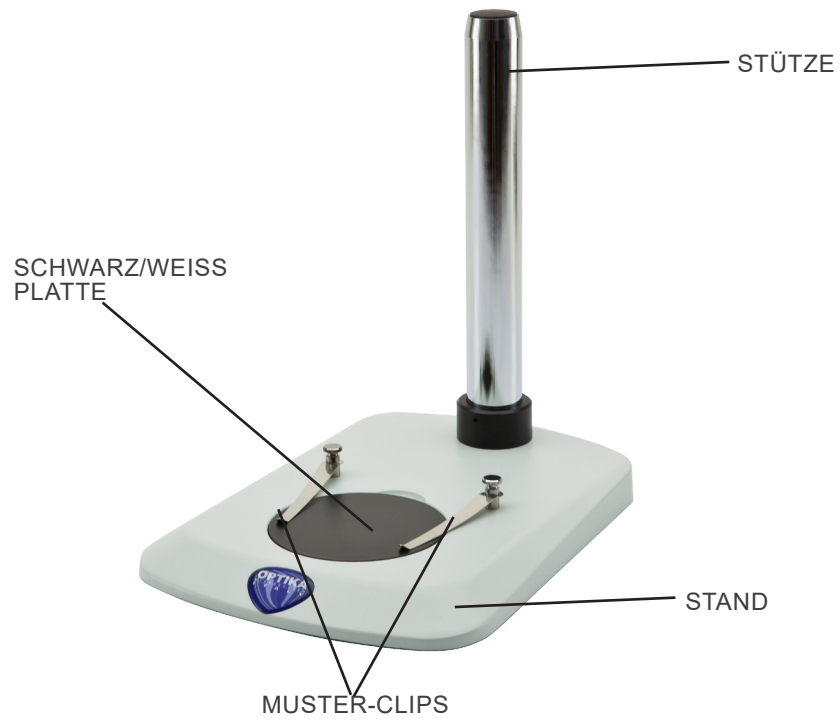


7.9 SZ-ST2 / SZ-ST3




7.10 SZ-ST7 / SZ-ST8

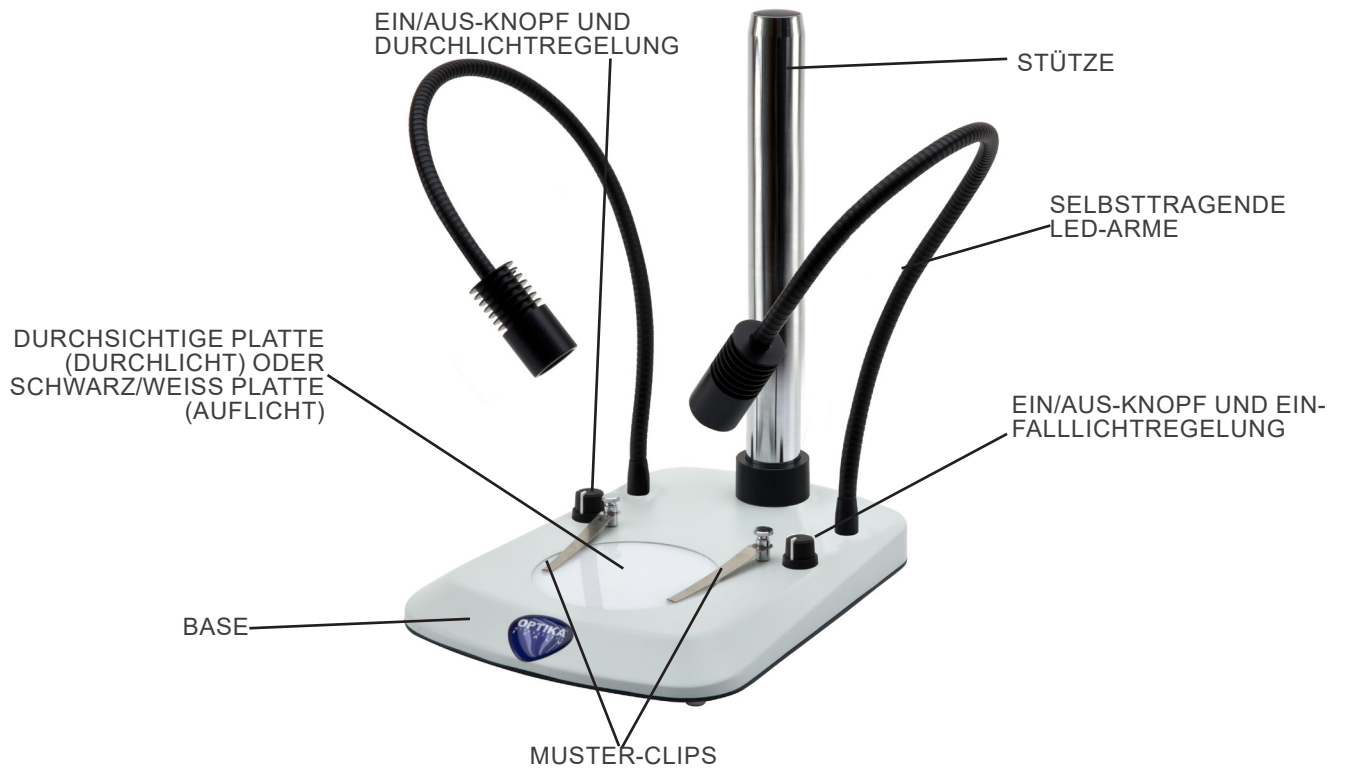


7.11 SZ-OBL

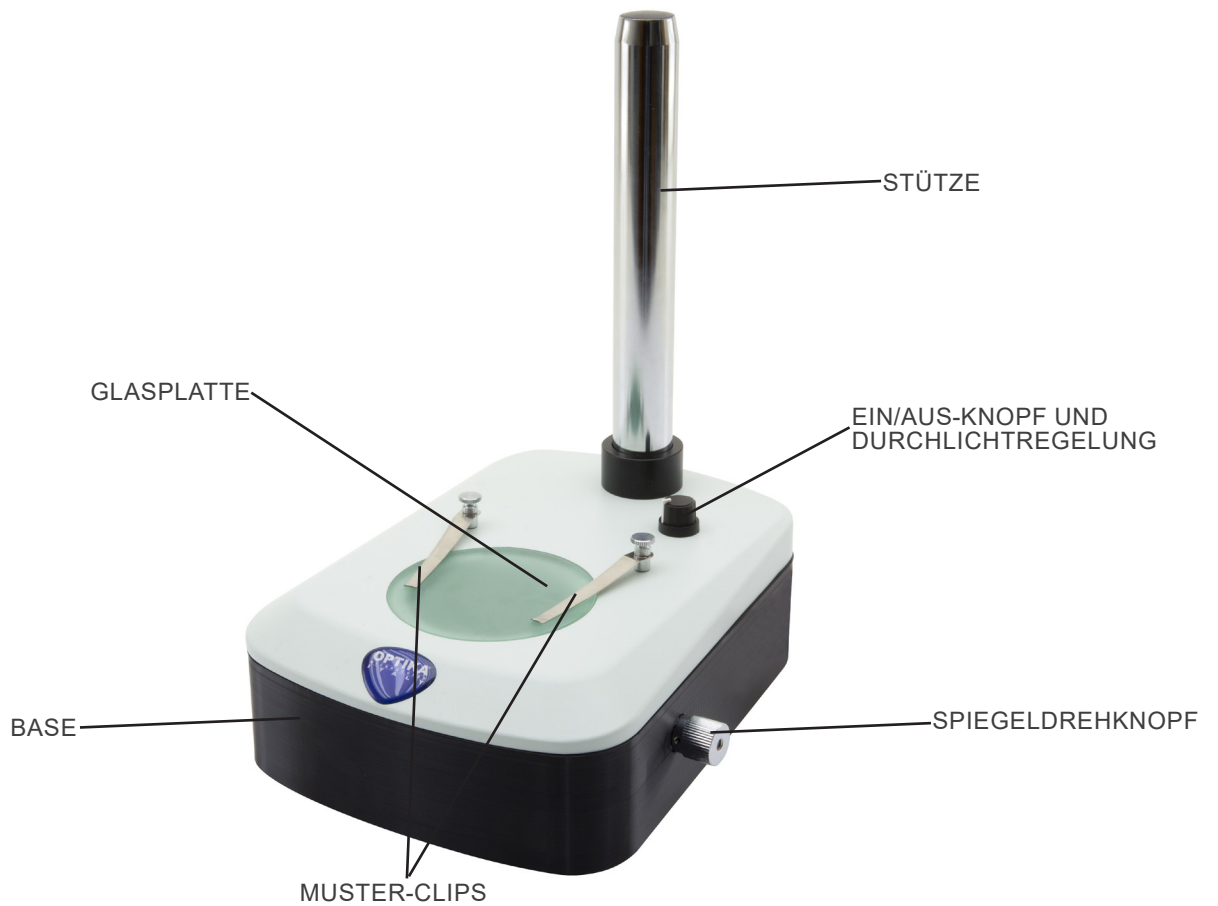


7.12 SZ-STL1

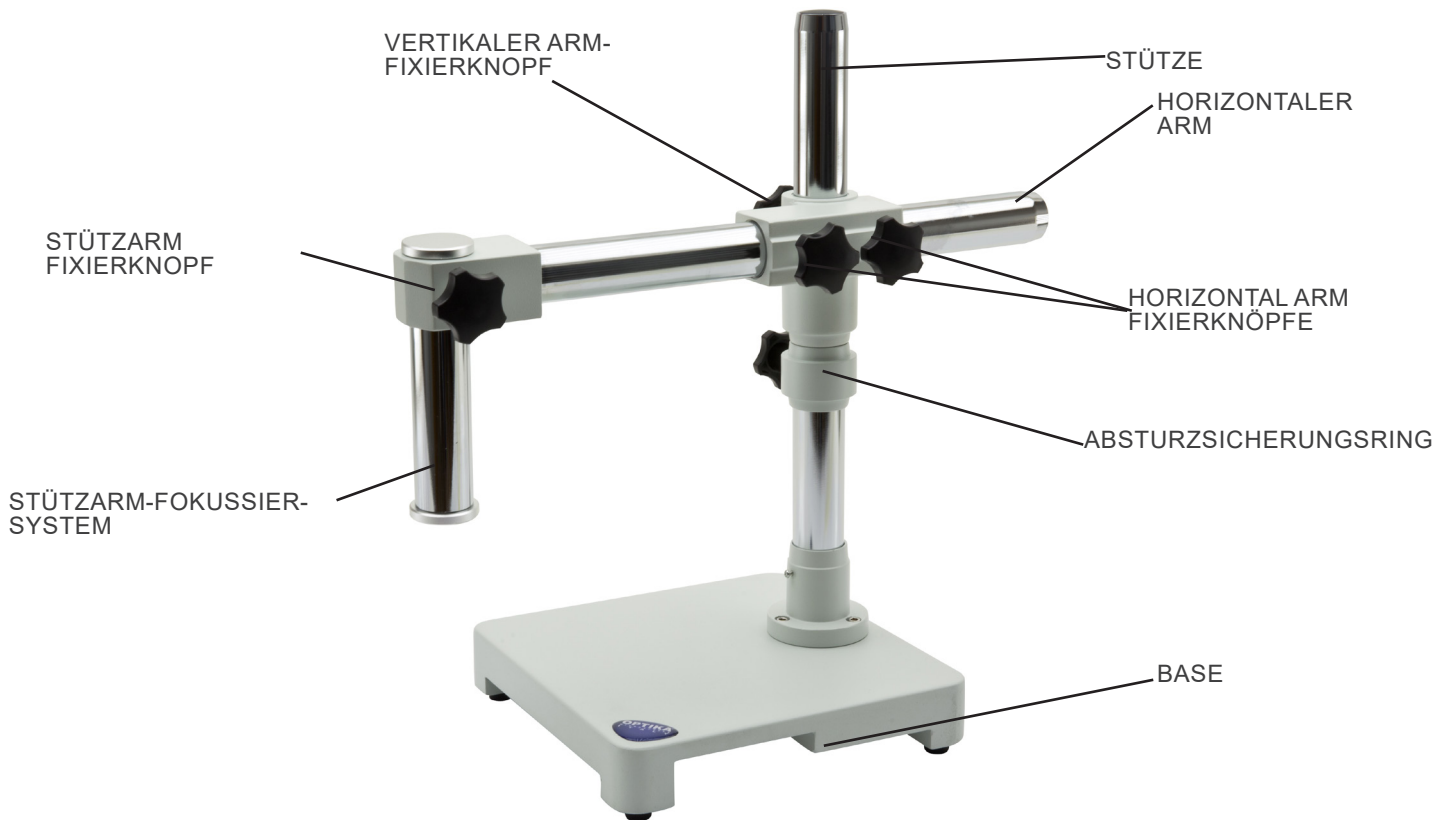


7.13 SZ-STL2

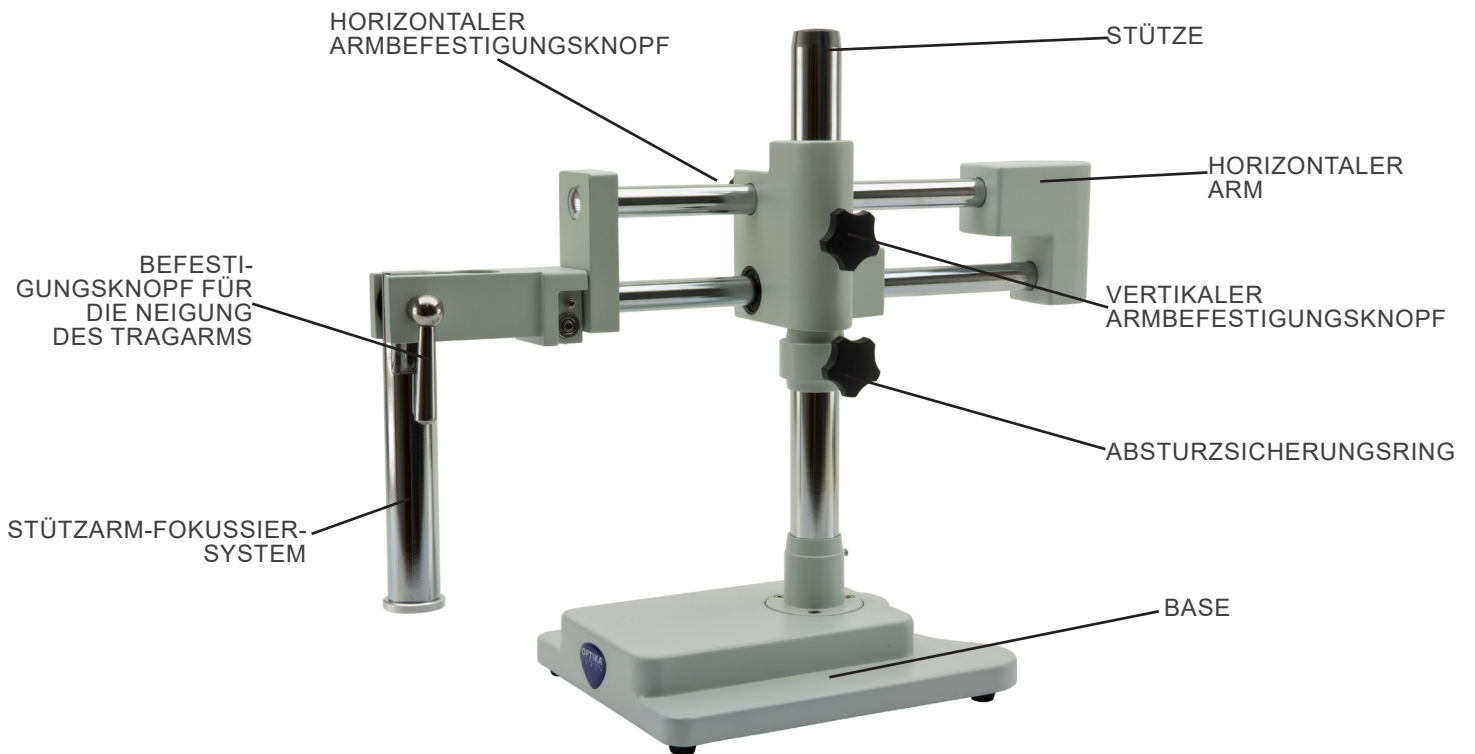

7.14 SZ-STLX

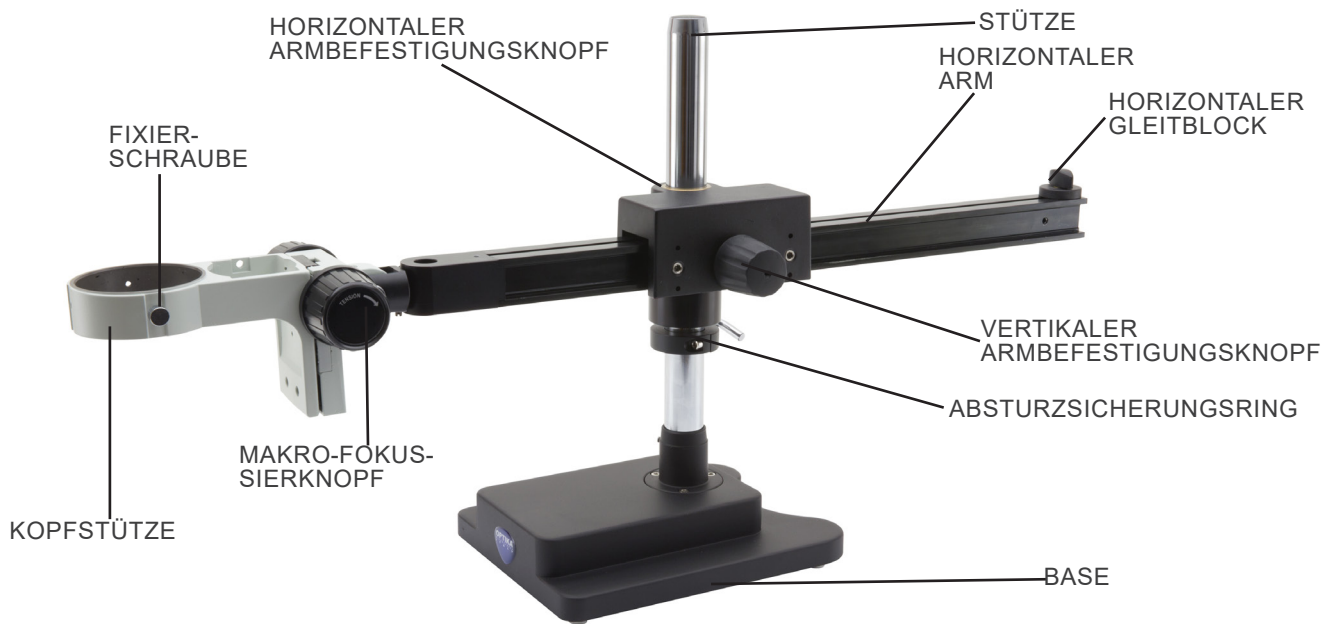

7.15 SZ-STL5

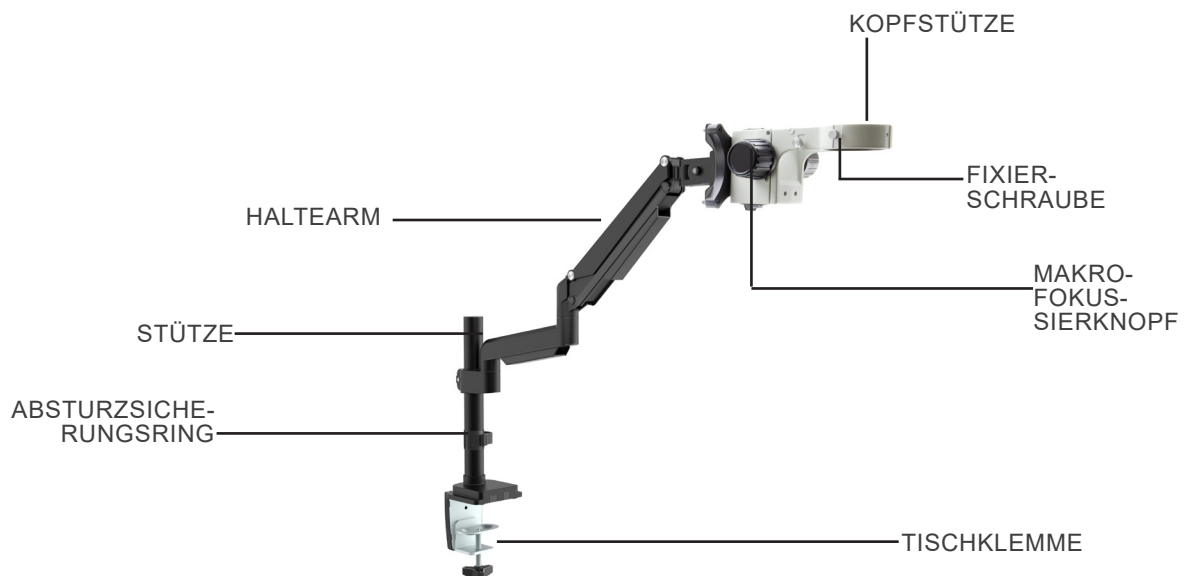

7.16 SZ-STL5LED



8. Montage

8.1 SZ-A1 / SZ-A6


- Die Montage der Fokussiersysteme SZ-A1 und SZ-A6 gilt für alle Sockel außer ST-152, SZ-STL1, SZ-STL2, SZ-STLX und SZ-STL5. Für die Montage auf diesen Sockeln beachten bitte den jeweiligen Abschnitt.
- Stellen das Fokussiersystem auf die Säule und ziehen, sobald die gewünschte Höhe erreicht ist, den Verriegelungsknopf ① auf der Rückseite des Fokussiersystems fest. (Fig. 1)

8.2 SZ-ST1 / ST-150

- Nehmen den Boden aus der Verpackung und legen ihn auf eine ebene Fläche. Die Basis ist bereits ab Werk montiert und erfordert keine weiteren Montagearbeiten außer der Montage des Fokussiersystems.

8.3 ST-152

- Nehmen die Basis aus der Verpackung und legen sie auf eine ebene Fläche. Die Basis ist bereits ab Werk montiert und erfordert keine weitere Montage.

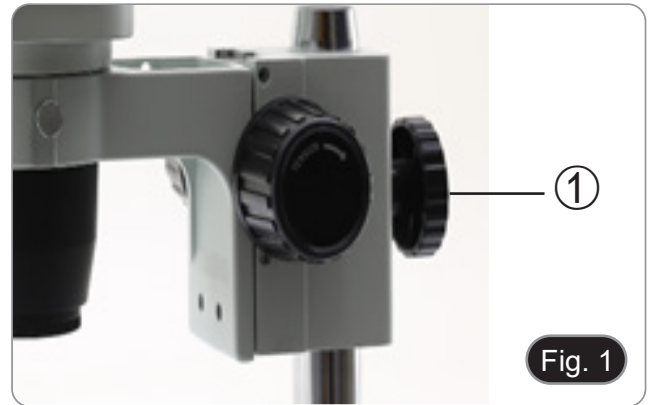


8.4 SZ-ST2 / SZ-ST3

- Installieren den LED-Strahler für Auflicht wie in Fig. 2 gezeigt.
- Durch Lösen der Befestigungsschraube ② können den Neigungswinkel des Strahlers verändern, um die Ausleuchtung der Probe zu optimieren.



- Den Gerätestecker in den Stecker an der Oberseite der Säule ③ stecken. (Fig. 3)

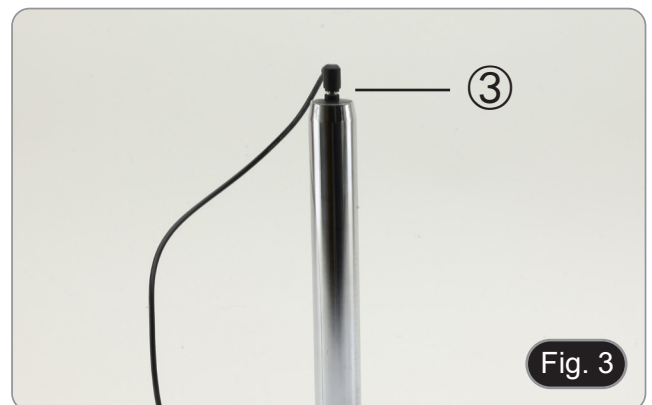

3. Schließen den Netzstecker an den Anschluss auf der Rückseite des Mikroskopstativs an. (Fig. 4)



8.5 SZ-ST7 / SZ-ST8 / SZ-OBL

1. Nehmen den Boden aus der Verpackung und legen ihn auf eine ebene Fläche. Die Basis ist bereits ab Werk montiert und erfordert keine weiteren Montagearbeiten außer der Montage des Fokussiersystems.
2. Schließen den Netzstecker an den Anschluss auf der Rückseite des Mikroskopstativs an. (Fig. 4)

8.6 SZ-STL1

1. Schrauben die Säule an den Sockel. (Fig. 5)



2. Ziehen die Schrauben an, um die Säule zu sichern. (Fig. 6)



3. Setzen den Absturzsicherungsring ein und befestigen ihn in der gewünschten Höhe durch Aufschrauben des Befestigungsknopfes. (Fig. 7)



4. Setzen den Horizontalarm ein und sichern ihn mit der Befestigungsschraube ①. (Fig. 8 - 9)



5. Montieren den Kopfhalter. Lösen den Verriegelungsknopf ③ und stecken den Arm für die Fokussierhilfe von oben ② in die Bohrung des Horizontalarms. (Fig. 10)



6. Nach dem vollständigen Einsetzen die Befestigungsschraube ④ sichern. (Fig. 11)



7. Setzen das Fokussiersystem von unten ein, ziehen die Befestigungsschraube ⑤ an und ziehen den Verriegelungsknopf ③ von unten wieder an. (Fig. 12-13)



8.7 SZ-STL2

1. Schrauben die Säule an den Sockel. (Fig. 14)



2. Ziehen die Schrauben an, um die Säule zu sichern. (Fig. 15)




3. Setzen den Absturzsicherungsring ein und befestigen ihn in der gewünschten Höhe durch Aufschauben des Befestigungsknopfes. (Fig. 16)




4. Setzen den Horizontalarm ein und sichern ihn mit der Befestigungsschraube ① (Fig. 17).



5. Zur zusätzlichen Sicherheit ziehen die Befestigungsschraube ② mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel an. (Fig. 18)

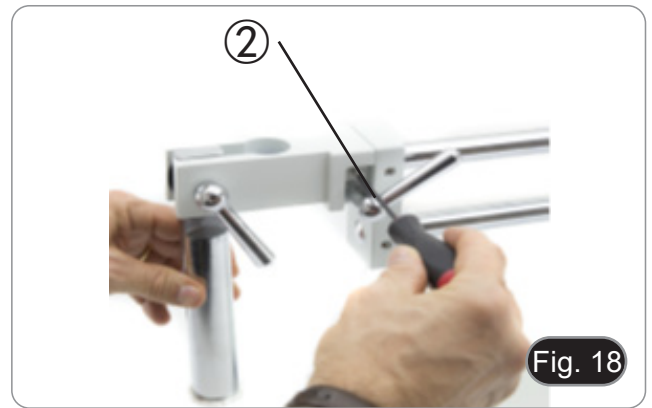

6. Installieren das Fokussiersystem. Lösen den Verriegelungsknopf ③ und setzen die Halterung ④ von unten in den Vertikalarm ein. Schrauben anschließend den Verriegelungsknopf ③ wieder auf. (Fig. 19-20)

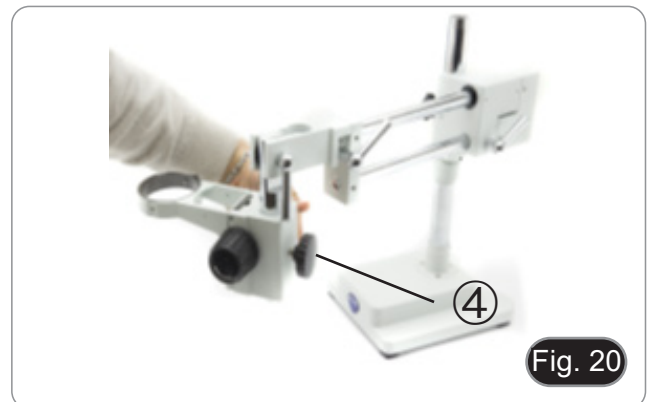

8.8 SZ-STLX

1. Schrauben die Säule an den Sockel. (Fig. 21)



2. Ziehen die Schrauben an, um die Säule zu sichern. (Fig. 22)



3. Setzen den Absturzsicherungsring ein und befestigen ihn in der gewünschten Höhe durch Aufschauben des Befestigungsknopfes. (Fig. 23)



4. Setzen den Horizontalarm ein und sichern ihn mit der Befestigungsschraube ①. (Fig. 24)




5. Der Kopfhalter kann je nach den spezifischen Bedürfnissen des Benutzers auf unterschiedliche Weise installiert werden.

Installationsmodus Nr. 1: (Fig. 25-27)

Den hinteren Teil der Kopfstütze (schwarzer Rundteil) ③ (Fig. 25) von oben in die Bohrung des Horizontalarms ④ einsetzen und den Sicherungsknopf ② von unten einschrauben.

- **Dieser Modus ermöglicht die Installation von schweren Köpfen (oder mit schweren Kameras, die über dem Kopf installiert sind).**

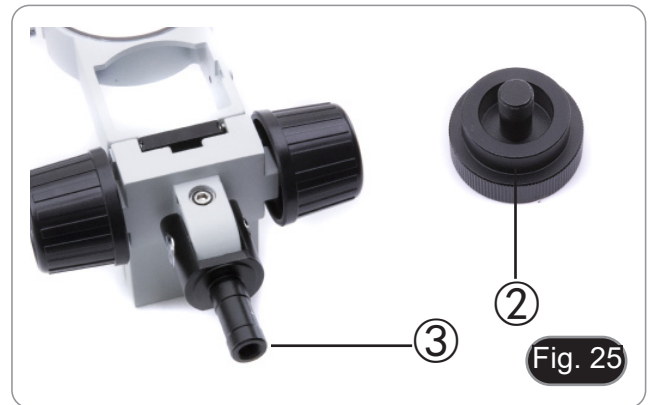

Installationsmodus Nr. 2: (Fig. 28-29)

Den hinteren Teil der Kopfstütze (schwarzer Rundteil) ③ (Fig. 28) von unten in das Loch im Horizontalarm einsetzen und den Sicherungsknopf ② von oben einschrauben.



- Diese beiden Modi ermöglichen das Kippen des Kopfes. (Fig. 29)



Installationsmodus Nr. 3: (Fig. 30)

Den hinteren Teil der Kopfstütze (schwarzer Rundteil) ③ (Fig. 25) in die Bohrung am Ende des Horizontalarms einsetzen und den Knopf ⑤ anziehen.




- In diesem Modus können den Kopf neigen. (Fig. 31)



8.9 SZ-STL5 / SZ-STL5LED


1. Passen die Höhe der Tischklemme ① an die Tischoberfläche an. (Fig. 32)

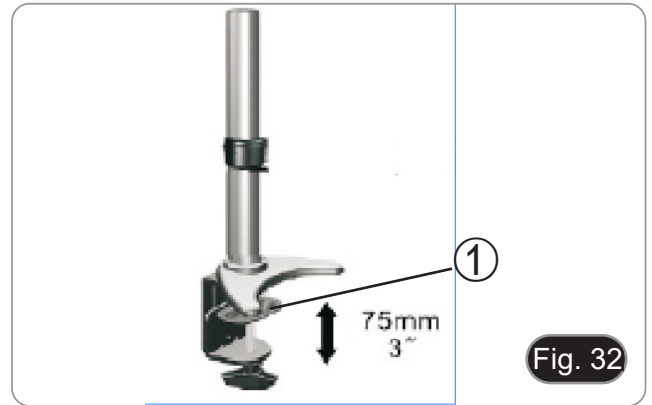


2. Tischklemme ① in der gewünschten Position und mit der Klemmenöffnung zur Tischplattenkante zeigend an der Tischkante befestigen (Fig. 33). Ziehen den Drehknopf ② von Hand an, um sicherzustellen, dass die Tischklemme vollständig an der Tischoberfläche klemmt und sicher ist. (Fig. 34)



3. Um die Manschette in der gewünschten Höhe zu positionieren, müssen die Manschette wie abgebildet lockern. Ziehen Sie die Manschette von Hand fest, bis sie fest sitzt. (Fig. 35)

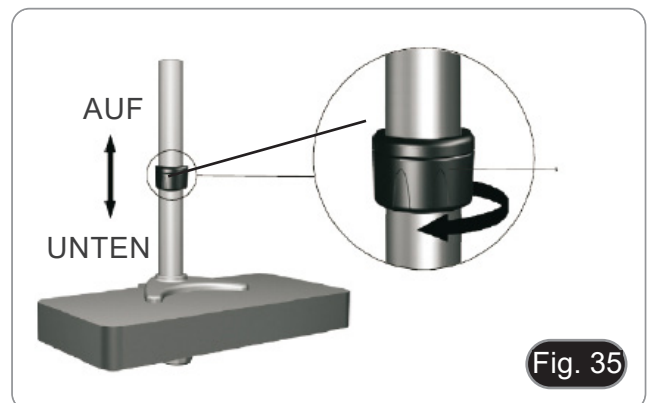

4. Montieren den Fokus mit den mitgelieferten Schrauben und dem Inbusschlüssel am Arm. (Fig. 36)

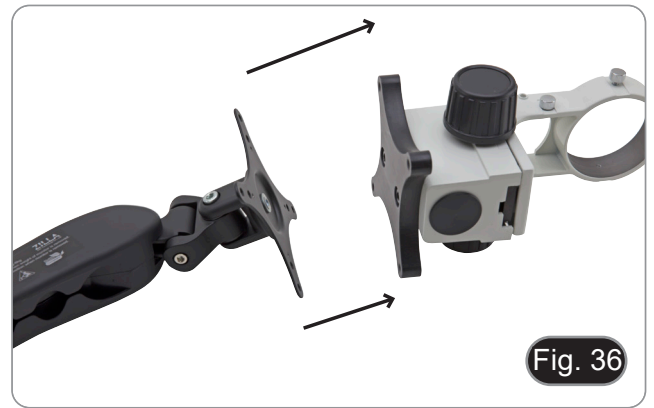

8.10 Kopf montieren (alle Modelle)

- Setzen den Kopf ein und sichern die Verriegelungsschraube. (Fig. 37)




8.11 Okulare montieren (alle Modelle)

1. Entfernen die Staubschutzkappen von den Okularhaltern und setzen die Okulare ein. (Fig. 38)
2. Verriegeln die Okulare, indem die Sicherungsschraube ① anziehen.




8.12 Installieren den Foto-Ausgang (SZX-T/TA)

1. Lösen die Befestigungsschrauben ① des mitgelieferten Foto-Ausgangs und entfernen den vorhandenen Foto-Ausgang. (Fig. 39)

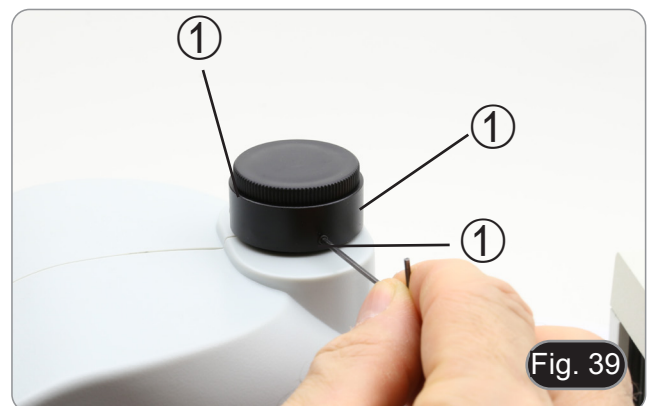

2. Setzen den Ring des Fotoausgangs ② ein und achten darauf, dass die Befestigungsschraube des Fotoadapters ③ nach rechts zeigt. (Fig. 40)
3. Ziehen die Befestigungsschrauben ① an. (Fig. 39)

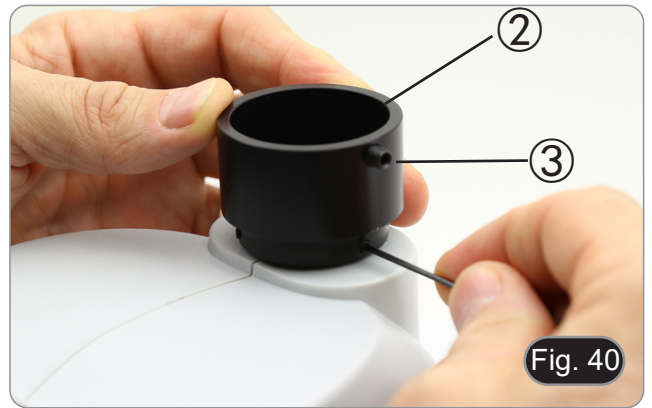


9. Verwendung des Mikroskops

9.1 Einstellen des Augenabstandes

1. Halten den linken und rechten Okularhalter mit beiden Händen und stellen den Augenabstand durch Bewegen der Röhren ein, bis nur noch ein Bild zu sehen ist. (Fig. 41).

 - Wenn man sich zwei Bilder ansieht, ist der Abstand zu groß.
 - Betrachtet man zwei sich überlappende Kreise, ist der Abstand zu klein.

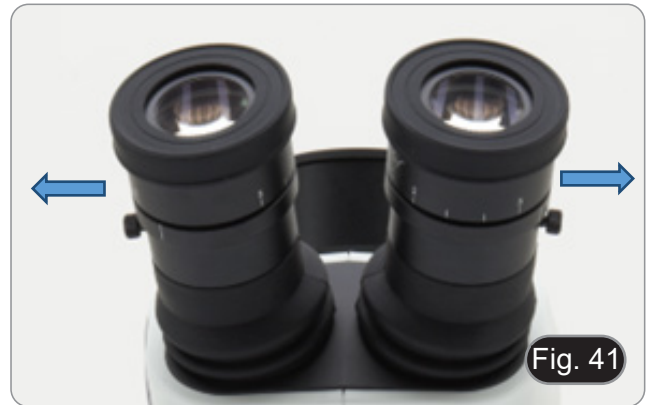

9.2 Fokussierung

1. Legen die zu beobachtende Probe auf die Platte und fokussieren mit den Fokussierknöpfen auf dem Stativ ①.

 - Falls erforderlich, stellen die Höhe des Mikroskopstativs entlang der vertikalen Säule ein.
 - Nach der Höhenverstellung die Verriegelungsschraube ② sichern. (Fig. 42)




9.3 Einstellen der Fokusspannung

- Mit dieser Einstellung können die Spannung der Fokussierknöpfe erhöhen oder verringern, um ein unerwünschtes Absinken des Mikroskops unter seinem Eigengewicht zu vermeiden. Stellen die Spannung knapp über dem Fokusstabilitätspunkt ein.


9.3.1 SZ-A1

Fassen die Knöpfe ③ mit beiden Händen und drehen den rechten Knopf, während den linken Knopf halten. Je nach Drehrichtung des rechten Knopfes erhöht oder verringert sich die Spannung. (Fig. 43)

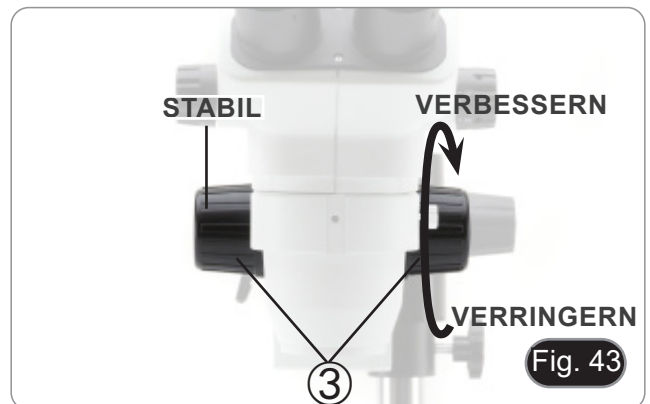


9.3.2 SZ-A6

Drehen den Einstellring ④ im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Spannung erreicht ist. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn sinkt die Spannung, was zu einem Verlust des Fokus führt. (Fig. 44)

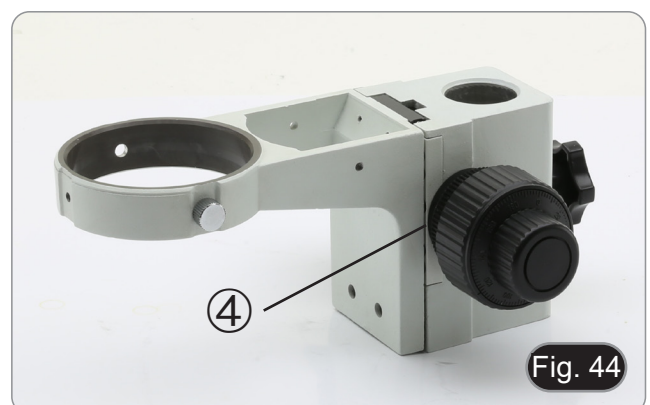

9.4 Fokussperre Hebel (SZ-A6)

- Der Verriegelungshebel dient als Fokusspeicherfunktion.
- 1. Nach dem Fokussieren der Probe ziehen den Hebel ① zur Vorderseite des Mikroskops und verriegeln ihn (Fig. 45).
- Hiermit wird der obere Fokussierpunkt definiert.
- 2. Jetzt können den Fokus des Mikroskops mit dem makrometrischen Drehknopf bewegen, die Probe ersetzen und das System wieder auf den oberen Punkt bringen: Die Probe ist ungefähr scharf und müssen nur noch eine Feineinstellung vornehmen, um den optimalen Fokus zu erhalten.
- Die Mikrometerbewegung wird durch den Fokusblock nicht beeinflusst.
- **Um das Schloss zu entfernen, bewegen den Hebel in die entgegengesetzte Richtung zu demjenigen, der für das Schloss verwendet wird.**

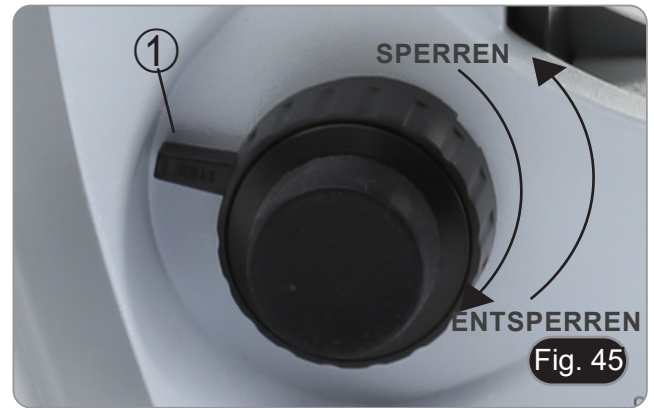

9.5 Dioptrienkompensation

- **Diese Kompensation ermöglicht es Brillenträgern, das Mikroskop an ihr Sehvermögen anzupassen und das Mikroskop ohne Brille zu benutzen.**
- 1. Zoom auf minimale Vergrößerung ② und Fokussierung mit den Fokussierknöpfen ③. (Fig. 46)
- 2. Bringen den Zoom auf maximale Vergrößerung und fokussieren ihn wieder.
- 3. Rückkehr zur minimalen Vergrößerung: Die Probe ist unscharf.
- 4. Stellen den dioptrischen Einstellring des rechten Okulars ④ so ein, dass das betrachtete Bild scharf und fokussiert ist (Fig. 47). Wiederholen den Vorgang mit dem linken Okularring.
- 5. Überprüfen nun den Fokus des Samples über den gesamten Zoombereich. Das System ist nun perfekt parfokal (der Fokus bleibt während des Vergrößerungswechsels erhalten).



9.6 Vergrößerung

1. Wählen Sie die gewünschte Vergrößerung mit dem Zoomschalter ② aus. (Fig. 48)
- Verwenden bei Bedarf andere Okulare und/oder eine entsprechende Zusatzlinse, um die gewünschte Vergrößerung zu erreichen.
 - **Nur Serie SZO:** Das Gehäuse des Mikroskops ist mit einer "Klickstopp"-Funktion ausgestattet, die eine präzise Vergrößerung ermöglicht (Fig. 43). Der Klickstopp kann durch Einstecken des mitgelieferten Inbusschlüssels in die Bohrung auf der rechten Seite des Mikroskops aktiviert oder deaktiviert werden.



Fig. 48

9.7 Verwendung zusätzlicher Objektive

1. Schrauben die Zusatzlinse an das Stativ des Mikroskops. (Fig. 49)
- Jedes Objektiv hat einen bestimmten Arbeitsabstand.
 - Der Hub der Fokussierhilfe kann die unterschiedlichen Arbeitsabstände der verschiedenen Zusatzlinsen nicht ausgleichen.
 - Wenn die Fokussierhilfe die Probe nicht fokussiert, muss das gesamte Gehäuse des Mikroskops angehoben oder abgesenkt werden.

Auf diese Weise wird die Gesamtvergrößerung berechnet:
Okularvergrößerung * Zoomvergrößerung * Zusätzliche Objektivvergrößerung.



Fig. 49

Serie SZX (0.67x - 4.5x / F.N. 22mm)

Okular	10x		15x		20x		25x	
Feld Nummer (mm)	22		16		12		9	
Objektiv	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)
0.3X	2.01X-13.5X	109.45-16.30	3.02X-20.25X	79.60-11.85	4.02X-27X	59.70-8.89	5.03X-33.75X	44.78-6.67
0.5X	3.35X-22.5X	65.67-9.78	5.03X-33.75X	47.76-7.11	6.7X-45X	35.8-5.33	8.38X-56.25X	26.87-4.00
0.75X	5.03X-33.75X	43.78-6.52	7.54X-50.63X	31.84-4.74	10.05X-67.5X	23.88-3.56	12.56X-84.37X	17.91-2.67
1X	6.7X-45X	32.84-4.89	10.05X-67.5X	23.88-3.56	13.4X-90X	17.91-2.67	16.75X-112.5X	13.43-2.00
1.5X	10.05X-67.5X	21.89-3.26	15.08X-101.25X	15.92-2.37	20.1X-135X	11.94-1.78	25.13X-168.75X	8.96-1.33
2X	13.4X-90X	16.42-2.44	20.1X-135X	11.94-1.78	26.8X-180X	8.96-1.33	33.5X-225X	6.72-1.00

Serie SZX-A (0.65x - 5.5x / F.N. 23mm)

Okular	10x		15x		20x		25x	
Feld Nummer (mm)	23		16		12		9	
Objektiv	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)
0.3X	1.95X-16.5X	117.95-13.94	2.93X-24.75X	82.05-9.70	3.9X-33X	61.54-7.27	4.88x-41.25x	46.15-5.45
0.5X	3.25X-27.5X	70.77-8.36	4.88X-41.25X	49.23-5.82	6.5X-55X	36.92-4.36	8.13x-68.75X	27.69-3.27
0.75X	4.88X-41.25X	47.18-5.58	7.31X- 61.88X	32.82-3.88	9.75X-82.5X	24.62-2.91	12.19x-103.13X	18.46-2.18
1X	6.5X-55X	35.38-4.18	9.75X-82.5X	24.62-2.91	13X-110X	18.46-2.18	16.25X-137.5X	13.85-1.64
1.5X	9.75X-82.5X	23.59-2.79	14.63X-123.75X	16.41-1.94	19.5X-165X	12.31-1.45	24.38X-206.25X	9.23-1.09
2X	13X-110X	17.69-2.09	19.5X-165X	12.31-1.45	26X-220X	9.23-1.09	32.5X-275X	6.92-0.82

Serie SZO (0.67x - 4.5x / F.N. 23mm)

Okular	10x		15x		20x		25x	
Feld Nummer (mm)	23		16		12		9	
Objektiv	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)
0.3X	2.01X-13.5X	114.43-17.04	3.02X-20.25X	79.60-11.85	4.02X-27X	59.70 -8.89	5.03X-33.75X	44.78-6.67
0.5X	3.35X-22.5X	68.66-10.22	5.03X-33.75X	47.76-7.11	6.7X-45X	35.82-5.33	8.38X-56.25X	26.87-4.00
0.75X	5.03X-33.75X	45.77-6.81	7.54X- 50.63X	31.84-4.74	10.05X-67.5X	23.88-3.56	12.56X-84.38X	17.91-2.67
1X	6.7X-45X	34.33-5.11	10.05X-67.5X	23.88-3.56	13.4X-90X	17.91-2.67	16.75X-112.5X	13.43-2.00
1.5X	10.05X-67.5X	22.89-3.41	15.08X-101.25X	15.92-2.37	20.1X-135X	11.94-1.78	25.13X-168.75X	8.96-1.33
2X	13.4X-90X	17.16-2.56	20.1X-135X	11.94-1.78	26.8X-180X	8.96-1.33	33.5X-225X	6.72-1.00

9.8 Verwendung zusätzlicher Objektive 0.3X-0.5X

Die Zusatzlinsen 0.3X und 0.5X haben einen großen Arbeitsabstand und können daher den Gesamthub der Fokussiersäule nicht kompensieren.

Damit die zusätzlichen Linsen 0.3X und 0.5X korrekt funktionieren, gehen wie folgt vor:

1. Schrauben die Zusatzlinse wie in Abschnitt 9.7 beschrieben ein.
2. Entfernen das Mikroskopstativ aus dem Halter.
3. Montieren den Abstandshalter ① in die Kopfstütze und ziehen die Befestigungsschraube ② an. (Fig. 50)
4. Montieren das Mikroskopstativ wieder am Abstandshalter und ziehen die Befestigungsschraube ③ an. (Fig. 51)
5. Beginnen mit der normalen Arbeit.



9.9 Schwarz/weiß Platte (SZ-ST1 / 2 / 3 / 7 / 8)


Sie können eine Schwarz/Weiß-Kontrastscheibe verwenden, um den Kontrast des Bildes beim Arbeiten im Auflicht zu erhöhen. (Fig. 52).

Wenn auf helle Proben schauen, legen die Scheibe mit dem schwarzen Teil nach oben.



9.10 Verwendung der Beleuchtung (SZ-ST2 / 3 / 7 / 8)

1. Schalten den Knopf für das Durchlicht ② ein/aus oder stellen die Intensität des LED-Lichts für das Durchlicht ein. (Fig. 53)
2. Schalten den Knopf für das Auflicht ① ein/aus oder stellen die Intensität des LED-Lichts für das Auflicht ein.
- Beide Beleuchtungen können gleichzeitig verwendet werden.

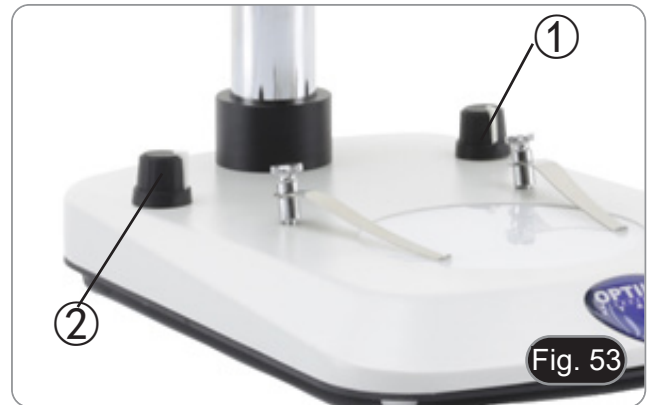

Nur für SZ-ST7 / SZ-ST8:

- Kippen und positionieren die selbsttragenden Arme der Basis ③, um die Probe optimal auszuleuchten. (Fig. 54)
- Die Arme können einzeln in die gewünschte Position gebracht werden.



9.11 Verwendung der Beleuchtung (SZ-OBL)

1. Schalten den Knopf für das Durchlicht ① ein/aus oder stellen die Intensität des LED-Lichts für das Durchlicht ein. (Fig. 55)
2. Drehen den Spiegeldrehknopf ②, um den Spiegel zu kippen, bis die gewünschte schräge Beleuchtung erreicht ist.
- Der Spiegel hat eine glatte Oberfläche und eine gerändelte Oberfläche. Die beiden Oberflächen ermöglichen eine optimale Beobachtung durch einen angemessenen Kontrast in Abhängigkeit von der zu beobachtenden Probe.



9.12 Verwendung von Augenschirmen (SZO-B / T)

• Zur Verwendung mit einer Brille

Falten die Gummi-Augenschilde mit beiden Händen. Gefaltete Augenschirme vermeiden das Verkratzen der Gläser einer Brille. (Fig. 56)



- **Verwendung ohne Brille**

Augenschirme anheben und am Mikroskop beobachten, um die Augen auf die Schirme zu richten, wobei Fremdlicht vermieden wird, das die Beobachtung stört. (Fig. 57)



9.13 Verwendung von Kragarmstützen

9.13.1 SZ-STL1

Bewegen den horizontalen Arm

1. Lösen die Knöpfe auf der rechten Seite des horizontalen Arms ①. (Fig. 58)



2. Der Arm kann je nach Bedarf verlängert oder verkürzt werden. (Fig. 59)




Ändern des Winkels des Kopfes

1. Lösen die Knöpfe ① und drehen den Kopf in den gewünschten Winkel (rechts oder links), dann ziehen die Befestigungsschraube an. (Fig. 60)



Drehen den horizontalen Arm


1. Lösen die Befestigungsschraube des Horizontalarms ② und drehen den Arm, dann ziehen die Befestigungsschraube an. (Fig. 61)
- **HINWEIS:** Wenn das Mikroskop um 180° von der Basis aus drehen, kann das gesamte System umkippen.

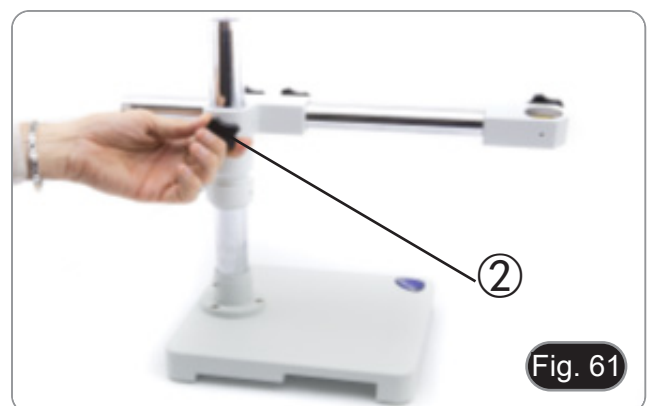

9.13.2 SZ-STL2

Bewegen den horizontalen Arm

1. Lösen den Knopf auf der linken Seite des horizontalen Arms ①. (Fig. 62)

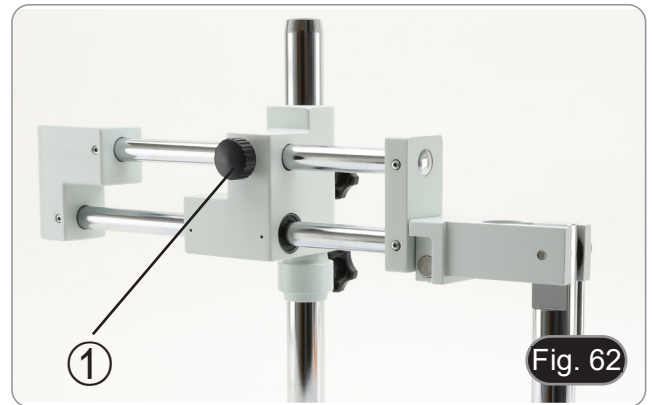

2. Der Arm kann je nach Bedarf verlängert oder verkürzt werden. (Fig. 63)



Neigen die Kopfstütze

1. Lösen den Knopf ② (Fig. 64) auf der rechten Seite des Ständers. Der vertikale Kipparm kann bewegt werden. Sobald der gewünschte Winkel erreicht ist, ziehen den Knopf an.



Ändern des Winkels des Kopfes

1. Lösen die Befestigungsschraube ③ und drehen den Kopf in den gewünschten Winkel (rechts oder links), dann ziehen die Befestigungsschraube an. (Fig. 65-66)

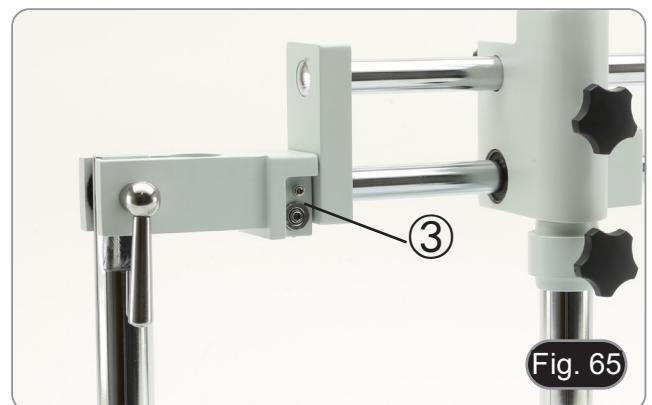




Fig. 66

Drehen den horizontalen Arm

1. Lösen die Befestigungsschraube des Horizontalarms ④ und drehen den Arm, dann ziehen die Befestigungsschraube an. (Fig. 67)
- **HINWEIS:** Wenn das Mikroskop um 180° von der Basis aus drehen, kann das gesamte System umkippen.



Fig. 67

9.13.3 SZ-STLX

Bewegen den horizontalen Arm

1. Lösen die Knöpfe auf der rechten Seite des horizontalen Arms ①. (Fig. 68)

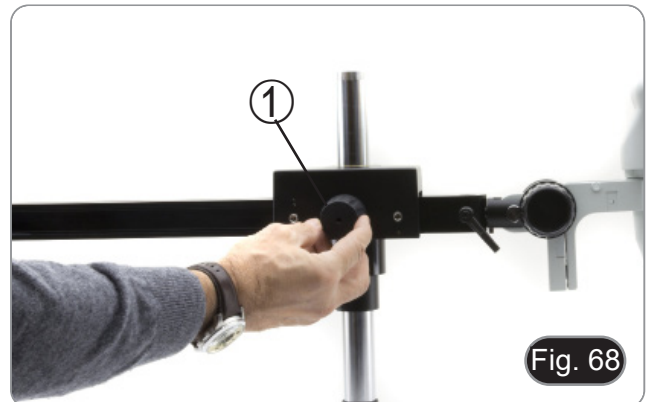


Fig. 68

2. Der Arm kann je nach Bedarf verlängert oder verkürzt werden. (Fig. 69)



Fig. 69

Einstellen des horizontalen Blocks

1. Entriegeln den Verriegelungsknopf ② und bringen ihn in eine Position, die den Bedürfnissen des Benutzers entspricht. (Fig. 70)
2. Verriegeln den Feststellknopf, um die Bewegungsgrenze einzustellen.

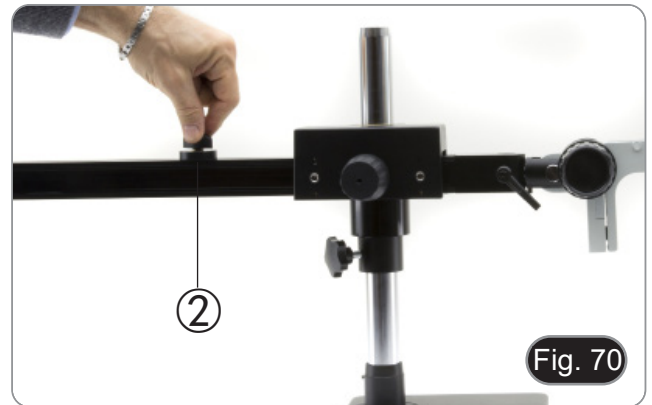


Fig. 70

Neigen die Kopfstütze

1. Lösen die Inbusschraube ③ (Fig. 71) am oberen Teil der Kopfstütze.
2. Der schwarze Teil kann verschoben werden. Sobald der gewünschte Winkel erreicht ist, ziehen die Schraube wieder an.



Fig. 71

Ändern des Winkels des Kopfes

1. Entriegeln den Fixierknopf ④ und drehen den Kopf in den gewünschten Drehwinkel (links oder rechts), dann ziehen den Knopf wieder an. (Fig. 72-73)



Fig. 72



Fig. 73

Drehen den horizontalen Arm


1. Lösen den Befestigungsknopf des Horizontalarms ⑤ und drehen den Arm, dann ziehen den Knopf wieder fest. (Fig. 74)
- **HINWEIS:** Wenn das Mikroskop um 180° von der Basis aus drehen, kann das gesamte System umkippen.




9.13.4 SZ-STL5 / SZ-STL5LED

Einstellen des Widerstands der Montagehalterung



- Das Produkt ist so konstruiert, dass der Widerstand in der Kipphalterung so eingestellt werden kann, dass es um 90 Grad seitlich schwingen und um 90 Grad vorwärts und rückwärts kippen kann. Es ist möglich, den Widerstand in der Tilter Mount Bracket zu steuern.
1. Wenn die Kipphalterung dazu neigt, automatisch herunterzufallen, muss das Gelenk der Kipphalterung möglicherweise so eingestellt werden, dass es der Neigungsposition Ihres Mikroskops von 90 Grad vorwärts und rückwärts entspricht. Dies kann mithilfe eines 6-mm-Inbusschlüssels erfolgen, um den Widerstand der Kipphalterung zu erhöhen und die Kippposition zu sichern. Stellen die M5x15-mm-Spannschraube mit Innensechskant, die sich um das Gelenk der Kipphalterung befindet, mit einem 6-mm-Inbusschlüssel ein. (Fig. 75)

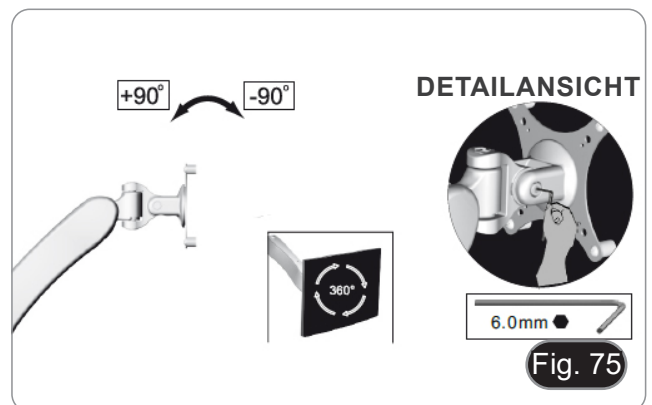

2. Um den Widerstand des Drehgelenks zu erhöhen oder zu verringern, damit das Mikroskop von einer Seite zur anderen schwingen kann, stellen die Sechskantschraube auf der Vorderseite des Gelenkarms ein, um die Position zu sichern. (Fig. 76)
3. Um den Widerstand zu erhöhen, ziehen die M5x15-mm-Spannungs-Sechskantschraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel 4mm im Uhrzeigersinn an. Um den Widerstand zu verringern, lösen die M5x15-mm-Spannungs-Sechskantschraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel 4mm gegen den Uhrzeigersinn.

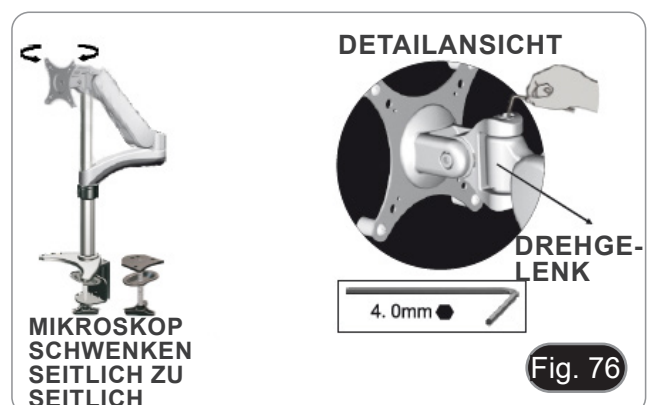


4. Dieser Arm kann wie gezeigt nach oben und unten gehoben werden. (Fig. 77).
- Wenn der Arm dazu neigt, sich automatisch zur Seite zu bewegen, muss die Spannung am Gelenkarm möglicherweise angepasst werden, um die Position des Mikroskoparms zu erreichen, der zur Seite schwingt. Dies kann mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel 2,5 mm erfolgen. (Fig. 78)

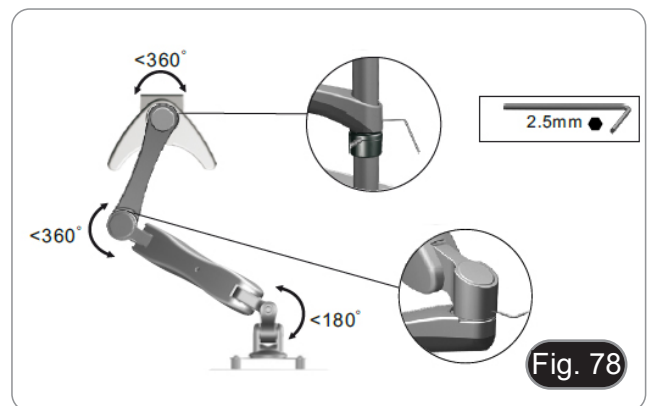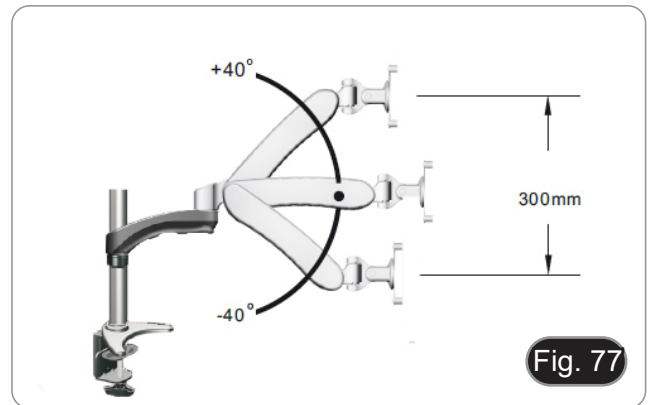

Einstellen der Lichtintensität


Drehen die Einstellknöpfe für die Lichtintensität ① zum Ein-/Aus-schalten und zum Erhöhen/Verringern der Lichtintensität jedes einzelnen LED-Arms. (Fig. 79)

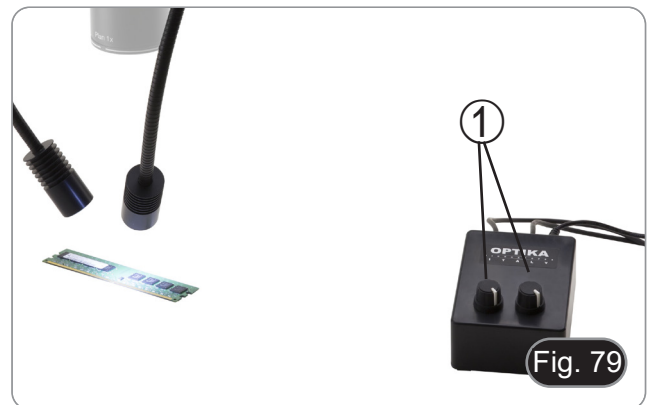

10. Mikrofotografie

10.1 Verwendung von C-Mount Kameras

1. Lösen die Sicherungsschraube ① am Binokulartubus und entfernen die Staubkappe ②. (Fig. 80)

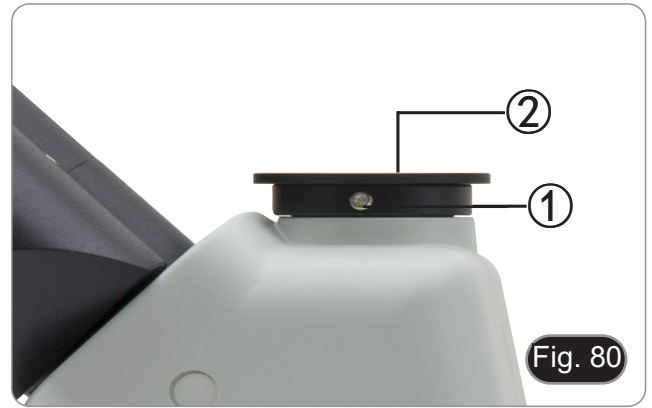

2. Schrauben den Adapterschritt "C" ③ an die Kamera ④ und montieren die runde Halterung der Stufe C in die leere Bohrung des Binokulartubus (Fig. 81), dann ziehen die Klemmschraube ① an.



10.2 Verwendung von Spiegelreflexkameras

1. Setzen den Reflexadapter ① in den Mikroskopanschluss-Schlauch ②.
 2. A Schrauben den "T2"-Ring ③ (nicht mitgeliefert) an den Reflexadapter.
 3. Verbinden die Spiegelreflexkamera ④ mit dem gerade montierten Ring "T2" (Fig. 82).
 4. Montieren das Ende des Verbindungsrohres ② in die leere Bohrung des Fernglasrohres und ziehen die Klemmschraube an. (Fig. 80)
- Der Ring "T2" wird nicht mit dem Mikroskop geliefert, sondern ist im Handel erhältlich.
 - Um dunkle Präparate zu fotografieren, verdunkeln Okulare und Sucher mit einem dunklen Tuch, um das Streulicht zu begrenzen.
 - Um die Vergrößerung der Kamera zu berechnen: $\text{Objektiv} * \text{Vergrößerungskamera} * \text{Vergrößerungskamera} * \text{Vergrößerungslinse}$.
 - **Wenn eine Spiegelreflexkamera verwenden, kann die Bewegung des Spiegels die Maschine in Schwingungen versetzen.**
 - **Es wird empfohlen, den Spiegel anzuheben, lange Belichtungszeiten zu verwenden und einen flexiblen Auslöser zu verwenden.**



11. Wartung

Arbeitsumfeld

Es wird empfohlen, das Mikroskop an einem sauberen, trockenen und stoßsicheren Ort zu verwenden, bei einer Temperatur zwischen 0° und 40° und einer Feuchtigkeit nicht über 85% (ohne Kondensation). Wenn nötig wird die Verwendung eines Luftentfeuchters empfohlen.

Vor und nach dem Gebrauch des Mikroskops



- Das Mikroskop muss immer vertikal stehen.
- Achten darauf, die optischen Komponenten (z.B. Objektive, Okulare) nicht zu beschädigen oder diese nicht fallen lassen.
- Behandeln das Mikroskop mit Vorsicht und gebrauchen nicht zu viel Kraft.
- Führen selber keinerlei Reparatur durch..
- Nach dem Gebrauch schalten das Licht aus, decken das Mikroskop mit der mitgelieferten Staubschutzhaube und bewahren es an einem sauberen, trockenen Ort auf.

Elektrische Sicherheitsmaßnahmen



- Bevor das Netzkabel anstecken, vergewissern sich, dass die Spannung für das Mikroskop geeignet ist, und dass der Beleuchtungsschalter sich in position OFF befindet.
- Beachten alle Sicherheitsvorschriften des Arbeitsplatzes, an dem mit dem Mikroskop arbeiten.

Optikreinigung

- Wenn die optischen Komponenten reinigen müssen, verwenden zuerst Druckluft.
- Falls nötig reinigen die optischen Komponenten mit einem weichen Tuch.
- Als letzte Option befeuchten einen Tuch mit einer Mischung 3:7 von Ethanol und Ether.
- **Beachten, dass Ethanol und Ether sehr entzündliche Flüssigkeiten sind. Sie müssen bei einer Wärmequelle, bei Funken oder bei elektrische Geräte nicht verwendet werden. Verwenden diese Chemikalien in einer gut belüfteten Raum.**
- Scheuern keine Oberfläche der optischen Komponenten mit den Händen, da Fingerabdrücke die Optik beschädigen können.
- Montieren die Objektive und Okulare nicht ab, um sie zu reinigen.

Am Besten verwenden Sie das OPTIKA Reinigungsset (siehe Katalog)

Falls das Mikroskop aus Wartungszwecken an Optika zurückgeschickt werden muss, verwenden Sie bitte immer die Originalverpackung.

12. Probleme und Lösungen

Lesen die Informationen in der folgenden Tabelle, um Probleme bei der Bedienung zu beheben.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
I. Optisches System:		
Die Beleuchtung ist eingeschaltet, aber das Sichtfeld ist dunkel	Stromversorgungsstecker sind nicht gut angeschlossen.	Verbinden Sie sie
	Die Helligkeit ist zu gering.	Stellen Sie es auf ein geeignetes Niveau ein
Die Kanten des Sichtfeldes sind vignettiert oder die Helligkeit ist asymmetrisch.	Aufflichtbeleuchtung ist nicht richtig ausgerichtet.	Ändern des Winkels des einfallenden Scheinwerfers
Im Sichtfeld sind Schmutz und Staub zu sehen.	Schmutz und Staub auf der Probe	Reinigen Sie die Probe
	Schmutz und Staub auf dem Okular	Okular reinigen
Die Bildqualität ist schlecht: <ul style="list-style-type: none"> • Das Bild ist nicht scharf; • Der Kontrast ist nicht hoch; • Die Details sind nicht scharf; • Reflexionen im Bild 	Die Linsen (Kondensator, Linsen, Okulare und Schieber) sind verschmutzt.	Die Linsen (Kondensator, Objektive, Okulare und Schieber) sind verschmutzt.
Eine Seite des Bildes ist nicht scharf abgebildet.	Die Präparation ist nicht in der richtigen Position (z.B. geneigt)	Legen Sie die Präparation horizontal auf die Oberfläche
II. Mechanischer System:		
Der makrometrische Knopf ist schwer zu drehen.	Einstellring zu fest spannen	Lösen Sie den Einstellring für die Spannung.
Die Fokussierung ist instabil.	Einstellring zu locker gespannt	Ziehen Sie den Einstellring für die Spannung an.
III. Elektrischer System:		
Die LED leuchtet nicht.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.	Überprüfen Sie den Anschluss des Netzkabels.
Die Helligkeit ist unzureichend.	Die Helligkeit wird niedrig eingestellt.	Einstellen der Helligkeit
Licht blinkt	Das Netzkabel ist nicht gut angeschlossen.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung
IV. Beobachtungstubus:		
Das Sichtfeld ist für jedes Auge unterschiedlich.	Der Augenabstand ist nicht korrekt.	Einstellen des Augenabstandes
	Die Dioptrienkorrektur ist nicht richtig.	Einstellen der Dioptrienkorrektur
	Die Sehtechnik ist nicht korrekt, und der Bediener belastet sein Augenlicht.	Wenn Sie sich die Probe ansehen, konzentrieren Sie Ihren Blick nicht auf einen einzelnen Punkt, sondern betrachten Sie das gesamte verfügbare Sichtfeld. Schauen Sie regelmäßig weg und schauen Sie auf einen entfernten Punkt, dann gehen Sie zurück zur Analyse der Probe.
V. Mikrofotografie und Videoerfassung:		
Der Rand des Bildes ist nicht scharf abgebildet.	Bis zu einem gewissen Grad ist dies in der Natur der achromatischen Objektive begründet.	Um das Problem zu minimieren, stellen Sie die Blende auf die beste Position ein.
Lichtpunkte erscheinen auf dem Bild	Diffuses Licht tritt durch die Okulare oder den Sucher der Kamera in das Mikroskop ein.	Okulare und Sucher mit einem dunklen Tuch abdecken.

Wiederverwertung

Gemäß dem Artikel 13 vom Dekret Nr. 151 vom 25.07.2005 "Umsetzung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG in Bezug auf die Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie die Abfallentsorgung".



Das Symbol vom Müllcontainer erscheint auf dem Gerät oder der Verpackung und weist darauf hin, dass das Produkt Ende des Lebens separat von anderen Abfällen entsorgt werden muss. Die getrennte Sammlung von Geräten, die am Ende Ihrer Lebensdauer sind, wird vom Hersteller organisiert. Der Benutzer, der dieses Gerät entsorgen möchte, muss dann Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen und der Vorgehensweise folgen, die zur separaten Entsorgung eingeführt worden ist. Die korrekte Sammlung von Geräten um die nachfolgende Behandlung, Entsorgung und umweltfreundliche Wiederverwendung zu ermöglichen ist ein Beitrag um negative Auswirkungen auf der Umwelt und der Gesundheit zu vermeiden und die Wiederverwendung der Gerätkomponenten zu begünstigen. Die illegale Entsorgung des Produkts vom Benutzer wird gemäß den geltenden Bestimmungen bestraft.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain
spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA
usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China
china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® India
india@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Central America
camerica@optikamicroscopes.com

Série SZ

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modelo	
SZ-A1	SZ-A6
SZX-B	SZX-T
SZX-BA	SZX-TA
SZO-B	SZO-T
SZ-ST1	SZ-ST2
SZ-ST3	SZ-ST7
SZ-ST8	SZ-OBL
ST-150	ST-152
SZ-STL1	SZ-STL2
SZ-STLX	SZ-STL5
SZ-STL5LED	

Ver. 2.3 2022



Tabela de Conteúdos

1.	Advertência	264
2.	Informações sobre a segurança	264
3.	Conteúdo da embalagem	265
3.1	SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA	265
3.2	SZO-B / SZO-T	266
3.3	SZ-A1	266
3.4	SZ-A6	267
3.5	ST-150	267
3.6	ST-152	268
3.7	SZ-ST1	268
3.8	SZ-ST2 / SZ-ST3	269
3.9	SZ-ST7 / SZ-ST8	269
3.10	SZ-OBL	270
3.11	SZ-STL1	270
3.12	SZ-STL2	271
3.13	SZ-STLX	271
3.14	SZ-STL5	272
3.15	SZ-STL5LED	273
4.	Desembalando	274
5.	Uso previsto	274
6.	Simbolos	274
7.	Descrição do instrumento	275
7.1	Diagrama de Sistema	275
7.2	SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA	276
7.3	SZO-B / SZO-T	276
7.4	SZ-A1	277
7.5	SZ-A6	277
7.6	ST-150	278
7.7	ST-152	278
7.8	SZ-ST1	279
7.9	SZ-ST2 / SZ-ST3	279
7.10	SZ-ST7 / SZ-ST8	280
7.11	SZ-OBL	280
7.12	SZ-STL1	281
7.13	SZ-STL2	281
7.14	SZ-STLX	282
7.15	SZ-STL5	282
7.16	SZ-STL5LED	283
8.	Montagem	284
8.1	SZ-A1 / SZ-A6	284
8.2	SZ-ST1 / ST-150	284
8.3	ST-152	284
8.4	SZ-ST2 / SZ-ST3	284
8.5	SZ-ST7 / SZ-ST8 / SZ-OBL	285
8.6	SZ-STL1	285
8.7	SZ-STL2	288
8.8	SZ-STLX	290
8.9	SZ-STL5 / SZ-STL5LED	293
8.10	Instalar a cabeça (todos os modelos)	294
8.11	Instalar as oculares (todos os modelos)	294
8.12	Instalar a saída de foto (SZX-T / TA)	294
9.	Uso do microscópio	296
9.1	Ajuste da distância interpupilar	296
9.2	Focalização	296
9.3	Ajuste da tensão de focagem	296
9.3.1	SZ-A1	296
9.3.2	SZ-A6	296
9.4	Alavanca de bloqueio do foco (SZ-A6)	297
9.5	Compensação dióptrica	297
9.6	Ampliação	298
9.7	Uso de lentes adicionais	298
9.8	Uso de lentes adicionais 0.3X-0.5X	299

9.9	Disco preto/branco (SZ-ST1 / 2 / 3 / 7 / 8)	299
9.10	Uso de iluminação (SZ-ST2 / 3 / 7 / 8)	300
9.11	Uso de iluminação (SZ-OBL)	300
9.12	Uso de ilhós de borracha (SZO-B / T)	300
9.13	Uso de bases em balanço	302
9.13.1	SZ-STL1	302
9.13.2	SZ-STL2	303
9.13.3	SZ-STLX	304
9.13.4	SZ-STL5 / SZ-STL5LED	306
10.	Microfotografia	308
10.1	Uso de câmaras de paso “C”	308
10.2	Uso de câmaras Reflex	308
11.	Manutenção	309
12.	Resolução de problemas	310
	Eliminação	311

1. Advertência

Este microscópio é um instrumento científico de alta precisão, projectado para durar um longo tempo com manutenção mínima; a sua realização respeita os melhores padrões ópticos e mecânicos, para que possa ser utilizado diariamente. Recordamos que este manual contém informações importantes para a segurança e a manutenção do instrumento, portanto deve ser colocado à disposição daqueles que o irão utilizar. O fabricante exime-se de qualquer responsabilidade em caso de Uso do instrumento não indicada neste manual.

2. Informações sobre a segurança



Para evitar choques eléctricos

Antes de ligar o cabo de alimentação com a tomada eléctrica, certificar-se de que a tensão da rede local coincida com a tensão do instrumento e que o interruptor da iluminação esteja na posição "OFF".

Os utilizadores deverão seguir todas as normas de segurança locais. O instrumento tem certificação CE. Em todo o caso, os utilizadores são os únicos responsáveis pela Uso segura do instrumento. Para a Uso com segurança do instrumento, é importante respeitar as seguintes instruções e ler completamente o manual.

3. Conteúdo da embalagem

3.1 SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA



① Corpo do microscópio

• SZX-B/BA Binocular / SZX-T/TA Trinocular

② Oculares

③ Chave Allen (apenas para SZX-T/TA)

④ Tampa do pó

⑤ Anel de saída foto (apenas para SZX-T/TA)


3.2 SZO-B / SZO-T



- ① Corpo do microscópio
• (SZO-B Binocular) / SZO-T Trinocular)
- ② Oculares


- ③ Chave Allen (apenas para SZO-T)
- ④ Tampa do pó
- ⑤ Anel de saída foto (apenas para SZO-T)

3.3 SZ-A1

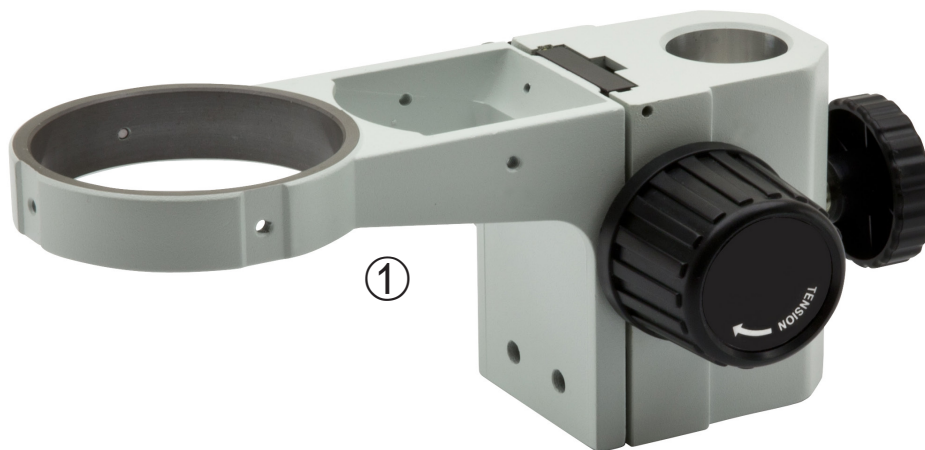


- ① Foco Macro

3.4 SZ-A6

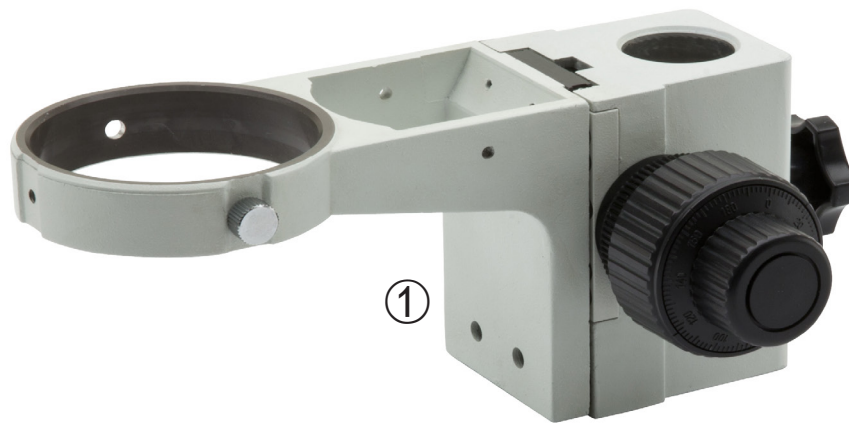

① Foco Macro/Micro

3.5 ST-150

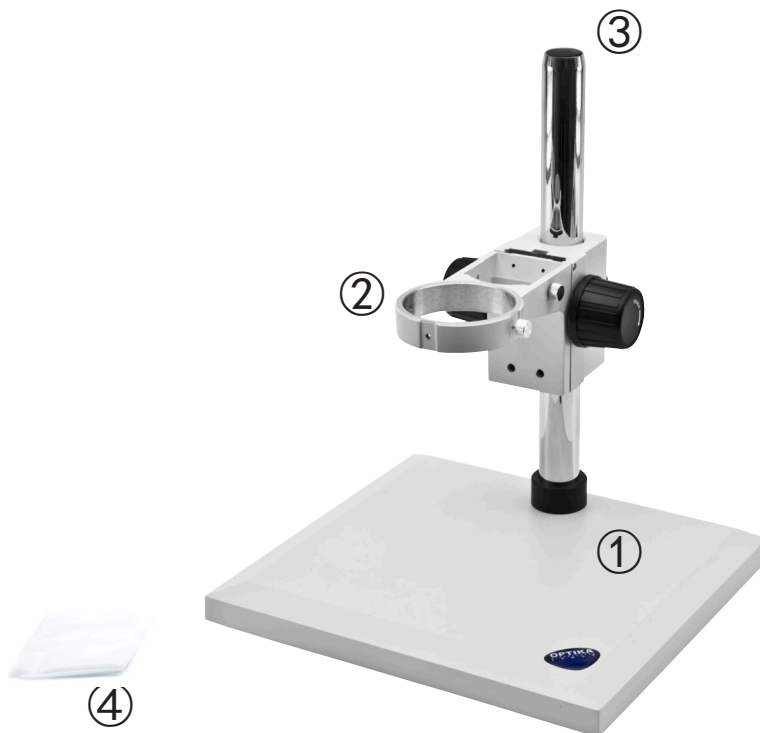


① Base

② Suporte de cabeça / sistema de focagem

③ Pilar

④ Tampa do pó

3.6 ST-152

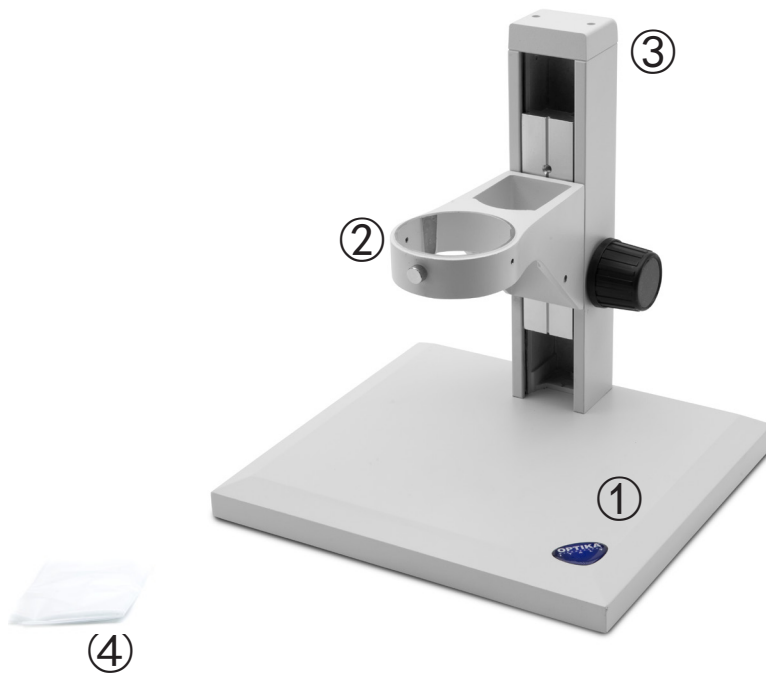

① Base

② Suporte de cabeça / sistema de focagem

③ Pilar

④ Tampa do pó

3.7 SZ-ST1



① Base

② Clipes de amostra (um par)

③ Disco branco / preto

3.8 SZ-ST2 / SZ-ST3



- ① Base
- ② Disco opal
- ③ Clipes de amostra (um par)

- ④ Iluminador de luz incidente
- ⑤ Disco branco / preto
- ⑥ Fonte de alimentação

3.9 SZ-ST7 / SZ-ST8



- ① Base
- ② Disco opal
- ③ Clipes de amostra (um par)

- ④ Disco branco / preto
- ⑤ Fonte de alimentação


3.10 SZ-OBL



- ① Base
- ② Pilar
- ③ Placa de vidro

- ④ Fonte de alimentação
- ⑤ Capa de pó


3.11 SZ-STL1

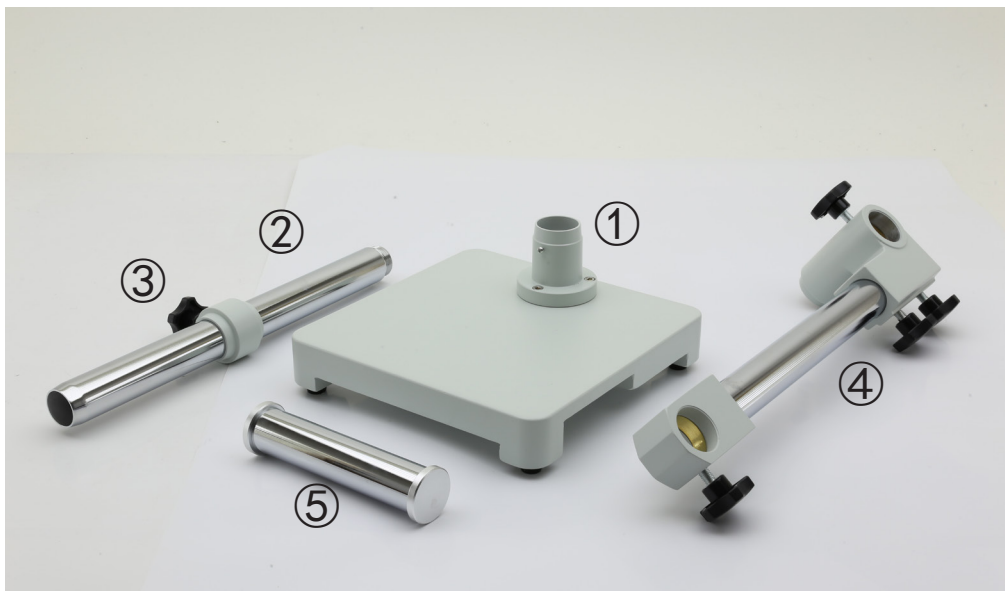

- ① Base
- ② Braço vertical
- ③ Anel de prevenção de descenso

- ④ Braço horizontal
- ⑤ Soporte do braço de focalização

3.12 SZ-STL2

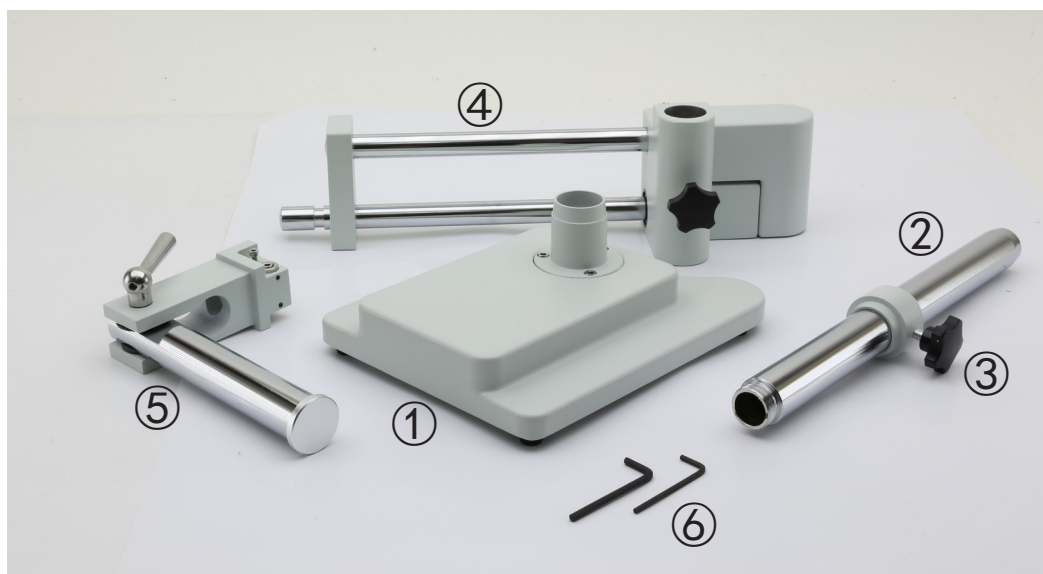


- ① Base
- ② Braço vertical
- ③ Anel de prevenção de descenso
- ④ Braço horizontal
- ⑤ Soporte do braço de focalização
- ⑥ Chave Allen

3.13 SZ-STLX



- ① Base
- ② Braço vertical
- ③ Braço horizontal
- ④ Anel de prevenção de descenso
- ⑤ Foco macro
- ⑥ Chave Allen

3.14 SZ-STL5

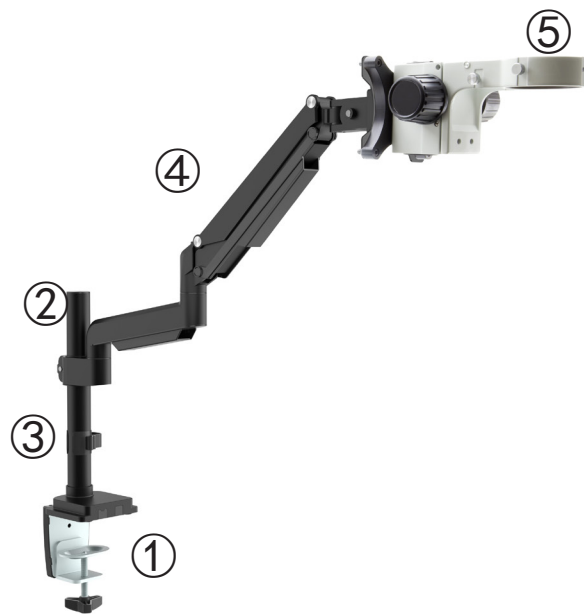

- ① Grampo de mesa
- ② Pilar
- ③ Anel de prevenção de descenso
- ④ Braço horizontal
- ⑤ Suporte de cabeça / sistema de focagem
- ⑥ Fixador de cabo
- ⑦ Junta redonda
- ⑧ Parafusos curtos M4x12 mm (4 pcs)
- ⑨ Parafusos longos M4x25 mm (4 pcs)
- ⑩ Chaves Allen
- ⑪ Pés de borracha (4 pcs)
- ⑫ Junta rectangular
- ⑬ Grampo de mesa para grandes espessuras

3.15 SZ-STL5LED



- | | |
|--|--|
| ① Grampo de mesa | ⑧ Fixador de cabo |
| ② Pilar | ⑨ Junta redonda |
| ③ Anel de prevenção de descenso | ⑩ Parafusos curtos M4x12 mm (4 pcs) |
| ④ Braço horizontal | ⑪ Parafusos longos M4x25 mm (4 pcs) |
| ⑤ Suporte de cabeça / sistema de focagem | ⑫ Chaves Allen |
| ⑥ Braços auto-sustentáveis com led | ⑬ Pés de borracha (4 pcs) |
| ⑦ Caixa de controlo de iluminação com fonte de alimentação | ⑭ Junta rectangular |
| | ⑮ Grampo de mesa para grandes espessuras |

4. Desembalando

O microscópio é alojado em um recipiente de isopor moldado. Remova a fita da borda do recipiente e levante a metade superior do recipiente. Tome algum cuidado para evitar que os itens ópticos (objetivas e oculares) cair e ficar danificado. Usando ambas as mãos (uma ao redor do braço e outra ao redor da base), levante o microscópio do recipiente e coloque-o em uma mesa estável.



Não toque com as mãos nuas superfícies ópticas como lentes, filtros ou óculos. Vestígios de graxa ou outros resíduos podem deteriorar a qualidade final da imagem e corroer a superfície óptica em pouco tempo.

5. Uso previsto

Modelos padrão

Apenas para uso em pesquisa e ensino. Não se destina a qualquer uso terapêutico ou diagnóstico animal ou humano.

Modelos IVD

Também para uso diagnóstico, visando a obtenção de informações sobre a situação fisiológica ou patológica do indivíduo.

6. Símbolos

A tabela seguinte apresenta os símbolos utilizados neste manual.



PERIGO

Este símbolo indica um risco potencial e adverte que é preciso proceder com cuidado.



CHOQUE ELÉCTRICO

Este símbolo indica um risco de choque eléctrico.

7. Descrição do instrumento

7.1 Diagrama de Sistema



7.2 SZX-B / SZX-T / SZX-BA / SZX-TA





7.3 SZO-B / SZO-T




7.4 SZ-A1




7.5 SZ-A6

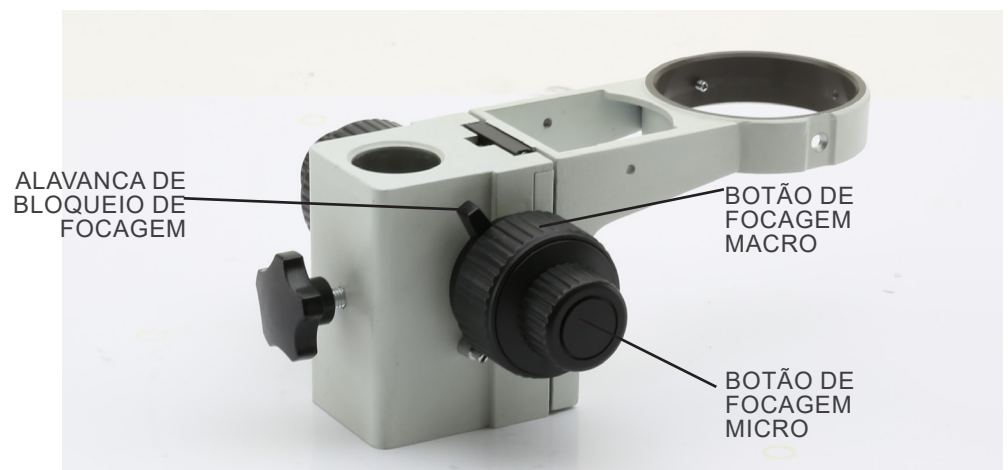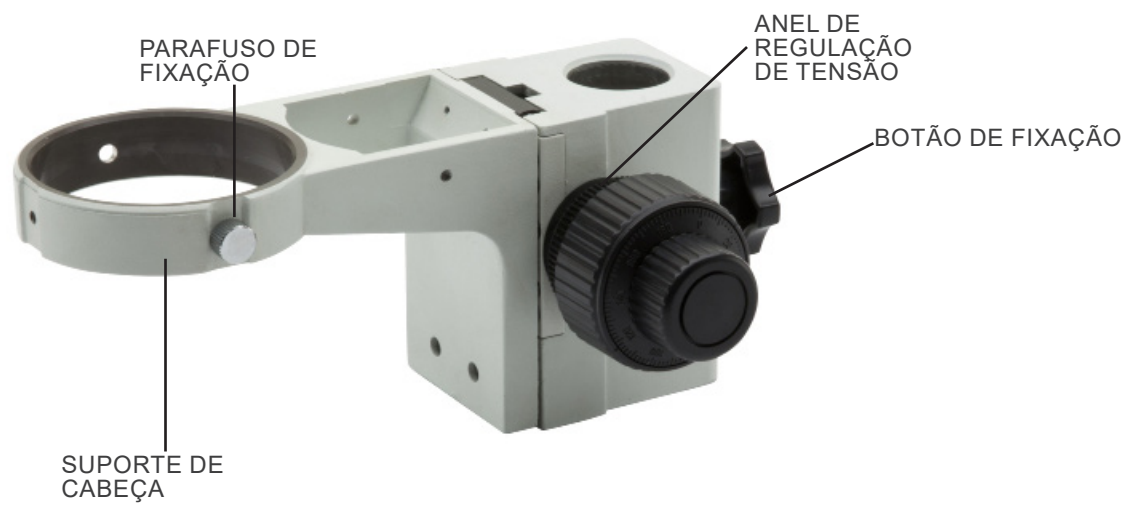


7.6 ST-150

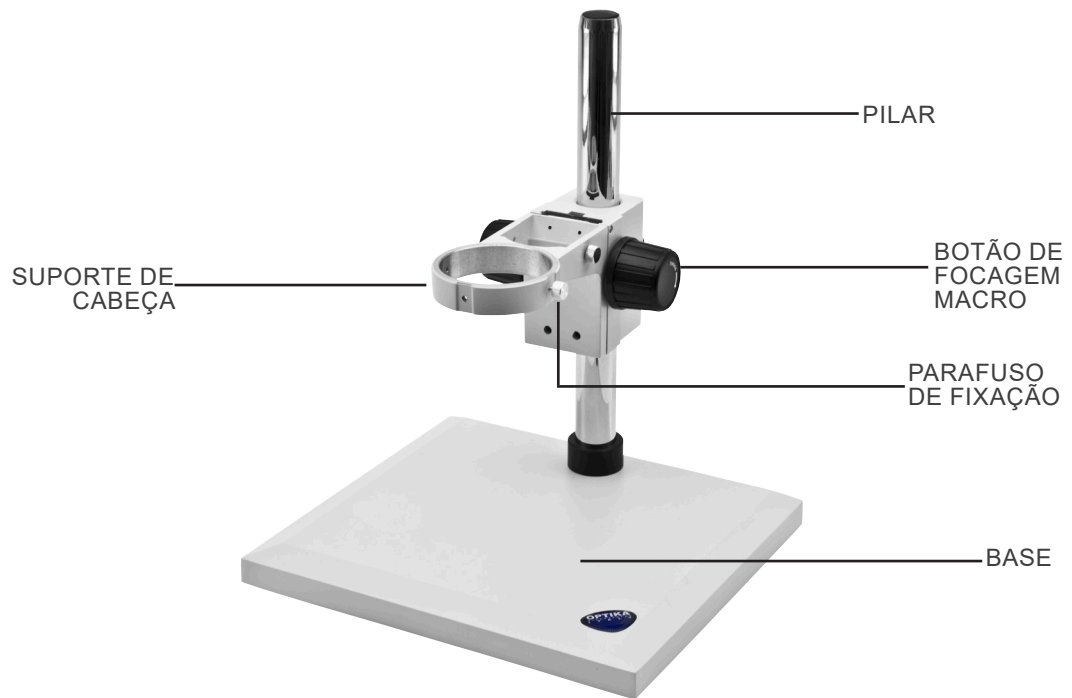


7.7 ST-152

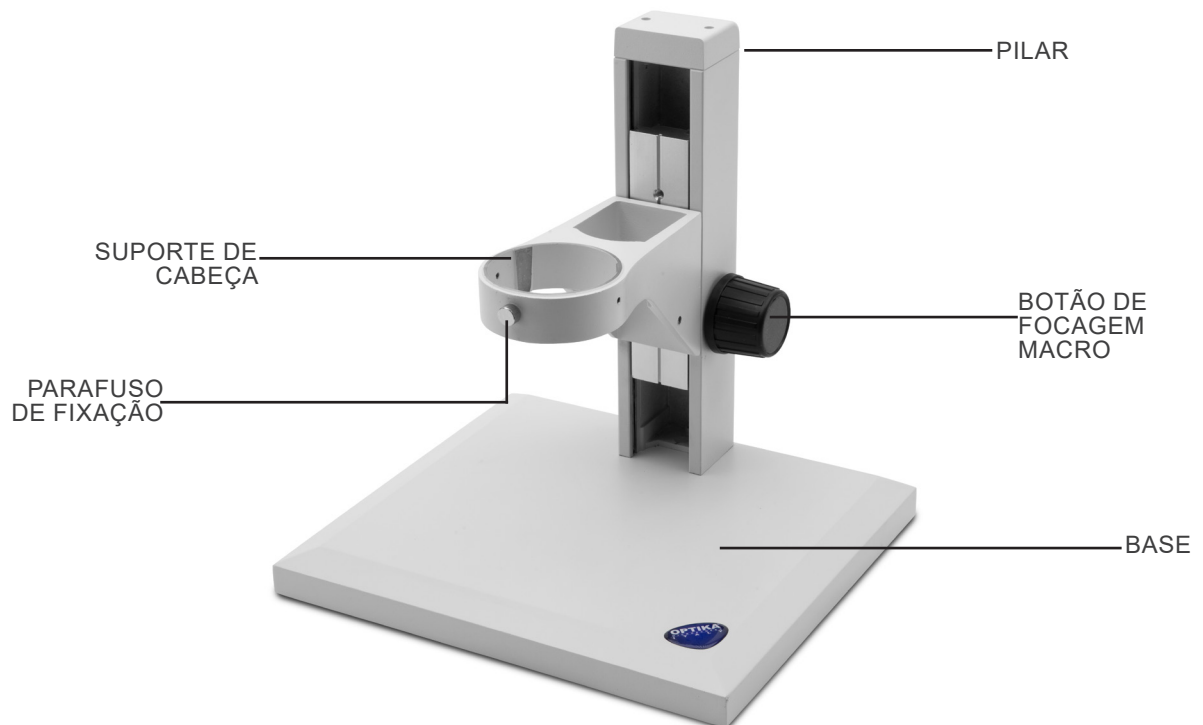


7.8 SZ-ST1

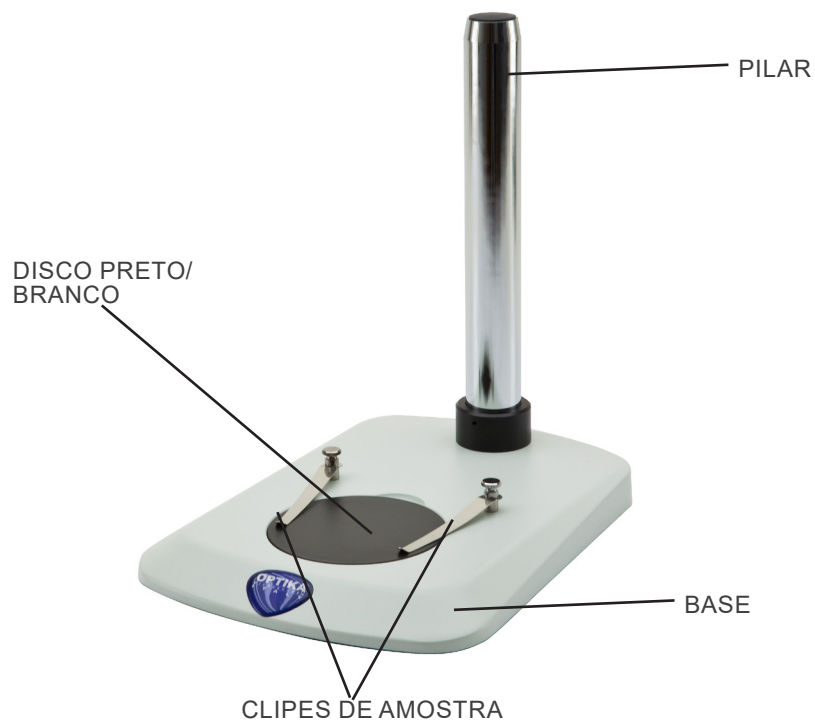


7.9 SZ-ST2 / SZ-ST3

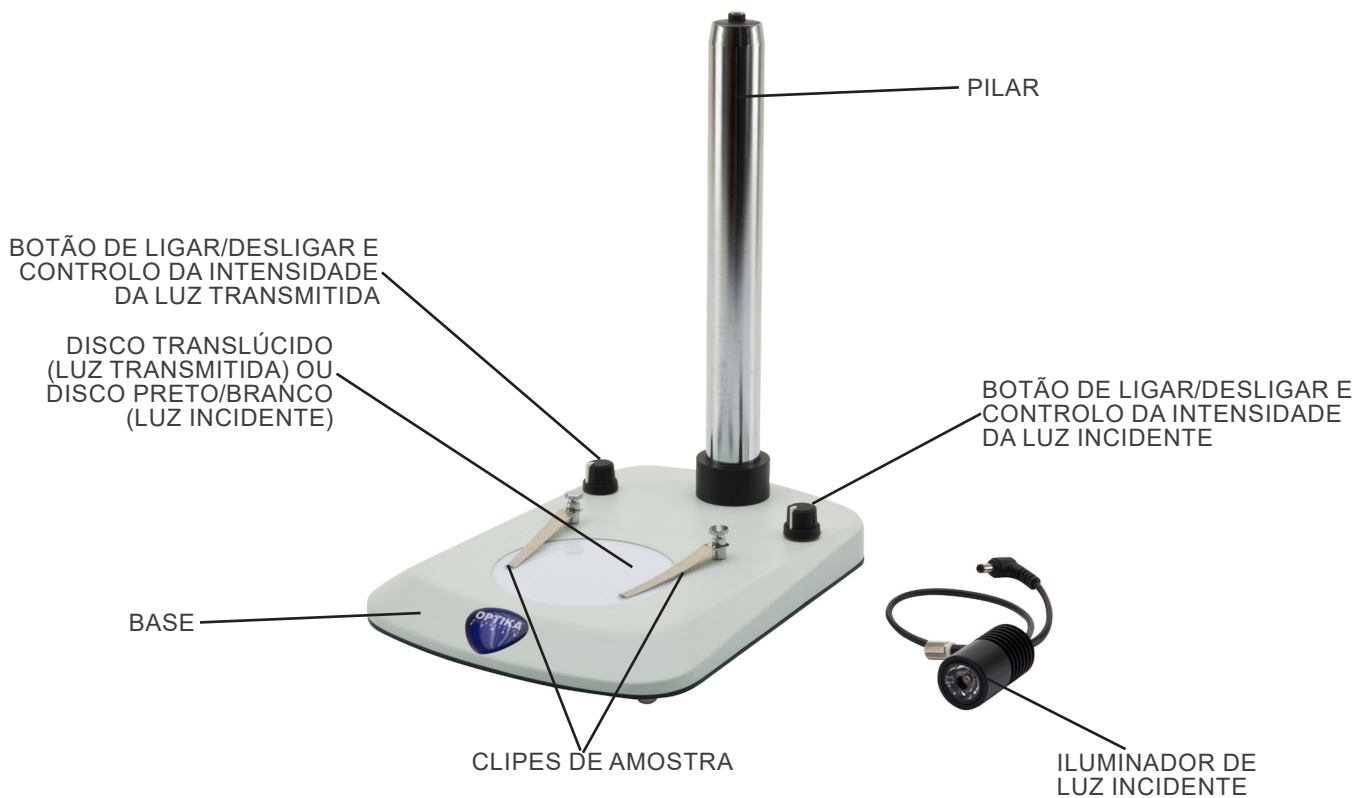


7.10 SZ-ST7 / SZ-ST8

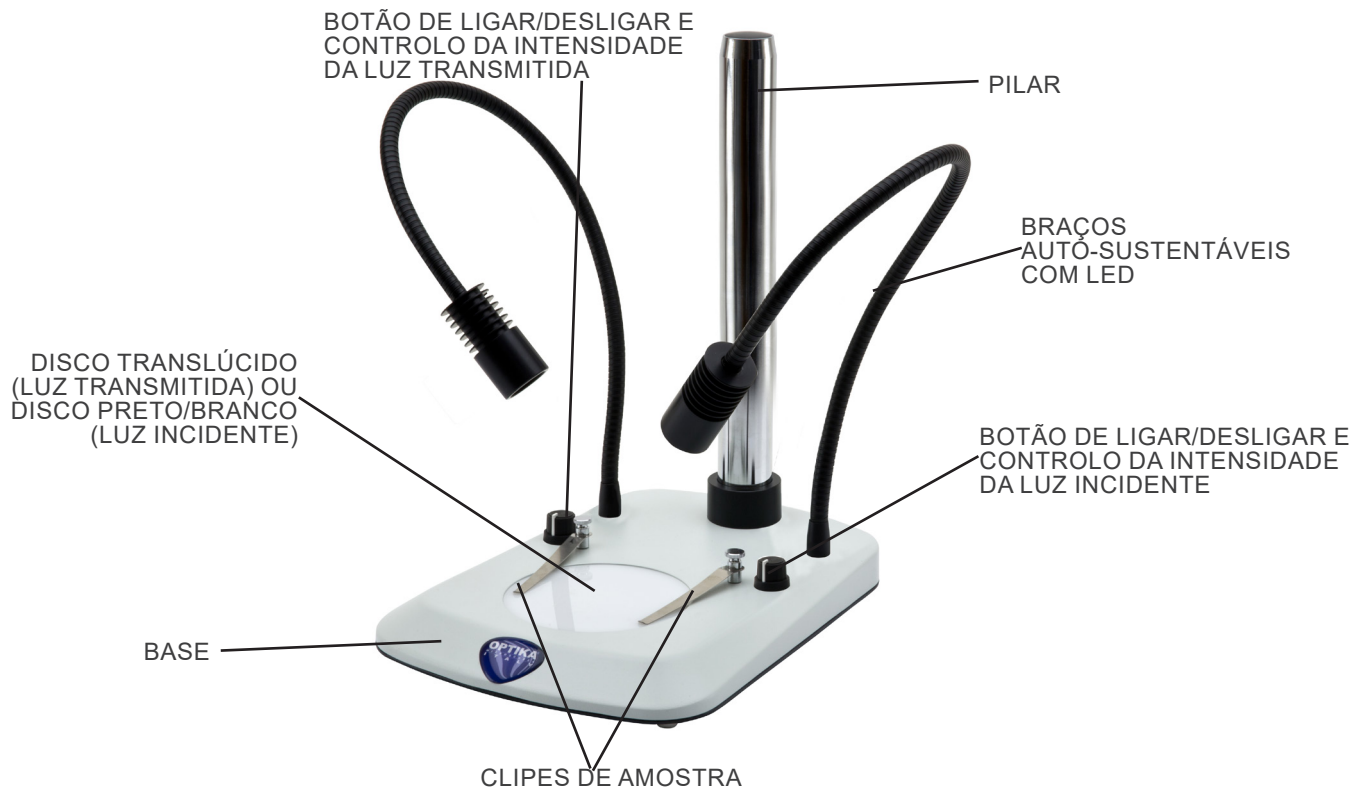


7.11 SZ-OBL

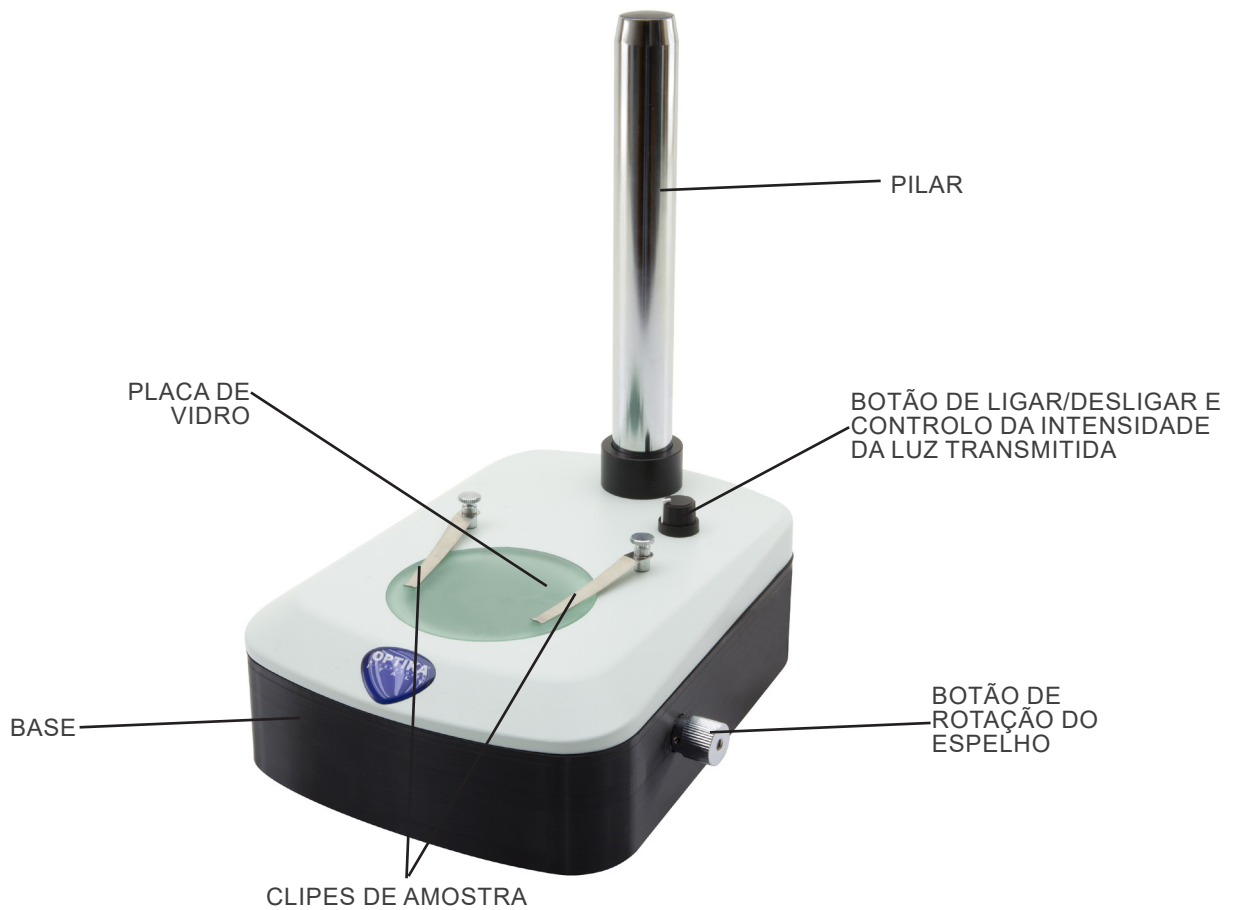


7.12 SZ-STL1

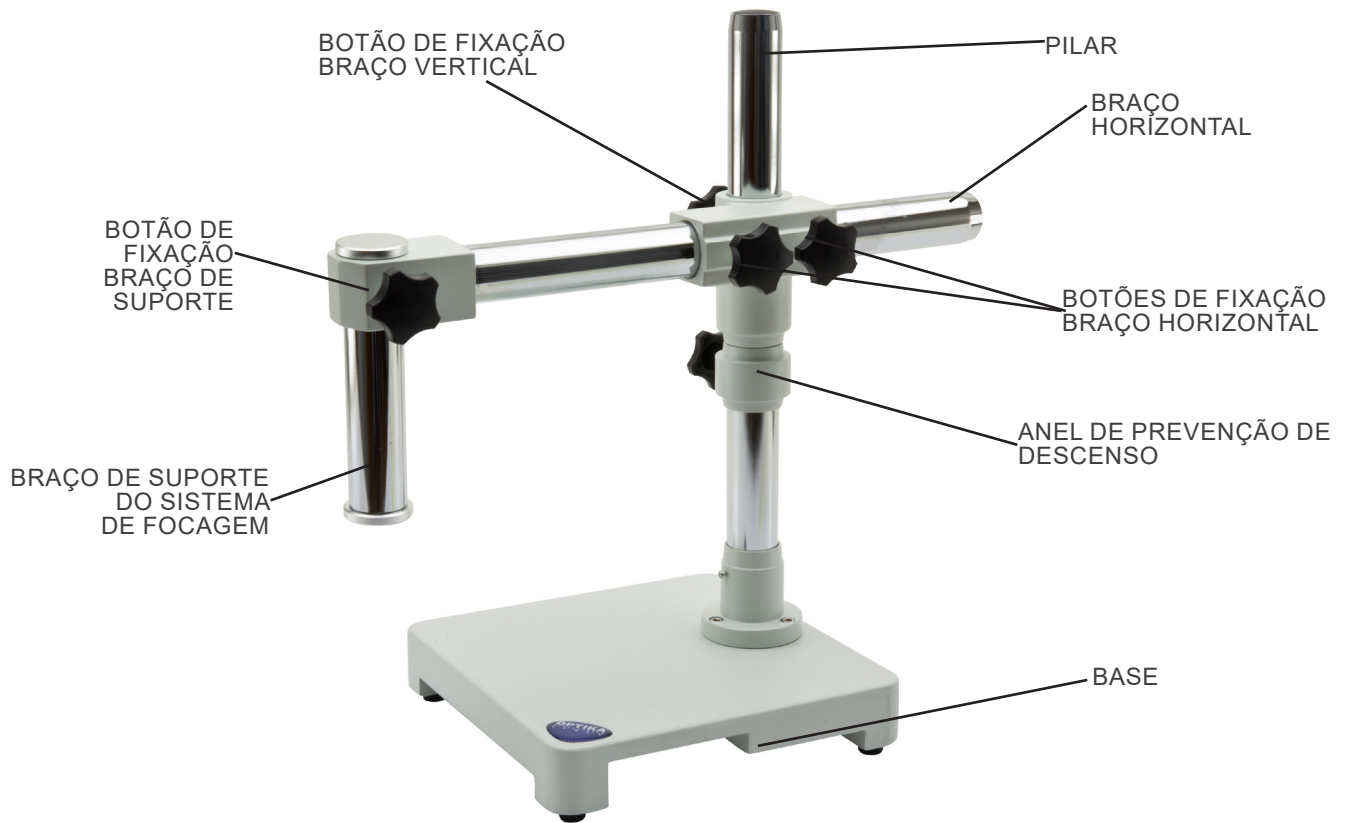


7.13 SZ-STL2

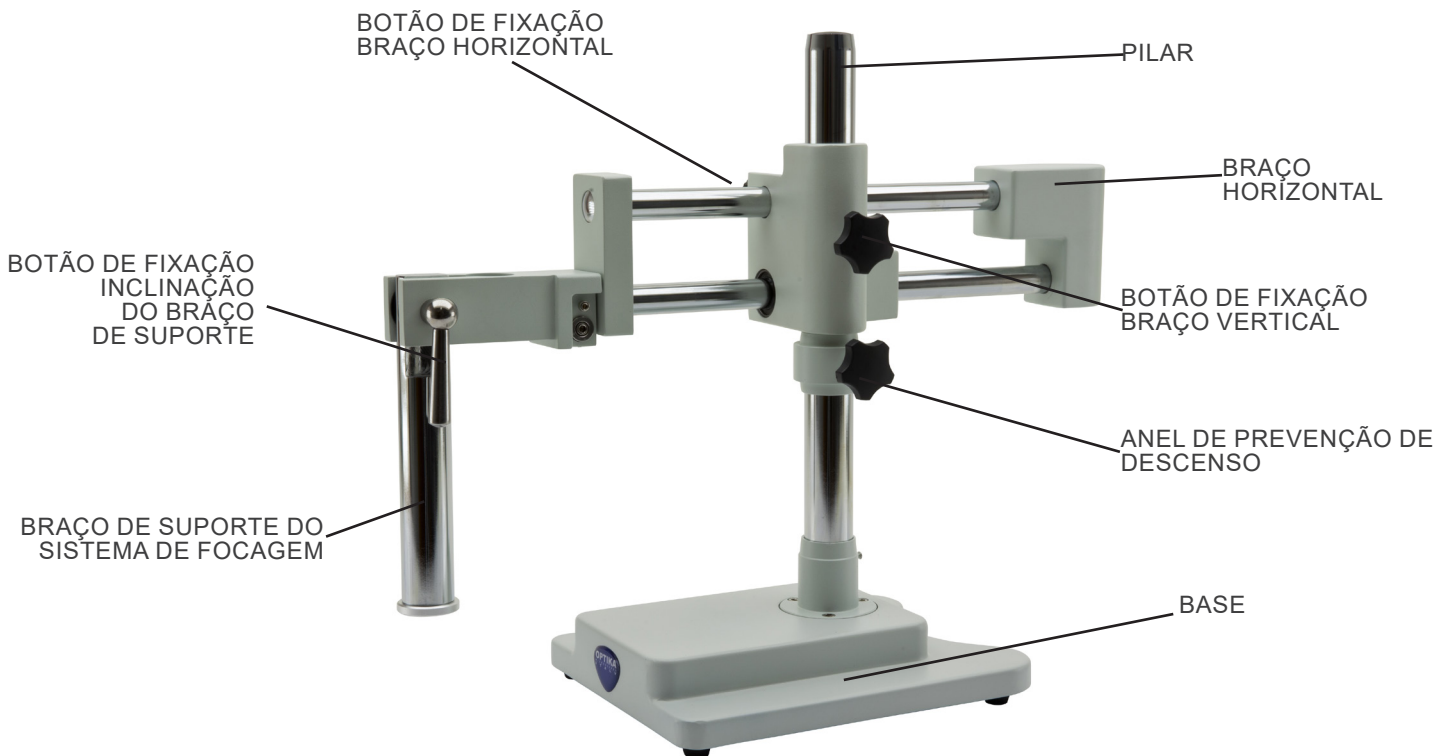

7.14 SZ-STLX

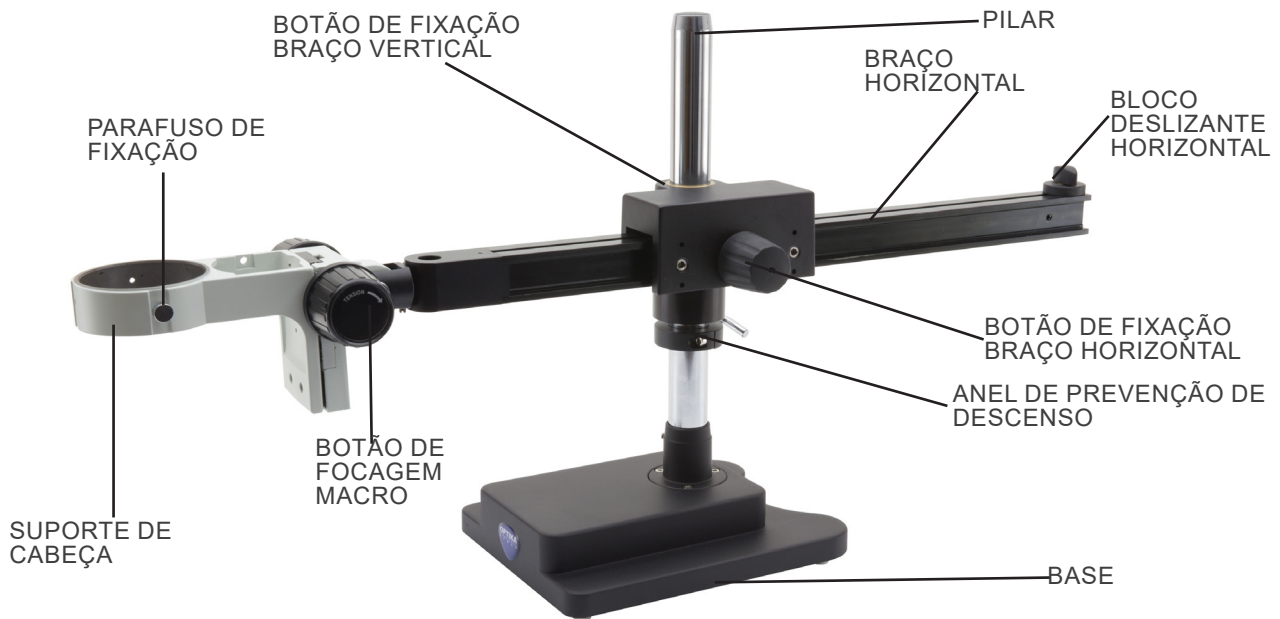

7.15 SZ-STL5

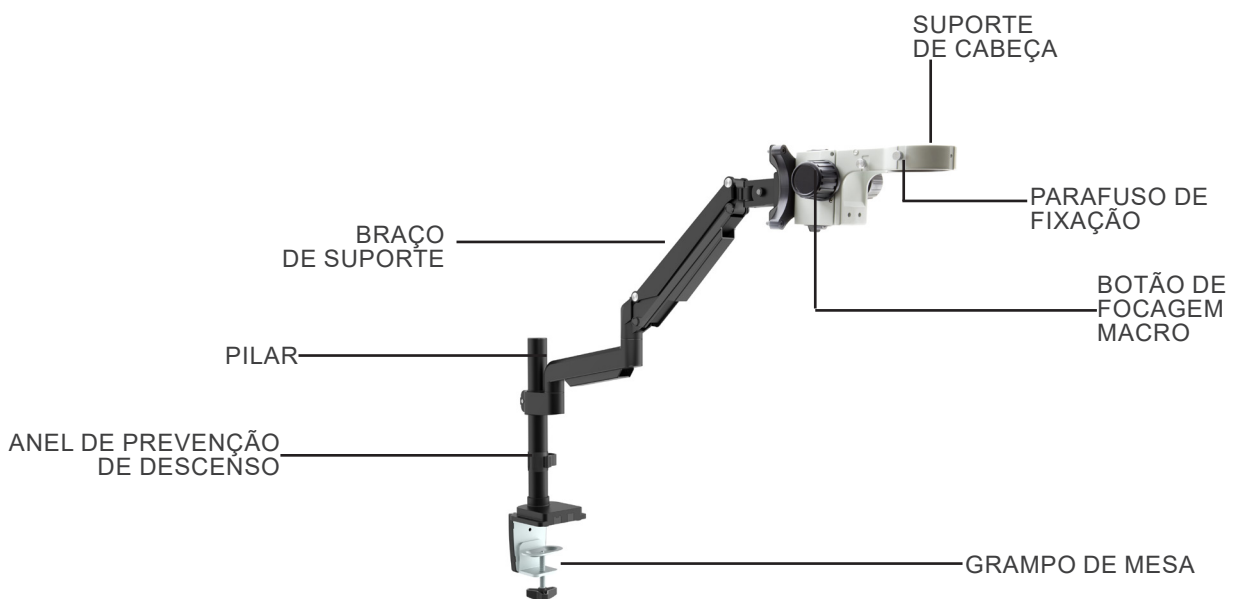


7.16 SZ-STL5LED



8. Montagem

8.1 SZ-A1 / SZ-A6

- A montagem dos sistemas de focagem SZ-A1 e SZ-A6 aplica-se a todas as bases excepto ST-152, SZ-STL1, SZ-STL2, SZ-STLX e SZ-STL5. Para a montagem sobre estas bases, consulte a secção específica.
1. Coloque o sistema de focagem no pilar e, uma vez atingida a altura desejada, aperte o botão de bloqueio ① localizado na parte posterior do sistema de focagem. (Fig. 1)

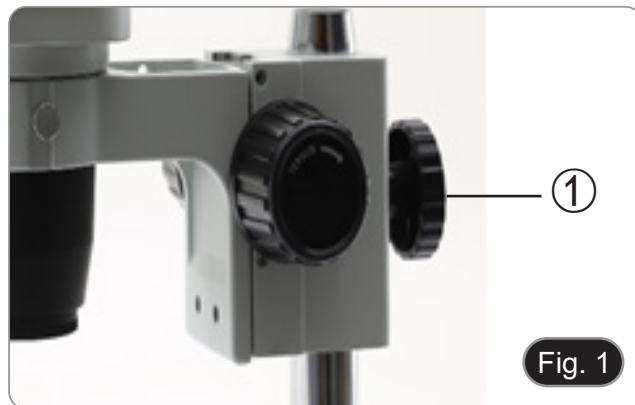

8.2 SZ-ST1 / ST-150

1. Retire a base da embalagem e coloque-a sobre uma superfície plana. A base já está montada de fábrica e não requer qualquer outro procedimento de montagem além da montagem do sistema de focagem.

8.3 ST-152


1. Retire a base da embalagem e coloque-a sobre uma superfície plana. A base já está montada de fábrica e não requer qualquer outro procedimento de montagem.

8.4 SZ-ST2 / SZ-ST3

1. Instale o projector LED para luz incidente como mostrado na Fig. 2.
- Afrouxando o parafuso de fixação ② é possível alterar o ângulo de inclinação do projector para otimizar a iluminação na amostra.



2. Insira o plugue do cabo no conector na parte superior do pilar ③. (Fig. 3)

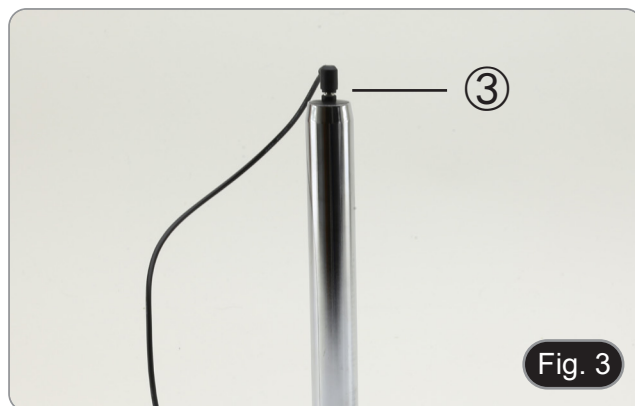

3. Conecte o plugue da fonte de alimentação ao conector na parte traseira da base do microscópio. (Fig. 4)



8.5 SZ-ST7 / SZ-ST8 / SZ-OBL

1. Retire a base da embalagem e coloque-a sobre uma superfície plana. A base já está montada de fábrica e não requer qualquer outro procedimento de montagem além da montagem do sistema de focagem.
2. Conecte o plugue da fonte de alimentação ao conector na parte traseira da base do microscópio. (Fig. 4)

8.6 SZ-STL1

1. Aparafusar o pilar à base. (Fig. 5)




2. Aperte os parafusos para bloquear o pilar. (Fig. 6)



3. Insira o anel de prevenção de descenso e fixe-o na altura desejada aparafusando o botão de fixação. (Fig. 7)



4. Inserir o braço horizontal e fixá-lo com o parafuso de fixação ①. (Fig. 8 - 9)

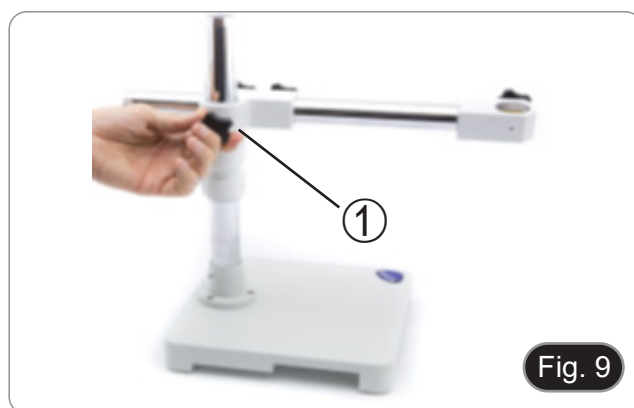

5. Instale o suporte da cabeça. Desaperte o botão de bloqueio ③ e insira o braço para o suporte de focagem a partir de cima ② no orifício do braço horizontal. (Fig. 10)



6. Uma vez completamente inserido, aperte o parafuso de fixação ④. (Fig. 11)



7. Insira o sistema de focagem por baixo, aperte o parafuso de fixação ⑤ e volte a apertar o botão de bloqueio ③ por baixo. (Fig. 12-13)



8.7 SZ-STL2

1. Aparafusar o pilar à base. (Fig. 14)



2. Aperte os parafusos para bloquear o pilar. (Fig. 15)



3. Insira o anel de prevenção de descenso e fixe-o na altura desejada aparafusando o botão de fixação. (Fig. 16)




4. Inserir o braço horizontal e fixá-lo com o parafuso de fixação ① (Fig. 17)



5. Para maior segurança, aperte o parafuso de fixação ② com a chave Allen fornecida. (Fig. 18)



6. Instale o sistema de foco. Desaperte o botão de bloqueio ③ e insira o suporte ④ por baixo no braço vertical. Em seguida, volte a aparafusar o botão de bloqueio ③. (Fig. 19-20)

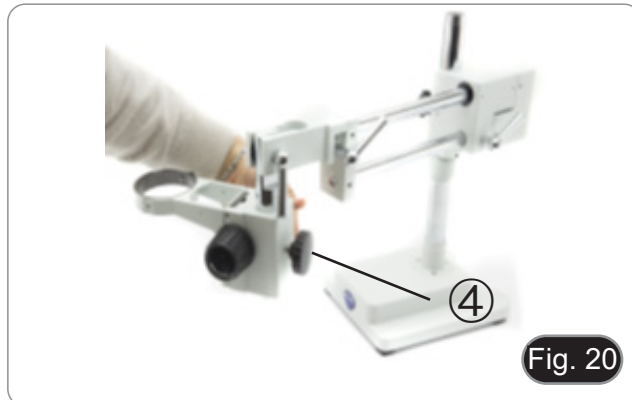

8.8 SZ-STLX

1. Aparafusar o pilar à base. (Fig. 21)



2. Aperte os parafusos para bloquear o pilar. (Fig. 22)



3. Insira o anel de prevenção de descenso e fixe-o na altura desejada aparafusando o botão de fixação. (Fig. 23)



4. Inserir o braço horizontal e fixá-lo com o parafuso de fixação ①. (Fig. 24)





5. O suporte da cabeça pode ser instalado de diferentes formas, dependendo das necessidades específicas do utilizador.

Modo de instalação n° 1: (Fig. 25-27)

Insira a parte traseira do apoio de cabeça (parte preta redonda) ③ (Fig. 25) a partir do topo no orifício do braço horizontal ④ e aparafuse o botão de prevenção ② a partir do fundo.

- Este modo permite a instalação de cabeças pesadas (ou com câmaras pesadas instaladas acima da cabeça).

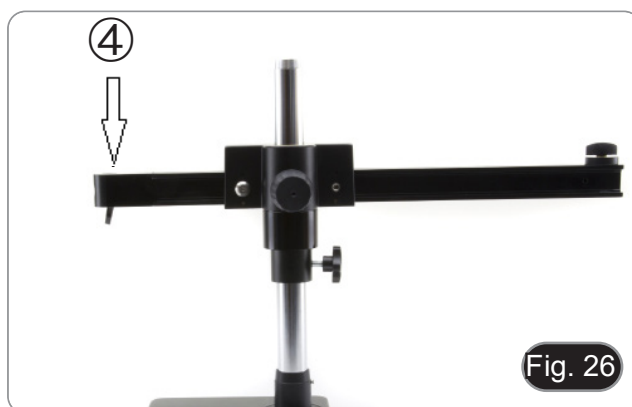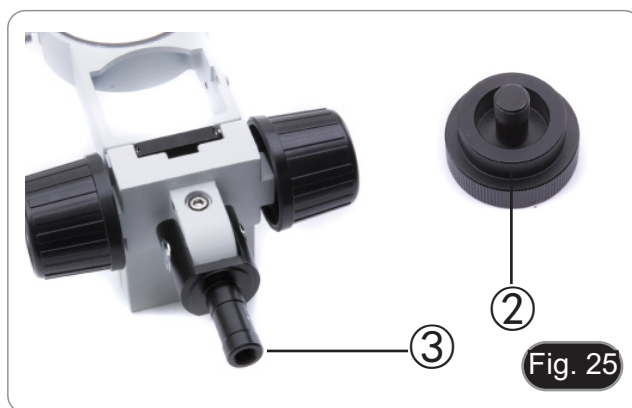

Modo de instalação n° 2: (Fig. 28-29)

Insira a parte traseira do apoio de cabeça (parte preta redonda) ③ (Fig. 28) de baixo para dentro do orifício no braço horizontal e aparafuse o botão de prevenção ② de cima para baixo.



- Estes dois modos permitem que a cabeça seja inclinada. (Fig. 29)



Modo de instalação n° 3: (Fig. 30)

Insira a parte traseira do apoio de cabeça (parte preta redonda) ③ (Fig. 25) no orifício na extremidade do braço horizontal e aperte o botão ⑤.




- Este modo permite que você incline a cabeça. (Fig. 31)



8.9 SZ-STL5 / SZ-STL5LED


1. Ajustar a altura do grampo de mesa ① para se adaptar à superfície da mesa. (Fig. 32)

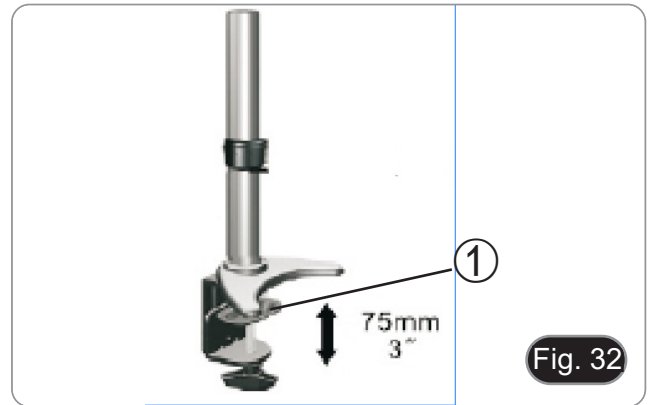


2. Fixar o grampo de mesa ① à borda da mesa na posição desejada e com a abertura do grampo virada para a borda da mesa (Fig. 33). Apertar manualmente o botão ② para assegurar que o grampo de secretária se prende completamente à superfície da secretária e é seguro. (Fig. 34)



3. Para posicionar o colarinho na altura desejada, terá de soltar o colarinho como se mostra. Apertar à mão até que o Colarinho esteja firmemente no lugar. (Fig. 35)

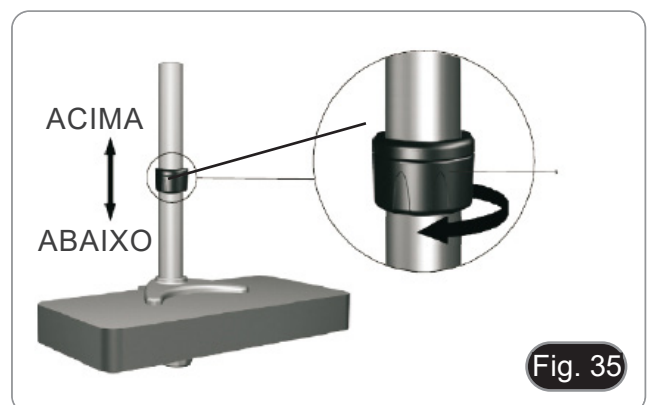

4. Montar o foco no braço, usando os parafusos fornecidos e a chave Allen. (Fig. 36)

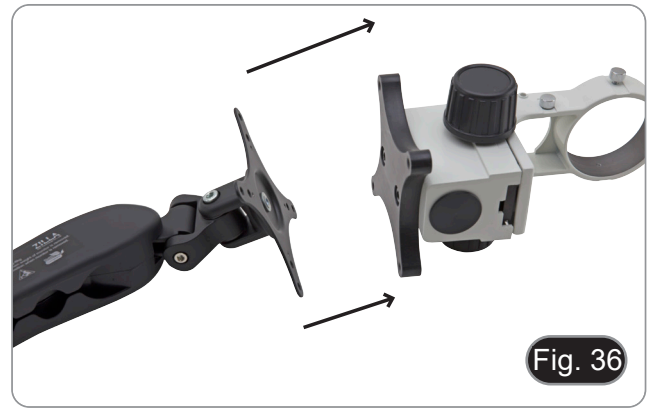

8.10 Instalar a cabeça (todos os modelos)

- Inserir a cabeça e fixar o parafuso de bloqueio. (Fig. 37)




8.11 Instalar as oculares (todos os modelos)

1. Remova as tampas de poeira dos porta oculares e insira as oculares. (Fig. 38)
2. Bloqueie as oculares apertando o parafuso de bloqueio ①.




8.12 Instalar a saída de foto (SZX-T / TA)

1. Desaperte os parafusos de fixação ① da saída de foto fornecida e remova a saída de foto existente. (Fig. 39)

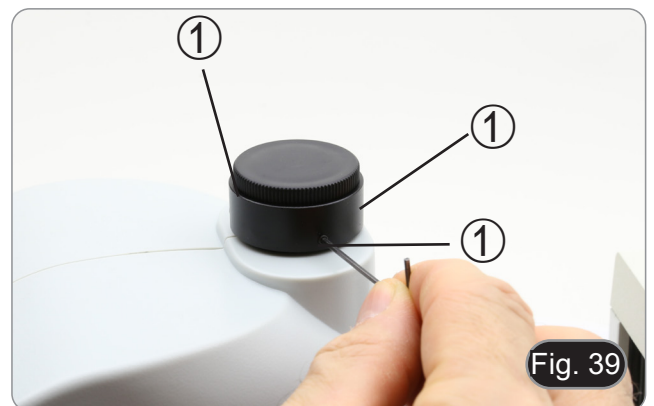

2. Insira o anel da saída da foto ② certificando-se de deixar o parafuso de fixação do adaptador da foto ③ virado para a direita. (Fig. 40)
3. Aperte os parafusos de fixação ①. (Fig. 39)

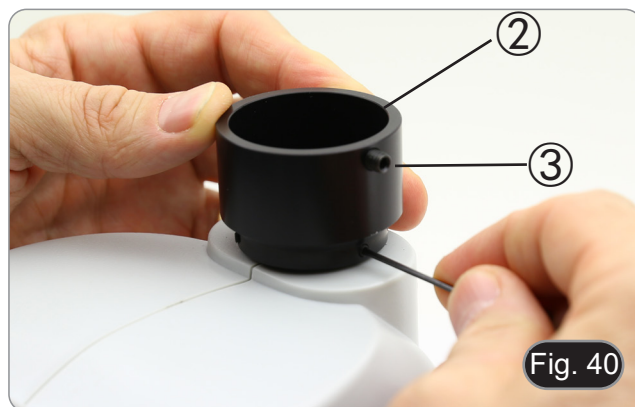

9. Uso do microscópio


9.1 Ajuste da distância interpupilar

1. Segure os lados esquerdo e direito da cabeça de observação com ambas as mãos e ajuste a distância interpupilar rodando os dois lados até que um único círculo de luz seja visível. (Fig. 41)
- Se você observar dois círculos, a distância é muito grande.
- Se você observar duas imagens parcialmente sobrepostas, a distância é muito pequena.



9.2 Focalização

1. Coloque a amostra a ser observada na placa e focalize usando os botões de foco ①.
- Se necessário, ajuste a altura do corpo do microscópio ao longo do pilar vertical.
- Bloqueie o parafuso de bloqueio ② depois de ajustar a altura. (Fig. 42)

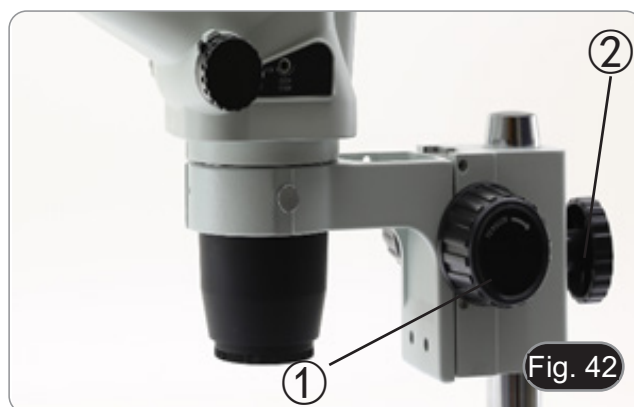


9.3 Ajuste da tensão de focagem

- Este ajuste permite aumentar ou diminuir a tensão dos botões de focagem, evitando uma descida indesejada do microscópio sob seu próprio peso. Ajuste da tensão logo acima do ponto de estabilidade do foco.


9.3.1 SZ-A1

1. Segure os botões ③ ambas as mãos e, enquanto segura o botão esquerdo, rode o botão direito.
- A tensão aumenta ou diminui em função do sentido de rotação do botão direito. (Fig. 43)

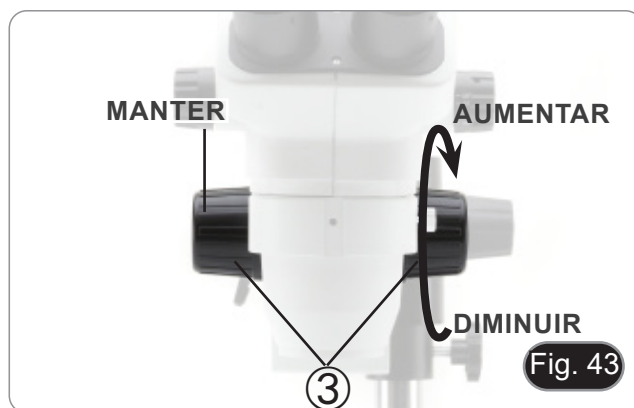

9.3.2 SZ-A6

1. Gire o anel de ajuste ④ no sentido horário até que a tensão desejada seja atingida.
- Girar no sentido anti-horário fará com que a tensão caia, resultando em perda de foco. (Fig. 44)

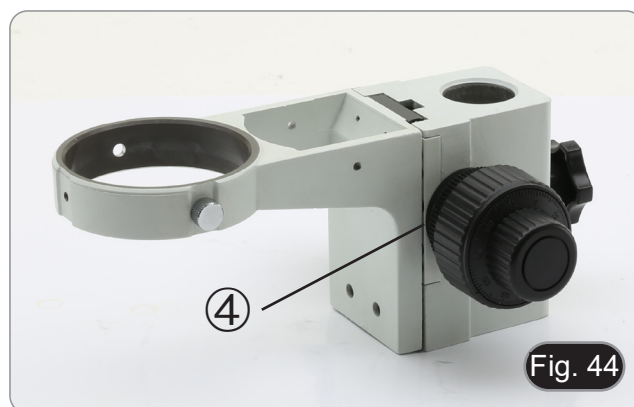

9.4 Alavanca de bloqueio do foco (SZ-A6)

- A alavanca de bloqueio serve como função de memória de focagem.
1. Depois de focar a amostra, puxe a alavanca ① em direcção à frente do microscópio e trave-a (Fig. 45).
 - Define o ponto de focagem superior.
 2. Agora você pode mover o foco do microscópio com o botão macrométrico, substituir a amostra e depois trazer o sistema de volta para o ponto superior: a amostra estará aproximadamente no foco e você só terá que fazer um ajuste fino para obter o foco ideal.
 - O movimento do micrómetro não é afectado pelo bloco de foco.
- **Para remover o bloqueio, desloque a alavanca na direcção oposta à utilizada para o bloqueio.**



9.5 Compensação dióptrica

- **Esta compensação permite aos utilizadores de óculos adaptar o microscópio à sua visão e utilizar o microscópio sem óculos.**
1. Zoom para ampliação mínima ② e focagem com os botões de focagem ③. (Fig. 46)
 2. Ampliar ao máximo a ampliação e reorientar a focagem.
 3. Retorno à ampliação mínima: a amostra estará fora de foco.
-
4. Ajuste o anel de ajuste dióptrico da ocular direita ④ até que a imagem observada esteja nítida e focada (Fig. 47). Repita o procedimento com o anel da ocular esquerda.
 5. Agora verifique o foco da amostra em todo o intervalo de zoom. O sistema é agora perfeitamente parfocal (o foco é mantido durante a alteração da ampliação).



9.6 Ampliação

1. Seleccione a ampliação pretendida com o interruptor de zoom ②. (Fig. 48)
- Se necessário, utilize oculares diferentes e/ou uma lente adicional apropriada para obter a ampliação desejada.
 - **Apenas para a série SZO:** O corpo do microscópio está equipado com uma função “click stop” que permite obter uma ampliação precisa (Fig. 44). A parada de clique pode ser activada ou desactivada inserindo a chave Allen fornecida no orifício no lado direito do microscópio.



9.7 Uso de lentes adicionais

1. Aparafuse a lente adicional no corpo do microscópio. (Fig. 49)
- Cada lente tem uma distância de trabalho específica.
 - O curso do suporte do foco pode não compensar as diferentes distâncias de trabalho das várias lentes adicionais.
 - Se o suporte do foco não conseguir focar a amostra, todo o corpo do microscópio deve ser levantado ou abaixado.

A ampliação total é calculada desta forma:

Ampliação da ocular * Ampliação do zoom * Ampliação adicional da lente.



Série SZX (0.67x - 4.5x / F.N. 22mm)

Ocular	10x		15x		20x		25x	
Índice de campo (mm)	22		16		12		9	
Objetiva	Ampliação total	F.O.V. (mm)	Ampliação total	F.O.V. (mm)	Ampliação total	F.O.V. (mm)	Ampliação total	F.O.V. (mm)
0.3X	2.01X-13.5X	109.45-16.30	3.02X-20.25X	79.60-11.85	4.02X-27X	59.70-8.89	5.03X-33.75X	44.78-6.67
0.5X	3.35X-22.5X	65.67-9.78	5.03X-33.75X	47.76-7.11	6.7X-45X	35.8-5.33	8.38X-56.25X	26.87-4.00
0.75X	5.03X-33.75X	43.78-6.52	7.54X-50.63X	31.84-4.74	10.05X-67.5X	23.88-3.56	12.56X-84.37X	17.91-2.67
1X	6.7X-45X	32.84-4.89	10.05X-67.5X	23.88-3.56	13.4X-90X	17.91-2.67	16.75X-112.5X	13.43-2.00
1.5X	10.05X-67.5X	21.89-3.26	15.08X-101.25X	15.92-2.37	20.1X-135X	11.94-1.78	25.13X-168.75X	8.96-1.33
2X	13.4X-90X	16.42-2.44	20.1X-135X	11.94-1.78	26.8X-180X	8.96-1.33	33.5X-225X	6.72-1.00

Série SZX-A (0.65x - 5.5x / F.N. 23mm)

Ocular	10x		15x		20x		25x	
Índice de campo (mm)	23		16		12		9	
Objetiva	Ampliação total	F.O.V. (mm)	Ampliação total	F.O.V. (mm)	Ampliação total	F.O.V. (mm)	Ampliação total	F.O.V. (mm)
0.3X	1.95X-16.5X	117.95-13.94	2.93X-24.75X	82.05-9.70	3.9X-33X	61.54-7.27	4.88x-41.25x	46.15-5.45
0.5X	3.25X-27.5X	70.77-8.36	4.88X-41.25X	49.23-5.82	6.5X-55X	36.92-4.36	8.13x-68.75X	27.69-3.27
0.75X	4.88X-41.25X	47.18-5.58	7.31X- 61.88X	32.82-3.88	9.75X-82.5X	24.62-2.91	12.19x-103.13X	18.46-2.18
1X	6.5X-55X	35.38-4.18	9.75X-82.5X	24.62-2.91	13X-110X	18.46-2.18	16.25X-137.5X	13.85-1.64
1.5X	9.75X-82.5X	23.59-2.79	14.63X-123.75X	16.41-1.94	19.5X-165X	12.31-1.45	24.38X-206.25X	9.23-1.09
2X	13X-110X	17.69-2.09	19.5X-165X	12.31-1.45	26X-220X	9.23-1.09	32.5X-275X	6.92-0.82

Série SZO (0.67x - 4.5x / F.N. 23mm)

Ocular	10x		15x		20x		25x	
Índice de campo (mm)	23		16		12		9	
Objetiva	Ampliação total	F.O.V. (mm)	Ampliação total	F.O.V. (mm)	Ampliação total	F.O.V. (mm)	Ampliação total	F.O.V. (mm)
0.3X	2.01X-13.5X	114.43-17.04	3.02X-20.25X	79.60-11.85	4.02X-27X	59.70-8.89	5.03X-33.75X	44.78-6.67
0.5X	3.35X-22.5X	68.66-10.22	5.03X-33.75X	47.76-7.11	6.7X-45X	35.82-5.33	8.38X-56.25X	26.87-4.00
0.75X	5.03X-33.75X	45.77-6.81	7.54X- 50.63X	31.84-4.74	10.05X-67.5X	23.88-3.56	12.56X-84.38X	17.91-2.67
1X	6.7X-45X	34.33-5.11	10.05X-67.5X	23.88-3.56	13.4X-90X	17.91-2.67	16.75X-112.5X	13.43-2.00
1.5X	10.05X-67.5X	22.89-3.41	15.08X-101.25X	15.92-2.37	20.1X-135X	11.94-1.78	25.13X-168.75X	8.96-1.33
2X	13.4X-90X	17.16-2.56	20.1X-135X	11.94-1.78	26.8X-180X	8.96-1.33	33.5X-225X	6.72-1.00

9.8 Uso de lentes adicionais 0.3X-0.5X

As lentes adicionais 0.3X e 0.5X têm uma longa distância de trabalho e, portanto, o curso total da coluna de focagem não pode compensar.

Para que as lentes adicionais 0.3X e 0.5X funcionem correctamente, proceda da seguinte forma:

1. Aparafuse a lente adicional conforme descrito na secção 9.7.
2. Remova o corpo do microscópio do suporte.
3. Instale o espaçador ① no suporte de cabeça e aperte o parafuso de fixação ②. (Fig. 50)
4. Monte novamente o corpo do microscópio no espaçador e aperte o parafuso de fixação ③. (Fig. 51)
5. Comece a trabalhar normalmente.



9.9 Disco preto/branco (SZ-ST1 / 2 / 3 / 7 / 8)


Você pode usar um disco de contraste preto/branco para aumentar o contraste da imagem ao trabalhar com luz incidente. (Fig. 52).

Se você estiver olhando para amostras claras, coloque o disco com a parte preta voltada para cima.



9.10 Uso de iluminação (SZ-ST2 / 3 / 7 / 8)

1. Rode o botão da luz incidente ① para ligar/desligar ou alterar a intensidade do LED para luz incidente. (Fig. 53)
 2. Rode o botão da luz transmitida ② para ligar/desligar ou alterar a intensidade do LED para luz transmitida.
- Você pode usar ambas as luzes ao mesmo tempo.

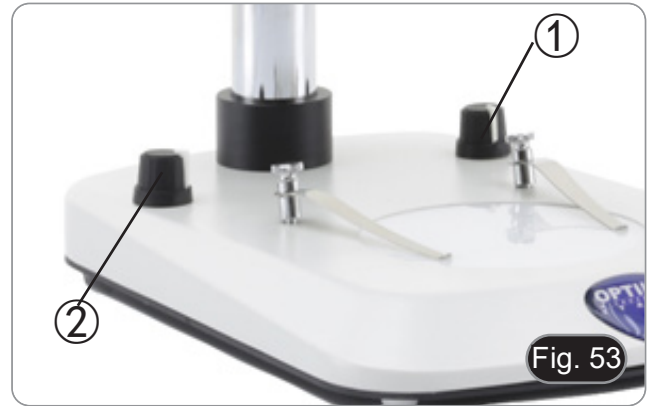

Apenas para SZ-ST7 / SZ-ST8:

- Incline e posicione os braços auto-sustentáveis da base ③ para iluminar de forma ideal a amostra. (Fig. 54)
- Os braços podem ser colocados individualmente na posição desejada.



9.11 Uso de iluminação (SZ-OBL)

1. Rode o botão da luz transmitida ① para ligar/desligar ou alterar a intensidade do LED para luz transmitida. (Fig. 55)
 2. Rodar o botão de rotação do espelho ② para inclinar o espelho até obter a iluminação oblíqua desejada.
- O espelho tem uma superfície lisa e uma superfície serrilhada. As duas superfícies permitem otimizar a observação, fornecendo contraste adequado em função da amostra a ser observada.



9.12 Uso de ilhós de borracha (SZO-B / T)

- Usar com óculos de receitaário

Baixe as oculares de borracha com ambas as mãos. A presença dos piscas rebaixados evita arranhar as lentes dos óculos. (Fig. 56)



- **Usar sem óculos de receituário**

Levante os piscas e observe sob o microscópio, colocando os olhos sobre os piscas, de modo a evitar que a luz externa perturbe os olhos. (Fig. 57)



9.13 Uso de bases em balanço

9.13.1 SZ-STL1

Deslocar o braço horizontal

1. Desaperte os botões do lado direito do braço horizontal ①. (Fig. 58)
2. O braço pode ser estendido ou encurtado de acordo com necessidades específicas. (Fig. 59)




Modificar o ângulo da cabeça

1. Desaperte os botões ① e rode a cabeça para o ângulo desejado (direito ou esquerdo), depois aperte o parafuso de fixação. (Fig. 60)



Girar o braço horizontal


1. Desaperte o parafuso de fixação do braço horizontal ② e rode o braço, depois aperte o parafuso de fixação. (Fig. 61)
- **NOTA:** Girar o microscópio 180° a partir da base pode fazer com que todo o sistema tombe.

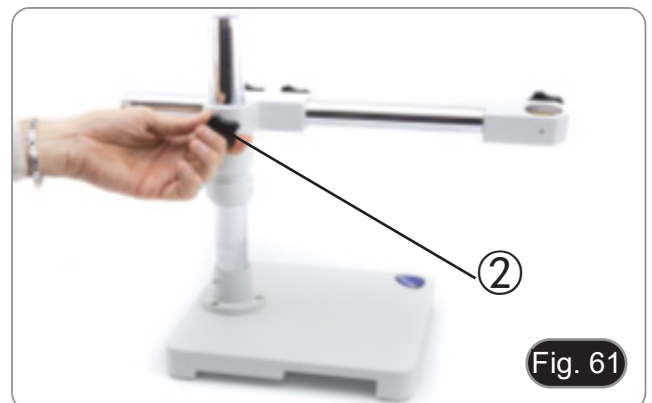

9.13.2 SZ-STL2

Deslocar o braço horizontal

1. Desaperte o botão no lado esquerdo do braço horizontal ①. (Fig. 62)

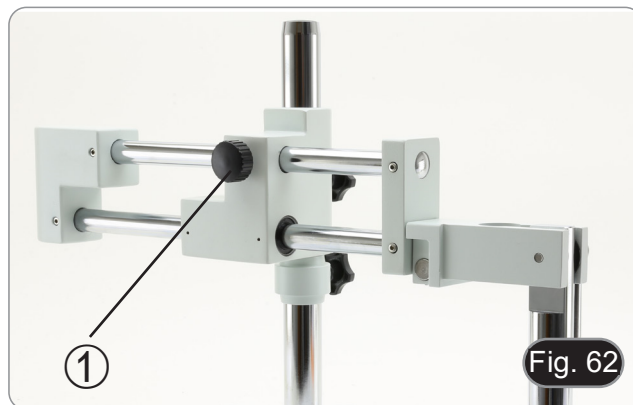

2. O braço pode ser estendido ou encurtado de acordo com necessidades específicas. (Fig. 63)




Inclinar o suporte de cabeça

1. Desaperte o botão ② (Fig. 64) no lado direito do suporte. O braço basculante vertical pode ser movimentado. Uma vez alcançado o ângulo desejado, aperte o botão.



Modificar o ângulo da cabeça

1. Desaperte o parafuso de fixação ③ e rode a cabeça para o ângulo desejado (direito ou esquerdo), depois aperte o parafuso de fixação. (Fig. 65-66)

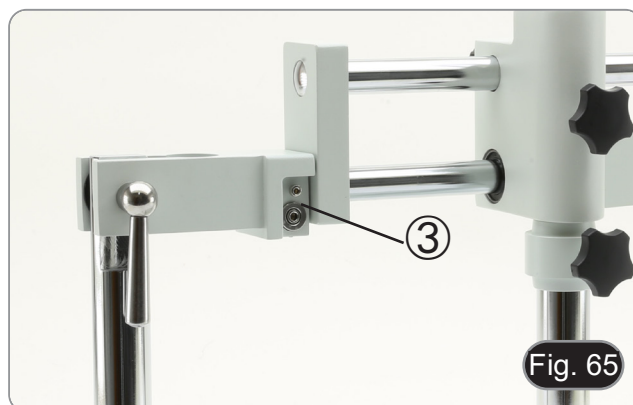



Girar o braço horizontal

1. Desaperte o parafuso de fixação do braço horizontal ④ e rode o braço, depois aperte o parafuso de fixação. (Fig. 67)
- **NOTA:** Girar o microscópio 180° a partir da base pode fazer com que todo o sistema tombe.



9.13.3 SZ-STLX


Deslocar o braço horizontal

1. Desaperte o botão do lado direito do braço horizontal ①. (Fig. 68)
2. O braço pode ser estendido ou encurtado de acordo com necessidades específicas. (Fig. 69)



Ajustar o bloco horizontal

1. Desbloqueie o botão de fixação do fecho ② e coloque-o numa posição adequada às necessidades do utilizador. (Fig. 70)
2. Bloqueie o botão de fixação para definir o limite de movimento.

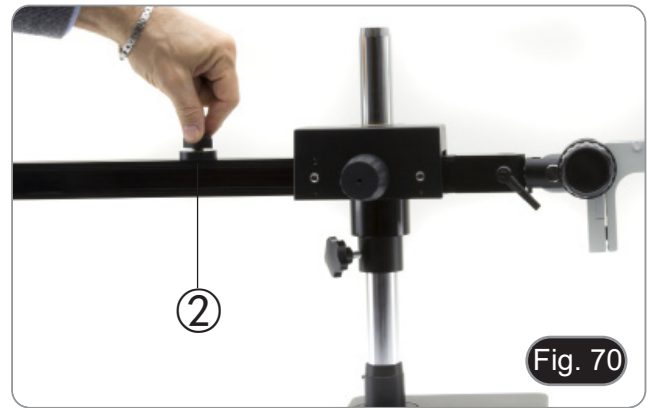

Inclinar o suporte de cabeça

1. Desaperte o parafuso Allen ③ (Fig. 71) na parte superior do apoio de cabeça.
2. A parte preta pode ser movida. Uma vez atingido o ângulo desejado, aperte novamente o parafuso.



Modificar o ângulo da cabeça

1. Desbloqueie o botão de fixação ④ e rode a cabeça para o ângulo de rotação desejado (esquerda ou direita), depois aperte novamente o botão. (Fig. 72-73)



Girar o braço horizontal


1. Desaperte o botão de fixação do braço horizontal ⑤ e rode o braço, depois volte a apertar o botão. (Fig. 74)
- **NOTA: Girar o microscópio 180° a partir da base pode fazer com que todo o sistema tombe.**




9.13.4 SZ-STL5 / SZ-STL5LED

Ajustar a resistência do suporte de montagem



- O produto é brilhantemente concebido para controlar a resistência no suporte de montagem inclinável para se adequar à oscilação de lado a lado de 90 graus e inclinar para a frente e para trás de 90 graus. É possível controlar a quantidade de resistência no Suporte de Montagem Inclinável.
1. Se o suporte de montagem basculante tende a cair automaticamente, pode ser necessário ajustar a articulação do suporte de montagem basculante para se adequar à sua posição de inclinação de 90 graus para a frente e para trás do microscópio. Isto pode ser feito usando uma chave Allen Hex 6mm para aumentar a resistência do suporte de montagem inclinável a fim de fixar a posição de inclinação, ajustar o parafuso de fixação da tampa de fixação M5x15mm localizado à volta da articulação do suporte de montagem Inclinável usando uma chave Allen Hex de 6mm. (Fig. 75)

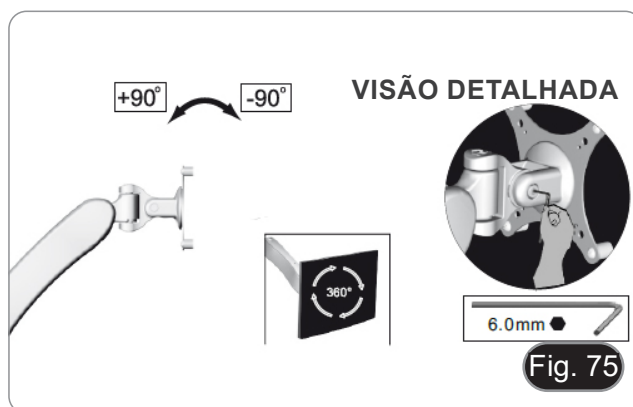

2. Para aumentar ou diminuir a resistência da Junta giravel para se adaptar à oscilação do microscópio de lado a lado, ajuste o Parafuso de Tensão da Tampa Sextavada localizado na parte da frente do Braço Articulado para fixar a posição. (Fig. 76)
3. Para aumentar a resistência, apertar o parafuso de fixação da tampa sextavada M5x15mm usando uma chave Allen de 4mm no sentido dos ponteiros do relógio. Para diminuir a resistência, afrouxar o parafuso de fixação da tampa sextavada M5x15mm usando uma chave Allen de 4mm fornecida no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

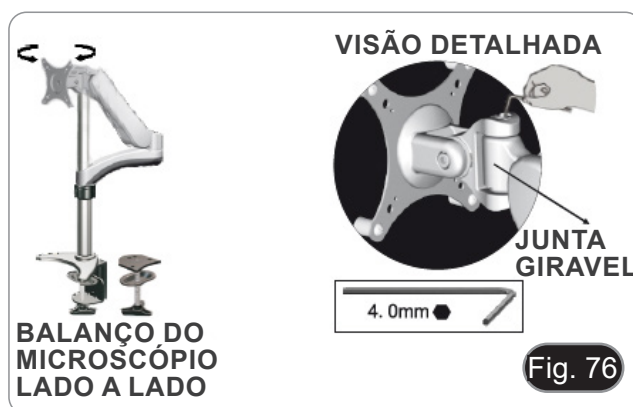

4. Este braço pode ser levantado para cima e para baixo, como mostrado. (Fig. 77).
- Se o braço tende a mover-se automaticamente para o lado, pode ser necessário ajustar a tensão no braço articulador para se adequar à posição lateral do seu braço de microscópio. Isto pode ser feito utilizando a chave Hex Allen de 2,5 mm fornecida. (Fig. 78)

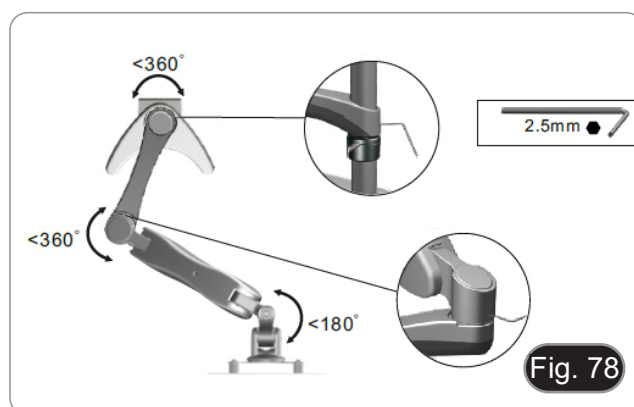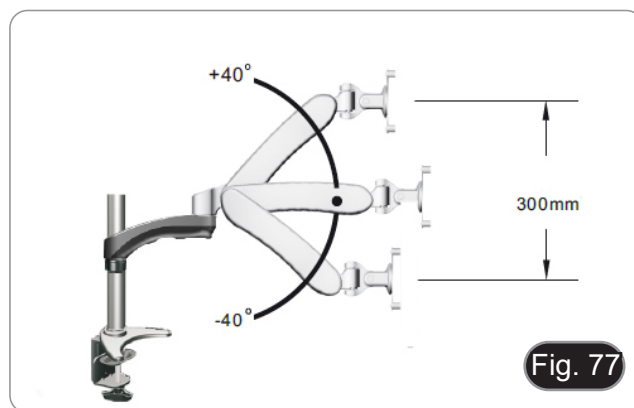

Ajustar a intensidade da luz


Rodar os botões de ajuste da intensidade luminosa ① para ligar/desligar e para aumentar / diminuir a intensidade luminosa de cada um dos braços LED. (Fig. 79)



10. Microfotografia

10.1 Uso de câmaras de passo "C"

1. Desaperte o parafuso de aperto ① na porta trinocular e retire a tampa do pó ②. (Fig. 80)

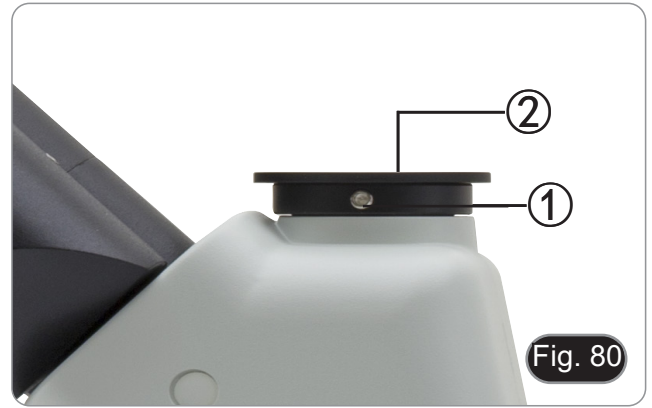

2. Aparafuse o adaptador C-mount ③ à câmara ④ e insira o encaixe redondo do C-mount no orifício vazio da porta trinocular (Fig. 81), depois aperte o parafuso de aperto ①.



10.2 Uso de câmaras Reflex

1. Insira o adaptador Reflex ① no tubo do relé no microscópio ②.
2. Aparafuse o anel "T2" ③ (não fornecido) ao adaptador de reflex.
3. Conecte a câmara Reflex ④ ao anel "T2" recém-instalado. (Fig. 82)
4. Monte a extremidade do tubo de ligação ② no orifício vazio do tubo trinocular e, em seguida, aperte o parafuso de aperto. (Fig. 80)
 - O anel "T2" não é fornecido junto com o microscópio, mas está disponível comercialmente.
 - Ao fotografar amostras escuras, escureça as oculares e o visor com um pano escuro para minimizar a luz difusa.
 - Para calcular a ampliação da câmara: ampliação da objectiva * ampliação da câmara * ampliação da objectiva.
 - **Ao usar uma câmara SLR, o movimento espelhado pode fazer com que a câmara vibre.**
 - **Sugerimos que levante o espelho, utilizando tempos de exposição longos e um cabo remoto.**



11. Manutenção

Ambiente de trabalho

Recomenda-se de utilizar o microscópio em um ambiente limpo e seco, sem o risco de colisões, a uma temperatura entre 0°C e 40°C e com uma humidade relativa máxima de 85% (em ausência de condensação). Recomenda-se o uso de um desumidificador, se necessário.

Antes e depois do uso do microscópio



- Manter o microscópio sempre em posição vertical quando se o desloca.
- Certificar-se além disso que as partes móveis, por exemplo os oculares, não caiam.
- Não manusear sem precauções e não usar força inútil no microscópio.
- Não tentar fazer qualquer reparação por si próprio.
- Depois do uso desligar imediatamente a lâmpada, cobrir o microscópio com a sua protecção anti-pó fornecida e mantê-lo em um lugar seco e limpo.

Precauções para um uso seguro



- Antes de ligar a fonte de alimentação à rede eléctrica certificar-se que a tensão local seja adequada à do aparelho e que o interruptor da lâmpada esteja posicionado no off.
- Seguir todas as precauções de segurança da zona na qual se trabalha.
- O aparelho é aprovado segundo as normas de segurança CE. Os utilizadores têm, de qualquer modo plena responsabilidade sobre a Uso em segurança do microscópio.

Limpeza das lentes

- Caso as lentes necessitem de ser limpas, utilizar em primeiro lugar ar comprimido.
- Se não for suficiente usar um pano que não deixe fiapos, húmido com água e um detergente delicado.
- Em último caso é possível usar um pano humedecido com uma solução 3:7 de álcool etílico e éter.
- **Atenção: o álcool etílico e o etanol são substâncias altamente inflamáveis. Não usar junto a uma fonte de calor, faíscas ou junto a aparelhos eléctricos. As substâncias devem ser manuseadas em um lugar bem ventilado.**
- Não esfregar as superfícies de nenhuma lente com as mãos. As impressões digitais poderão danificar as lentes.
- Não desmontar as objetivas ou os oculares para tentar limpá-los.

Para um melhor resultado utilizar o kit de limpeza OPTIKA (ver catálogo).

Se for necessário enviar o microscópio ao fabricante para a sua manutenção, pede-se que seja utilizada a embalagem original.

12. Resolução de problemas

Reveja a informação na tabela abaixo para tentar solucionar problemas de operação.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
I. Secção Óptica:		
A iluminação está ligada, mas o campo de visão está escuro	O plugue do suporte da lâmpada não está conectado ao grupo de iluminação	Conecte-os
	O brilho é muito baixo	Defina um ajuste apropriado
O campo de visão está obscurecido ou não está uniformemente iluminado	O iluminador da luz do incidente não está correctamente orientado	Alterar o ângulo do iluminador do incidente
Pó e manchas podem ser vistas no campo de visualização	Há manchas e pó na amostra	Limpe a amostra
	Há manchas e pó na ocular	Limpe a ocular
Há uma aparente imagem dupla	O tamanho do diafragma de abertura é muito pequeno	Abra o diafragma de abertura
	O condensador não está bem centrado ou está em uma altura errada	Ajuste o condensador de acordo com os ajustes de Koehler.
Qualidade da imagem insatisfatória: <ul style="list-style-type: none"> • A imagem não é nítida; • O contraste não é alto; • Os detalhes não são claros • Reflexões na imagem 	As lentes (objetivas, oculares) estão sujas	Limpar bem todos os componentes ópticos
Um lado da imagem está fora de foco	A amostra está fora do lugar (saltou)	Coloque a amostra plana sobre a platina.
II. Secção Mecânica:		
O botão do foco macro está difícil de rodar	O anel de ajuste da tensão está muito apertado	Solte o anel de ajuste da tensão
O foco é instável	O anel do ajuste da tensão está muito solto	Aperte o anel de ajuste da tensão
III. Secção eléctrica		
O LED não liga.	Sem fonte de alimentação	Verifique a conexão do cabo de alimentação
O brilho não é suficiente	O ajuste de brilho é baixo	Ajuste o brilho
A luz pisca	O cabo de alimentação está mal conectado	Verifique o cabo de alimentação
IV. Tubo de visão:		
O campo de visualização dos dois olhos é diferente	A distância interpupilar não é correcta	Ajuste a distância interpupilar
	A correcção dióptrica não é correcta	Ajuste a correcção dióptrico
	A técnica de visualização não é correcta e o operador está a deformar o alcance da vista	Ao olhar numa objectiva, não fixe o olhar na amostra mas olhe todo o campo de visualização. Periodicamente, retire o olhar para olhar para um objecto distante, depois volte para a objectiva
V. Microfotografia e vídeo:		
O canto da imagem não pode ser focado	Para alguns graus, é inerente à natureza das objectivas acromáticas	O problema pode ser diminuído com um ajuste correcto do diafragma de abertura
Manchas brilhantes aparecem na imagem	Luz difusa está a entrar no microscópio através das oculares e através do visor da câmara	Cubra as oculares e o visor com um pano escuro

Eliminação

Art.13 Dlsg 25 de Julho de 2005 N°151. “De acordo com as Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relativas à redução do uso de substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos e à eliminação de resíduos.



O símbolo do cesto no equipamento ou na sua caixa indica que o produto no final da sua vida útil deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. A recolha separada deste equipamento no final da sua vida útil é organizada e gerida pelo produtor. O utilizador terá de contactar o fabricante e seguir as regras que adoptou para a recolha de equipamentos fora de uso. A recolha dos equipamentos para reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente ajuda a prevenir possíveis efeitos adversos no ambiente e na saúde e promove o reuso e/ou reciclagem dos materiais dos equipamentos. O descarte inadequado do produto envolve a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação em vigor.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain
spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA
usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China
china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® India
india@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Central America
camerica@optikamicroscopes.com
